

第一节 质疑函

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：广西雷润科技有限公司

地址：南宁市青秀区荔滨大道 6 号华发新城 A 区商业 B 区商业二层 S5-216 号商铺 邮编：530000

联系人：余文聪 联系电话：15777123283

授权代表：余文聪

联系电话：15777123283

地址：南宁市青秀区荔滨大道 6 号华发新城 A 区商业 B 区商业二层 S5-216 号商铺 邮编：530000

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：灵山县中医医院麻醉机采购

质疑项目的编号：QZZC2025-J1-210320-BJCJ

标项名称：灵山县中医医院麻醉机采购

采购人名称：灵山县中医医院

质疑事项：

☐ 采购文件 采购文件获取日期：

☐ 采购过程

☒ 中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：一、主机部分：▲1. ≥ 15 寸外置彩色触控屏，可以根据操作位置的需要，在四维层面多角度旋转调节，可折叠。

事实依据：经我司查证，本条参数深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司麻醉机 A4C 型号说明书中记载如下，该屏幕可以多角度旋转但不能折叠，不满足此参数，属于虚假响应。

A5/A5C/A5e/A4/A4C/A4e

麻醉系统

Anesthesia System

使用说明书

Operator's Manual

2.2.9 带吊塔支架的麻醉系统

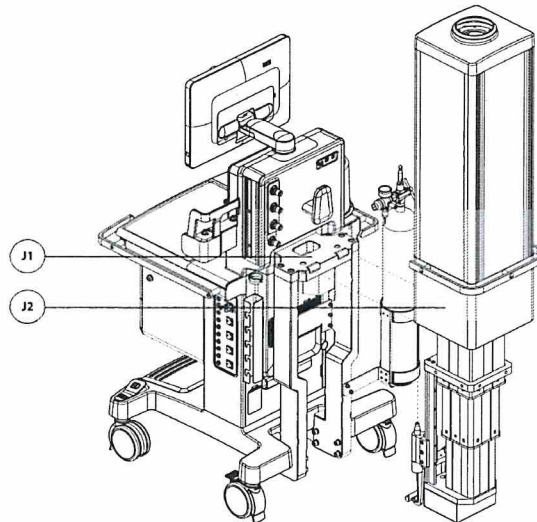


图 2-9 带吊塔支架的麻醉系统（标准版）

质疑事项 2：四、呼吸回路：▲2. 一体化呼吸回路固定在主机左侧，牢固不活动，呼吸回路的进气端和出气端均位于麻醉机正前方，便于麻醉医生操作。

事实依据：经我司查证，本条参数深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司麻醉机

A4C 型号说明书中记载如下，麻醉机 A4C 呼吸回路的进气端和出气端均位于麻醉机侧方，并不在麻醉机的正前方并不满足此参数，属于虚假响应。

2.2.6 呼吸系统

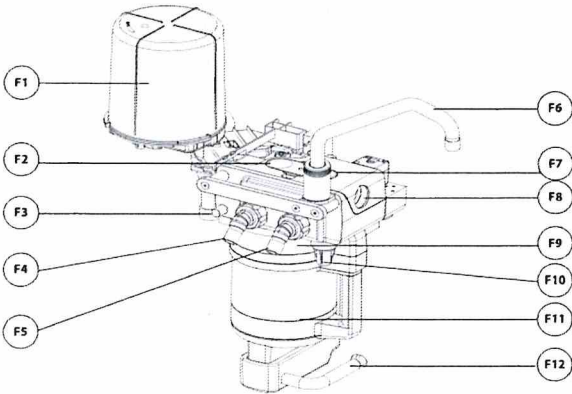


图 2-6 呼吸系统

部件	描述
F1 风箱 ^a	可从机器外部观察折叠的状态。
F2 呼气单向阀	允许病人呼出的气体流向呼吸系统并防止回流。
F3 泄漏测试塞	连接呼吸管路，进行泄漏测试。
F4 呼气接口	呼吸回路呼气接口。
F5 吸气接口	呼吸回路吸气接口。
F6 手动支臂	用于连接手动通气气囊。
F7 吸气单向阀	允许吸入的气体流向病人并防止回流。
F8 氧传感器接口	可安装氧传感器，用于监测氧浓度。
F9 吸收罐旁路 (Bypass) 组件	更换二氧化碳吸收罐内的钠石灰时，保持呼吸回路里的压力。
F10 积水杯	收集呼吸系统的冷凝水，必须定期取下倒空。
F11 二氧化碳吸收罐	用于盛放二氧化碳吸收剂（散装二氧化碳吸收剂或 Pre-pak 二氧化碳吸收剂）的容器。
F12 吸收罐锁	杠杆式锁定机制，用于锁住（水平位置）/解锁（垂直位置）吸收罐。

a. 风箱罩是一个透明盖，上面标有从 300 到 1500 mL 的刻度线。这些刻度线仅供参考，应从用户界面上读取潮气量。输送的潮气量是风箱排量 and 新鲜气体流量之和。

表 2-6 呼吸系统部件列表

法律依据：《招标投标法》第五十四条：投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任；《招标投标法实施条例》第四十二条：明确投标人 5 类弄虚作假行为，包括提供虚假的信用状况等，虚假响应招标参数多归入“其他弄虚作假的行为”。

质疑事项3：▲7. 具有辅助供氧功能，可不开机提供快速吸氧。

事实依据：经我司查证，本条参数深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司麻醉机 A4C 型号说明书中未记载有此功能，属于虚假响应。

法律依据：《招标投标法》第五十四条：投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任；《招标投标法实施条例》第四十二条：明确投标人 5 类弄虚作假行为，包括提供虚假的信用状况等，虚假响应招标参数多归入“其他弄虚作假的行为”。

质疑事项4：▲4. 具有安全运输模式-T模式，转运更换无需排空麻醉药。

事实依据：经我司查证，本条参数深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司麻醉机 A4C 型号说明书中未记载有此功能，属于虚假响应。

法律依据：《招标投标法》第五十四条：投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任；《招标投标法实施条例》第四十二条：明确投标人 5 类弄虚作假行为，包括提供虚假的信用状况等，虚假响应招标参数多归入“其他弄虚作假的行为”。

质疑事项5：三、麻醉呼吸机：31. 顺应性监测范围：0~300 ml/cmH20，精度±0.5 ml/cmH20或者实际读数的±15%，取大者。

事实依据：经我司查证，本条参数深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司麻醉机

A4C 型号说明书中记载如下，麻醉机 A4C 顺应性监测范围：0~300 ml/cmH₂O，精度 ±(10 mL/cmH₂O+ 实际读数的 ±20 %)，并不满足此参数，属于虚假响应。

吸气中止水平	5%~10% 范围内: ± (设置值 -0.1%) (绝对误差); 10%~80% (不含 10%) 范围内: ±10% (绝对误差)。
高压水平	±2.5 cmH ₂ O 或设置值的 ±7%，取大者。
低压水平	±2.0 cmH ₂ O 或设置值的 ±7%，取大者。
高压水平时间	±0.2 s 或设置值的 ±10%，取大者。
低压水平时间	±0.2 s 或设置值的 ±10%，取大者。
高压水平时间: 低压水平时间 (吸呼比)	2:1~1:4 范围内: 设置值的 ±10% ; 4:1~2:1 和 1:4~1:8 (不含 2:1 和 1:4) 范围内: 设置值的 ±25% ; 50:1~4:1 和 1:8~1:50 (不含 4:1 和 1:8) 范围内: 设置值的 ±50%。
分钟通气量百分比	±10% 或设置值的 ±10%，取大者。
监测精度	
潮气量	0 mL ~ 60 mL 范围内: ±10 mL 60 mL ~ 210 mL (不含 60 mL) 范围内: ±15 mL 210 mL ~ 3000 mL (不含 210 mL) 范围内: 实际读数的 ±7%
气道压力	20 cmH ₂ O~120 cmH ₂ O 范围内: ±2 cmH ₂ O 或实际读数的 ±4%，取大者。
呼气末正压	0 cmH ₂ O~70 cmH ₂ O 范围内: ±2 cmH ₂ O 或实际读数的 ±4%，取大者。
呼吸频率	0 bpm~150 bpm 范围内: ±1 bpm 或者实际读数的 ±5%，取大者。
吸呼比	2:1~1:4 范围内: 实际读数的 ±10% 50:1~2:1 和 1:4~1:50 范围内 (不含 2:1 和 1:4) 范围内: 实际读数的 ±25%
分钟通气量	0 L/min~100 L/min 范围内: ±0.1 L/min 或者实际读数的 ±8%，取大者。
阻力	0 cmH ₂ O/(L/s) ~ 20 cmH ₂ O/(L/s) 范围内: ±10 cmH ₂ O/(L/s) ; 20 cmH ₂ O/(L/s) ~ 600 cmH ₂ O/(L/s) (不含 20 cmH ₂ O/(L/s)) 范围内: 实际读数的 ±50%。
顺应性	0 mL/cmH ₂ O~300 mL/cmH ₂ O 范围内: ±(10 mL/cmH ₂ O+ 实际读数的 ±20%)
分钟通气泄漏量	0 L/min~10.0 L/min 范围内: ±0.1 L/min 或者实际读数的 ±8%，取大者。
吸呼潮气量差值	0 mL~60 mL 范围内: ±20 mL 60 mL~210 mL (不含 60 mL) 范围内: ±30 mL 210 mL~3000 mL (不含 210 mL) 范围内: 实际读数的 ±14%
驱动压	0 cmH ₂ O ~ 120 cmH ₂ O 范围内: ±2 cmH ₂ O + 实际读数的 4%
机械能	0.00 J/min ~ 100.00 J/min 范围内: ±(1 J/min + 实际读数的 15%)

表 13-9 呼吸机精度

13.10 报警设置

报警设置		
参数	设定范围	备注
吸入氧浓度	报警上限	20% ~ 100%， OFF
	报警下限	18% ~ 98%
分钟通气量	报警上限	0.2 L/min ~ 100.0 L/min
	报警下限	0.0 L/min ~ 99.0 L/min
气道压力	报警上限	2 cmH ₂ O ~ 100 cmH ₂ O
	报警下限	0 cmH ₂ O ~ 99 cmH ₂ O
潮气量	报警上限	5 mL ~ 1600 mL
	报警下限	OFF, 0 mL ~ 1595 mL
呼吸频率	报警上限	4 bpm ~ 100 bpm, OFF
	报警下限	OFF, 2 bpm ~ 98 bpm
窒息报警延迟时间调节范围为 5 s ~ 60 s，误差为 ±3 s。		


四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：此次广西服宇医疗科技有限公司响应的参数属于虚假应标，特提出质疑。我方强烈要求在法律框架的规范范围内，对中标公司响应参数进行重新审核，将虚假中标公司予以废除处理。我方期待招标方能尽快回复以上问题，并希望能在最短的时间内进行处理。同时，我方保证质疑函内容真实无误，如有需要，我方愿意提供进一步的信息或证据。

签字(签章)：余文聪
日期：2026年1月7日

公章：广西雷润科技有限公司





营业执照

统一社会信用代码
91450102MA5NNH0W02 (1-1)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”，
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

(副本)

名称 广西益润科技有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人 余文聪
经营范围

生物科技、生物制品的研发、技术转让、技术咨询及技术服务；销售：医疗器械（具体项目以市批部门批准的为准）、饲料、饲料添加剂、不再分包装的农作物种子、农药、化肥、有机肥、饮料（具体项目以市批部门批准的为准）、微生物菌剂（除危险化学品）、日用百货、计算机软件、农业机械、建筑材料（除危险化学品）、装饰材料（除危险化学品）、机电设备及配件、五金交电、服装鞋帽、电线电缆、汽车摩托车配件、化工原料及化工产品（除危险化学品）、通讯器材（除国家专控产品）、数码产品、塑料制品、电子计算机及配件、办公用品、办公家具、科研仪器设备、酒店用品、照明器材、化妆品；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务；许可经营项目商品和技术进出口业务；自营和代理国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

注册资本 伍佰万圆整
成立日期 2019年03月19日
住所 南宁市青秀区荔滨大道6号华发新城
A区商业B区商业二层S5-216号商铺

登记机关



2024

年 月 日

第二类医疗器械经营备案凭证

备案编号: 桂南药监械经营备20190464号


企业名称	广西雷润科技有限公司
统一社会信用代码	91450102MA5NNH0W02
法定代表人	余文聪
企业负责人	余文聪
住 所	南宁市青秀区嘉滨大道6号华发新城A区商业B区商业二层S5-216号商铺
经营方式	批发
经营场所	南宁市青秀区嘉滨大道6号华发新城A区商业B区商业二层S5-216号商铺
库房地址	南宁市兴宁区三塘镇松柏路31号兴宁创业园一号厂房5楼503号（委托广西合诺兴商贸有限公司贮存、配送）
经营范围	6821, 6822, 6823, 6826, 6830, 6840（诊断试剂需低温冷藏运输贮存）, 6841, 6856, 6858, 6864, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22



备案部门(盖章): 南宁市市场监督管理

备案日期: 2024年 6月 24日

服务事项专用章



医疗器械经营许可证

许可证编号：桂南药监械经营许20190289号
统一社会信用代码：91450102MA5NNHOW02
企业名称：广西雷润科技有限公司
法定代表人：余文聪
住所：南宁市青秀区荔滨大道6号华发新城A区商业B区商业
企业负责人：余文聪
经营场所：南宁市青秀区荔滨大道6号华发新城A区商业B区商业
经营方式：批发
库房地址：南宁市兴宁区三塘镇松柏路31号兴宁创业园一号厂房5楼503号（委托广西合诺兴商贸有
限公司贮存、配送）

经营范围：

6804, 6815, 6821, 6822, 6823, 6824, 6825, 6826, 6828, 6830, 6832, 6833, 6840（诊断试剂需低温冷藏运输贮存），
6845, 6846, 6854, 6858, 6863, 6864, 6865, 6866, 6870, 6877, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 1
6, 17, 18, 20, 21, 22

许可期限：自 2024 年 6 月 24 日
至 2029 年 6 月 23 日

发证部门：南宁市行政审批局
发证日期：2024 年 6 月 24 日



法定代表人身份证复印件

