

《广西壮族自治区政府采购合同》文本

合同编号:GXZC2026-G1-000063-GTZB

采购人(甲方) 右江民族医学院附属医院

采购计划号 广西政采【2025】21965 号

供应商(乙方) 广西尚鹏医疗设备有限公司

招 标 编 号 GXZC2026-G1-000063-GTZB

签 订 地 点 右江民族医学院附属医院

签 订 时 间 2026年3月26日

本合同为中小企业预留合同: 否。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定,按照招标文件(采购文件)规定条款和中标(成交)供应商承诺,甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家/国别	数量	单位	单 价 (元)	金 额 (元)	注册证号
1	宫腔镜 (一体 镜)	科迈森	KMS-IV (一体)	湖南科迈森 医疗科技有 限公司/中国	3	套	118300 .00	354900 .00	湘械注准 202221815 76
2	冷刀宫 腔镜	科迈森	KMS-II (Z)	湖南科迈森 医疗科技有 限公司/中国	1	套	232000 .00	232000 .00	湘械注准 202221815 76
3	新生儿 黄疸治 疗箱	戴维	XHZ-10 0A	宁波戴维医 疗器械股份 有限公司/中 国	5	台	47000. 00	235000 .00	浙械注准 201820900 33
人民币合计金额(大写) 捌拾贰万壹仟玖佰元整 (小写) 821900.00 元									
交付时间: 自合同签订之日起 30 天内交货并安装调试合格									

2. 合同合计金额包括货物价款, 备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。

第二条 质量要求

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与招

标文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或者投标文件承诺的质量要求。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。若引发诉讼，乙方承担全部责任（包括但不限于赔偿金、诉讼费、律师费、采购人停业损失等）

2. 乙方应按招标文件规定或者投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4. 乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按照响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输方式：不限

3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：货物运输保险费已包含在合同总价中，乙方须确保货物安全无损地运抵安装地点。

第五条 交付和验收

1. 交货时间：自合同签订之日起 30 天内交货并安装调试合格。

交货地点：右江民族医学院附属医院指定地点。

2. 乙方提供不符合采购文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4. 甲方应当在到货并安装、调试完后一个月内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后五日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2. 乙方投标文件承诺负责甲方有关人员的培训。

(1) 交货时由乙方组织生产厂商工程技术人员为用户提供使用技术培训，并使操作人员达到能独立、熟练操作及维护仪器的程度。使用培训为验收要件之一，没有经过培训，视为没能完成验收。培训结束后，乙方应为相关人员提供厂家出具的产品使用培训证书。

(2) 培训对象：甲方指定的设备使用人员及维修人员。

(3) 培训形式：现场使用培训方式，安装调试结束后，乙方培训工程师对机器正确使用方法进行示范操作，保证教会使用人员能正确使用设备。乙方供货时每一个产品必须提供详细参数说明书各壹套给甲方存档。否则甲方有权拒绝货物进场，造成的损失由乙方负责。

第七条 售后服务、保修期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和采购文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物保修期：按乙方承诺，质保期为自验收合格之日起宫腔镜（一体机）1年、冷刀宫腔镜1年、新生儿黄疸治疗箱3年。如生产厂家承诺质保期服务长于乙方的，乙方亦有继续履行质保服务的义务。（但不得低于1年，保修期过后，须定期上门回访，对设备提供终身维修、维护服务，维修只收材料成本费）

3、当甲方需设备开放数据端口以接入业务系统时，乙方应无条件开放设备的数据通信技术接口服务全端口；若医院有相关需求，乙方需负责将该产品接入医院的HIS系统、LIS系统、PASS系统等，相关接口技术服务费由乙方承担。

4、维修响应：在设备整个使用期内，乙方应确保设备的正常使用，在接到用户维修要求后应2小时内作出回应，在接到报修通知后12小时内派技术员到达现场维修（单个设备有特殊要求的或不可抗力情形除外），一般故障不超过12小时排除，重大故障不超过24小时排除，特殊情况无法修复的，质保期内乙方应无条件更换新设备或提供代用设备；或采取使设备可正常运转的措施。乙方应提供7*24通过远程、上门服务、电话、E-mail等方式为用户提供终身完善的售前和售后技术咨询服务。质保期内定期对设备进行免费保养和维护，每季度不少于1次定期回访及对系统进行维护。提供终身有偿维护和保养服务。乙方必须设有针对本项目的售后服务点，保证长期良好的售后服务，并列出售后服务点的详细地址、联系电话及技术服务人员。

5、乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项（见合同附件）。

第八条 付款方式

1. 乙方提供的物品及数量必须与供货清单一致，不得少于供货清单。
2. 本分标项目无预付款，项目验收合格交付使用后30日内支付第一笔合同款的35%，第

二笔合同款在验收合格交付使用 6 个月后的 15 个工作日内支付合同款的 30%, 第三笔剩余 35% 的合同款, 在验收合格交付使用 12 个月后的 15 个工作日内支付(无息)。乙方商在甲方付款前开具完税发票给甲方, 税费由乙方承担。

第九条 履约保证金

履约保证金金额: 不收取履约保证金。

履约保证金递交方式: 支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式(参照投标保证金)。

履约保证金退付方式、时间及条件: 由中标人向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》(详见桂财采(2015) 22号), 保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续(不计利息)。

签订合同后, 如中标人不按双方签订的合同规定履约, 则没收其全部履约保证金, 履约保证金不足以赔偿损失的, 按实际损失赔偿。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担, 合同另有约定的除外。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计(期限见《采购需求》中的要求)。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障, 乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者, 根据实际情况, 经双方协商, 可按以下办法处理:

(1) 更换: 产品出现质量问题、经乙方 1 次维修仍不能达到合同约定的质量标准的, 甲方有权更换, 并由乙方承担所发生的全部费用。

(2) 贬值处理: 由甲乙双方协议定价。

(3) 退货处理: 产品出现严重质量问题的, 甲方有权退货, 乙方应退还甲方支付的合同款, 同时承担退货所发生的所有费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等), 并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方, 甲方还可依法追究乙方的违约责任, 且甲方有权终止合同, 由此造成的损失由乙方负责。

4、所有投标设备必须是根据《医疗器械监督管理条例》及相关国家标准、产品技术要求执行, 整机质保宫腔镜(一体镜) 1 年、冷刀宫腔镜 1 年、新生儿黄疸治疗箱 3 年(如“技术参数及其性能(配置)要求”中另有要求, 按其规定)。质保期自设备验收合格并能正常使用之日起计算。如投标文件中提供生产厂家对质保期的承诺, 且与乙方承诺不一致时, 以生产厂家承诺为准。质保期内, 乙方将负责处理并解决故障, 并免费更换有故障的零、部件, 一切费用由乙方负责。终身提供维修服务, 质保期外维修只收材料成本费。

5、质保内容: 质保整机(整台、整套), 质保期内保证设备的合法性使用, 国家强制检测

由乙方负责, 保质期内的质量责任由乙方承担; 质保期内保证所保设备全年工作日的开机率至少达到 95%, 全年工作日按照 365 天计算, 未达到的天数, 按 1:2 比例顺延服务期时间。须提供产品核心部件的质保年限清单。

6、货物保修期: 按乙方承诺, 质保期为自验收合格之日起宫腔镜(一体镜) 1 年、冷刀宫腔镜 1 年、新生儿黄疸治疗箱 3 年。若生产厂家官方承诺质保期高于本合同约定, 以厂家承诺质保时限为准, 乙方亦有继续履行质保服务的义务。(但不限于 1 年, 保修期过后, 须定期上门回访, 对设备提供终身维修、维护服务, 维修只收材料成本费);

7、维修响应: 在设备整个使用期内, 乙方应确保设备的正常使用, 在接到用户维修要求后应 2 小时内作出回应, 在接到报修通知后 12 小时内派技术人员到达现场维修(单个设备有特殊要求的或不可抗力情形除外), 一般故障不超过 12 小时排除, 重大故障不超过 24 个小时排除, 特殊情况无法修复的, 质保期内乙方应无条件更换新设备或提供代用设备; 或采取使设备可正常运转的措施。乙方人应提供 7*24 通过远程、上门服务、电话、E-mail 等方式为用户提供终身完善的售前和售后技术咨询服务。质保期内定期对设备进行免费保养和维护, 每季度不少于 1 次定期回访及对系统进行维护。提供终身有偿维护和保养服务。乙方必须设有针对本项目的售后服务点, 保证长期良好的售后服务, 并列出售后服务点的详细地址、联系电话及技术服务人员。

8. 在质保期内, 乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。如有产品质量争议, 则按照国家《产品质量仲裁检验管理办法》解决。

9. 上述的货物因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的机器设备, 终生维修, 维修时只收取部件成本费。

第十二条 交货和验收(本条款适用于甲方自行验收, 委托第三方验收的另行规定)

1. 乙方交货时, 所有产品均严格按签订的采购合同、响应和承诺的技术参数及性能和国家标准进行验收, 达不到要求的不予验收, 视为产品验收不合格, 甲方可解除双方的供货合同。

2. 乙方所提供的所有设备必须是签订合同之日前 1 年内生产的机型。若设备生产年限超出约定, 甲方有权拒收, 乙方需赔偿合同金额 5% 的违约金, 并承担重新采购的额外成本。

3. 乙方所提供的产品必须是具备厂商合法渠道的全新的、完整的、未使用过的产品。

4. 所提供产品, 如有质量监督、环保等部门要求对产品进行检测、检验时, 乙方必须联系生产厂商派出厂方代表, 发现产品如有质量问题, 乙方应承担全部费用及相应的责任。

5. 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收, 外观、说明书符合采购文件技术要求的, 给予签收, 不合格的不予签收。

6. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理, 并列出清单, 作为甲方收货验收和使用的技术条件依据, 检验的结果应随货物交甲方。乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的, 必须负责补齐, 否则视为未按合同约定交货。

7. 乙方需负责安装、调试，并培训甲方的使用操作人员，直到设备运行符合技术要求，甲方方可验收。

8. 甲方组织验收，乙方必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，费用由乙方承担。

9. 其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采（2015）22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库（2016）205 号]规定执行。

第十三条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金 3‰的违约金。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

7. 甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的 5%，违约

内容涉及货款额的 5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

8. 乙方在项目实施过程中,如与第三方发生任何纠纷,应由乙方独立承担全部相关责任;如因乙方原因导致诉讼发生,甲方有权要求乙方赔偿包括但不限于甲方依法中止本合同、重新组织招标、应诉所需的律师费、诉讼费及其他相关费用,并赔偿甲方由此产生的一切经济损失。

第十五条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内,任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同,则合同履行期可延长,其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后,应立即通知对方,并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上,双方应通过友好协商,确定是否继续履行合同。

第十六条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的,应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的,鉴定费由甲方承担;货物不符合标准的,鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决,如果协商不能解决,可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间,本合同继续履行。

第十七条 合同生效及其它

1. 合同履行地点为:右江民族医学院附属医院;合同履行的方式:按照本合同约定。

2. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

3. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的,须经财政部门审批,并签书面补充协议报财政部门备案,方可作为主合同不可分割的一部分 3. 本合同未尽事宜,遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外,本合同一经签订,甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。


2. 乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

第十九条 本合同书与下列文件一起构成合同文件

签订本合同依据(注:如果有)

1. 招标文件;
2. 乙方提供的投标文件;
3. 中标通知书

第二十条 本合同一式五份,具有同等法律效力,采购代理机构一份,甲方两份,乙方两份(可根据需要另增加)。

甲方（章）  2026年3月26日	乙方（章）  2026年3月26日
单位地址：	单位地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁 片区玉洞大道44号云创谷1号办公楼十二层 1242号办公
法定代表人： 	法定代表人： 
委托代理人：	委托代理人：尹绍高
经办人： 	经办人：尹绍高
电话：/	电话：18877505570
开户银行：/	开户银行：交通银行股份有限公司南宁长湖支行
账号：/	账号：451060705013000915619

2、医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同

甲方：右江民族医学院附属医院

乙方：广西尚鹏医疗设备有限公司

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定尹绍高作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，甲方纪检监察部门（基层医疗卫生机构上报上级卫生计生行政部门）执一份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）：右江民族医学院附属医院



乙方（盖章）：广西尚鹏医疗设备有限公司



法定代表人（负责人）：



法定代表人（负责人）：



委托代理人：

委托代理人：尹绍高

经办人签名：

郭才

经办人签名：

尹绍高

联系电话：18877505570

2026 年 3 月 26 日

2026 年 3 月 26 日

3、采购需求

04 分标 采购预算： 84.25 万元 （各项采购预算单价详见招标公告）

序号	标的的名称	数量及单位	所属行业	技术要求
1	宫腔镜（一体镜）	3 套	工业	一、基本要求 用于宫腔疾病的治疗，包括子宫肌瘤、息肉、粘连、畸形以及异物残留等； 二、配置要求 1、宫腔镜(一体)规格 7Fr/30°数量 1 pc 2、宫腔镜配套手术器械（剪刀）规格Φ2.0*410 或 7fr*385mm 数量 1pc 3、宫腔镜配套手术器械（异物钳）规格Φ2.0*410 或 7fr*385mm 数量 1pc 4、宫腔镜配套手术器械（活检钳）规格Φ2.0*410 或 7fr*385mm 数量 1pc 5、专用内窥镜消毒盒 数量 1pc 三、具体规格及技术参数 1.用于宫腔疾病的治疗，包括子宫肌瘤、息肉、粘连、畸形以及异物残留等； 2.具有 7Fr 的手术器械通道，在可视情况下手术操作； 3.超广角镜头，视场角 90°； 4.视向角 30°、景深 3mm-100mm； 5.插入部工作长度 200mm，插入部最大宽度 5.4mm，免扩宫； 6.插入部前端为圆滑无创设计，减少对宫颈口的损伤，方便进入宫腔； 7.可配备多种器械，包括剪刀、活检钳、异物钳等； 8.镜鞘一体，含无创末端，与内窥镜联体设计，镜体更细，进出水更通畅； 9.器械插入口为喇叭形，方便器械进入； 10.密封帽内置，双层医用硅胶致密密封防漏水设计，自动闭合操作通道； 11.器械通道无磁片设计，避免影响输卵管疏通导丝等术中耗材通过，且与手术器械紧密包裹，杜绝气泡进入宫腔； 12.进出水口可根据手术需求 360°旋转，防止水路管缠绕。方便医生操作。避免宫颈口损伤； 13.可耐高温高压消毒，镜体密封性好，内镜上标有可耐压力蒸汽灭菌（Autoclav）标识； 14.产品符合医疗器械国家标准 GB9706.1-2020、GB/T9706.218-2021 中规定的要求，设备安全性及稳定性更优。

				四、售后服务 1.提供不少壹年的免费质保期;货物在质保期内,因产品质量而导致的缺陷,提供免费维修服务。 2.设备验收合格交付使用后, 免费为客户进行培训服务。培训内容为理论培训、使用操作培训、技术维护培训等。 3.保修期内, 在接到维修电话后半小时内响应, 2 小时内作出维修方案决定;如 2 小时内无法通过电话解决问题, 专业维修人员必须在接到故障报告后 24 小时内达到医院现场维修, 尽快的保证用户恢复正常使用。
2	冷刀宫腔镜	1 套	工业	一、配置要求 宫腔镜 1 支、鞘套 1 支、闭孔器 1 支、专用器械消毒盒 1 个、防漏水封帽 2 个 二、具体规格及技术参数 1.总体要求: 该套系统具有按照国家食品药品监督管理局规定, 适用范围仅限于妇产科宫腔手术 *2.产品组成: 宫腔镜 1 支、鞘套 1 支、闭孔器 1 支、专用器械消毒盒 1 个、防漏水封帽 2 个 (一). 宫腔镜镜体参数: 1. 90°平行视野直视镜体, 目镜和器械通道保持平行设计, 视向角$\geq 15^\circ$, 工作长度≥ 200 毫米。 2.宫腔镜镜体器械通道≥ 3 毫米, 整体(镜体+镜鞘)最大外径≤ 7 毫米。 3.镜体采用进口不锈钢材料, 宫腔镜为进口柱状透镜内窥镜, 成像清晰, 视场边缘圆整, 密封良好 4.器械通道双重防漏封帽设计, 有效避免传统宫腔镜器械开关阀门及进出器械后漏水问题 *5.宫腔镜镜体可同时满足多种方式灭菌: 环氧乙烷气体、低温等离子及高温高压灭菌, 符合内窥镜灭菌消毒要求 6.专用宫腔镜消毒盒, 上下双排设计, 可环氧乙烷气体、低温等离子及高温高压消毒 (二). 外鞘技术参数 1.外鞘直径$\leq 21\text{Fr}$, 前端侧面带有多个出水孔, 可形成高效连续对流 2. 鞘套工作长度≥ 200 毫米, 插入部分最大宽度≤ 8.2 毫米 (三). 闭孔器技术参数 1.宫腔专用闭孔器, 钝性头端防损伤设计, 保护宫颈口 2.鞘套、闭孔器及镜体均有三角色标相对应, 方便准确、快速安装 3.扩宫仅需至 7-7.5 号 (四). 宫腔专用枪式器械技术参数 *1.器械为医用不锈钢材质, 不带有电能量, 纯金属器

				械杆（不包裹黑色绝缘层），器械需要提供注册证 2.360°可旋转、拥有 PEEK 材质及金属材质的多功能手柄（不带电极接口）即 PEEK 无锁、PEEK 带锁 *3.器械工作长度≥350 毫米，器械直径≥3 毫米；剪刀（单开微型剪 1 支、双开弯剪 1 支）、锯齿钳（左弯分离钳 1 支、鼠齿钳 1 支）、异物钳（强力抓钳 1 支）、活检钳 1 支 三、售后服务 1、上门安装服务：免费送货上门，免费安装调试，免费培训；按国家标准实行“三包”。 2、保修政策：（1）保修服务：提供终身；（2）保修方式：上门维修、寄送修。 3、主机保修期：12 月（从终端签收时间开始计算） 4、换货政策：若有质量问题，厂家无条件 15 天内换全新产品（从终端签收时间开始计算）
3	新生儿黄疸治疗箱	5 台	工业	一、基本配置： 1. 上箱体【含上灯箱（光源为 LED）、控制仪、婴儿床】， 2. 下箱体【含下灯箱（光源为 LED）、储物柜】 二、产品主要功能、技术参数及要求： 1、电源要求：AC220V/50Hz； 2、输入功率：≤800VA； 3、黄疸箱温度显示的平均值与实际黄疸箱温度平均值之差（恒温状态下）：≤±0.8℃； 4、温度控制范围：25℃～34℃； 5、床面温度均匀性：0.8℃内； 6、肤温显示范围：10℃～42℃； ▲7、皮肤温度传感器精度：±0.2℃内； 8、床面温度均匀性：≤0.8℃ 9、故障报警：超温报警、断电报警、传感器报警、偏差报警、风机报警、系统报警； 10、婴儿床面上的工作噪声：≤55dB(A)，环境噪音在 45dB(A)以下； 11、报警声级：婴儿床面上≤80dB(A)，距离控制仪正前方 3m 处，至少 65dB(A)； 12、床面上有效表面内的总辐照度：≥2.0mW/cm²（上灯箱光源为 LED） ≥3.0mW/cm²（下灯箱）； 13、床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥1.5mW/cm²（上灯箱光源为 LED） ≥2.5mW/cm²（下灯箱）； 14、床面上有效表面内的最高胆红素总辐照度：2.2mW/cm²（上灯箱光源为 LED） 3.5mW/cm²（下灯箱）；

			15、床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：> 0.4。 ▲16、两侧和正门有机玻璃均可打开，方便操作 三、售后服务 1.提供≥3 年的免费质保期，提供免费维修服务。 2.调试安装结束交付使用后，免费进行培训服务。培训内容为理论培训、使用操作培训、技术维护培训等。 3.保修期内，乙方在接到维修电话后半小时内响应，2 小时内作出维修方案决定;如 2 小时内无法通过电话解决问题，专业维修人员必须在接到故障报告后 24 小时内达到医院现场维修，尽快的保证用户恢复正常使用。
一、▲商务要求			
交付的时间（和地点）	1、交付时间：自合同签订之日起 30 天内交货并安装调试合格。 2、交货地点：采购人指定地点。		
付款条件（进度和方式）	本分标项目无预付款,项目验收合格交付使用后 30 日内支付第一笔合同款的 35%,第二笔合同款在验收合格交付使用 6 个月后的 15 个工作日内支付合同款的 30%,第三笔剩余 35%的合同款,在验收合格交付使用 12 个月的 15 个工作日内支付(无息)。中标供应商在采购人付款前开具完税发票给采购人，税费由中标供应商承担。		
售后服务要求及培训要求	1. 供应商负责货物运输、保险及卸货至采购人指定地点，提供上门安装调试服务，且不得额外收取运输、安装、调试等任何费用。采购人需要设备开放数据端口接入业务系统时，中标供应商无条件配合并承担相应接口费用。 2. 当采购人需设备开放数据端口以接入业务系统时，中标供应商应无条件开放设备的数据通信技术接口服务全端口；若医院有相关需求，中标交供应商需负责将该产品接入医院的 HIS 系统、LIS 系统、PASS 系统等，相关接口技术服务费由厂家承担。 3. 维修响应:在设备整个使用期内，投标人应确保设备的正常使用，在接到用户维修要求后应 2 小时内作出回应，在接到报修通知后 12 小时内派技术员到达现场维修(单个设备有特殊要求的或不可抗力情形除外)，一般故障不超过 12 小时排除，重大故障不超过 24 个小时排除，特殊情况无法修复的，质保期内中标供应商应无条件更换新设备或提供代用设备；或采取使设备可正常运转的措施。投标人应提供 7*24 通过远程、上门服务、电话、E-mail 等方式为用户提供终身完善的售前和售后技术咨询服务。质保期内定期对设备进行免费保养和维		

	护，每季度不少于 1 次定期回访及对系统进行维护。提供终身有偿维护和保养服务。投标人必须设有针对本项目的售后服务点，保证长期良好的售后服务，并列出售后服务点的详细地址、联系电话及技术服务人员。 4. 保修期要求为至少 3 年（如“技术要求”中另有要求的，按其规定），生产厂商有承诺的按生产厂商承诺执行（但不低于 3 年，保修期过后，须定期上门回访，对设备提供终身维修、维护服务，维修只收材料成本费。 5. 人员培训： (1) 交货时由生产厂商工程技术人员为用户提供使用技术培训，并使操作人员达到能独立、熟练操作及维护仪器的程度。使用培训为验收要件之一，没有经过培训，视为没能完成验收。培训结束后，中标供应商应为相关人员提供厂家出具的产品使用培训证书。 (2) 培训对象：使用单位的设备使用人员及维修人员。 (3) 培训形式：现场使用培训方式，安装调试结束后，供方培训工程师对机器正确使用方法进行示范操作，保证教会使用人员能正确使用设备。中标供应商供货时每一个产品必须提供详细参数说明书各壹套给采购人存档。否则采购人有权拒绝货物进场，造成的损失由中标人负责。
质保期	1. 所有投标设备必须根据《医疗器械监督管理条例》及相关国家标准、产品技术要求执行，整机质保至少 1 年（如“技术参数及其性能（配置）要求”中另有要求，按其规定）。质保期自设备验收合格并能正常使用之日起计算。如投标文件中提供产品生产厂家对质保期的承诺，且与投标人承诺不一致时，以生产厂家承诺为准。质保期内，中标人将负责处理并解决故障，并免费更换有故障的零、部件，一切费用由中标人负责。终身提供维修服务，质保期外维修只收材料成本费。 2. 质保内容：质保整机（整台、整套），质保期内保证设备的合法性使用，国家强制检测由中标人负责，保质期内的质量责任由中标人承担；质保期内保证所保设备全年工作日的开机率至少达到 95%，全年工作日按照 365 天计算，未达到的天数，按 1:2 比例顺延服务期时间。
验收要求	1. 中标供应商交货时，所有产品均严格按签订的采购合同、响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到要求的不予验收，视为产品验收不合格，采购单位可解除双方的供货合同。 2. 中标供应商所提供的所有设备必须是签订合同之日前 1 年内生产的机型。若设备生产年限超出约定，采购人有权拒收，中标人需赔偿合同金额 5% 的违约金，

	并承担重新采购的额外成本。 3. 中标供应商所提供的产品必须是具备厂商合法渠道的全新的、完整的、未使用过的产品。 4. 所提供产品，如有质量监督、环保等部门要求对产品进行检测、检验时，必须派出厂方代表协助检查，发现产品如有质量问题，供货方和制造商应承担全部费用及相应的责任。 5. 其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目验收管理办法的通知》[桂财采(2015)22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库(2016)205号]规定执行。
包装和运输（如有）	无
保险（如有）	无
核心产品	本项目第1项、第2项设备“<u>宫腔镜（一体镜）、冷刀宫腔镜</u>”为本次采购的核心产品。 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
其他要求	1. 投标时提供投标产品彩色图片或说明书（标明主要技术参数）。 2. 采购人设备主管科室对本合同质保服务内容进行全程对接和监督，并对服务情况进行客观记录，在每个合同年度期结束时，由设备主管科室根据合同约定的服务内容、响应情况、服务态度及过程记录。 3. 采购人在货物交货验收阶段发现货物的技术参数指标达不到采购文件该货物技术参数要求的，属虚假应标行为，采购人将终止合同拒收货物，追究该成交单位违约责任，赔偿采购人因采购时间延长造成采购经济等方面损失。 4. 中标供应商经营第二类医疗器械的须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》。 5. 必须无条件向采购人开放数据通讯技术接口服务全端口。 6. 如采购人有需求，中标供应商需负责将该产品接入医院的HIS系统、LIS系统、PASS系统等系统，相关接口技术服务费由厂家承担。
医疗器械注	投标产品属第一类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理

册证	办法》（国家市场监督管理总局令第 47 号）提供该设备在负责药品监督管理的部门提交备案资料证明材料复印件（或扫描件）加盖投标人电子签章；投标产品属第二、三类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第 47 号）提供该设备有效的药品监督管理部门出具的医疗器械注册证复印件（或扫描件）加盖投标人电子签章，否则投标无效。
资料要求	当响应文件提供的设备性能参数与该生产商提供的性能参数不符合时，以生产商资料为准。（“项目需要及技术需求”有要求的则按其要求）
二、进口产品说明	
▲本项目货物不接受进口产品投标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），如有此类产品参与投标的作无效投标处理。	

4、投标函

一、投标函

致：右江民族医学院附属医院

根据贵方购买高档心脏彩色多普勒超声仪、电子胆道内窥镜等一批医疗设备项目（项目编号：GXZC2026-G1-000063-GTZB）的招标公告，签字代表尹绍高（姓名）经正式授权并代表投标人广西尚鹏医疗设备有限公司（投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1. 我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2. 我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3. 本投标有效期自投标截止之日起60日。
4. 如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
5. 我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。
6. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
7. 以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
8. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十一条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外，我方就本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

☒ 我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

☐ 我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：_____；

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区玉洞大道44号云创谷1号办公楼十二层1242号办公

邮编：530000 电话：13707866649 传真：/

投标人名称：广西尚鹏医疗设备有限公司

开户银行：交通银行股份有限公司南宁长湖支行

银行帐号：451060705013000915619

法定代表人或委托代理人签字

投标(电子签章) 山西尚鹏医疗设备有限公司

2026年02月05日

5、开标一览表

二、开标一览表

项目名称：购买高档心脏彩色多普勒超声仪、电子胆道内窥镜等一批医疗设备项目

项目编号：GXZC2026-G1-000063-GTZB

分标：04分标

投标人名称：广西尚鹏医疗设备有限公司

单位：元

序号	标的的名称	品牌	规格 型号	生产厂 家	国别	数量及 单位①	单价②	投标报价 ③=①×②	备注
1	宫腔镜(一体 镜)	科迈森	KMS-IV (一体)	湖南科迈 森医疗科 技有限公 司	中国	3 套	118300元	354900元	无
2	冷刀宫腔镜	科迈森	KMS-11 (Z)	湖南科迈 森医疗科 技有限公 司	中国	1 套	232000元	232000元	无
3	新生儿黄疸 治疗箱	戴维	XHZ-100 A	宁波戴维 医疗器械 股份有限 公司	中国	5 台	47000元	235000元	无
合计金额大写：人民币捌拾贰万壹仟玖佰元整(¥821900.00)									
交付时间：自合同签订之日起30天内交货并安装调试合格。									

法定代表人或者委托代理人(签字/电子签名)：

投标人(电子签名)：广西尚鹏医疗设备有限公司

日期：2026年02月05日



6、售后服务承诺

五、售后服务承诺

售后服务承诺书

我公司承诺：

一、交货时间：自合同签订之日起 30 天内交货并安装调试合格。

二、交货地点：采购人指定地点。

三、售后服务：

1. 质保期：新生儿黄疸治疗箱整机质保3年；宫腔镜（一体镜）质保1年；冷刀宫腔镜质保1年。在保修期内，如因质量问题，我公司负责免费维修及免费更换零配件。在免费保修期过后继续提供维修保养服务，并提供原厂原装优惠价零配件服务。

2. 问题响应时间：我公司在接到电话通知后，2小时内做出响应，12小时内到达现场进行维护或维修。24小时内解决问题，若24小时仍未能有效解决，由我公司提供替代设备或免费提供同规格同型号设备予采购人临时使用，保障系统正常运行，在无相同型号的同种设备时，则更换同类设备中较高型号的产品并承担相应费用。质保期内定期对设备进行免费保养和维护，每季度1次定期回访及对系统进行维护。提供终身有偿维护和保养服务

3. 售后服务人员：尹绍高 电话：0771-4506776

售后服务点地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区玉洞大道44号云创谷1号办公楼十二层1242号办公。

4. 因故意性因素造成的损坏或故障，或质保期满后发生的损坏或故障，不在负责（承担所有费用）保修范围内的，我公司将按照国家及行业标准及其售后服务承诺（如有不一致，以标准高者为准）积极修理，并提供优惠价格的配件和服务。质保期满后提供终身维修、升级及保养服务，只收成本费。

5. 安装调试：免费负责送货上门并安排技术人员负责现场安装并调试合格，负责现场培训相关人员至掌握设备操作及日常维护。

6. 培训：我公司负责现场培训采购人使用人员和维护人员，内容包括设备及软件系统操作、日常维护，确保其熟练掌握全部功能，使其具备判断及排除日常故障的能力为止。培训次数、时间、地点、人数由采购人视情况决定。

7. 后附原厂售后服务承诺函。

投标人名称（电子签章）



2023年02月05日

售后服务承诺书

- 1.科迈森承诺:对 右江民族医学院附属医院 的科迈森 宫腔镜 产品提供 壹年 的免费质保期(非人为损坏),器械不保修;货物在质保期内,因产品质量而导致的缺陷,提供免费维修服务。
- 2.调试安装结束后,我司将按照质量检查规范流程,对设备全面的安装质量检查,检查通过后,即正式交付用户使用。
- 3.交付使用后,我司免费为客户进行培训服务。培训内容为理论培训、使用操作培训、技术维护培训等。
- 4.保修期内,我司在接到维修电话后 2 小时内响应,2 小时内作出维修方案决定;如 2 小时内无法通过电话解决问题,专业维修人员必须在接到故障报修后 24 小时内达到医院现场维修,尽快的保证用户恢复正常使用。
- 5.保修期满后,可双方另行协商保修期外的维修服务方式。我司将提供多种规范的售后服务合同,供用户选择。
- 6.在设备保修期内,对于非人为损坏产生故障配件,我司将进行免费更换。同时保证所更换配件的质量和使用时限符合公司的质量标准。
- 7.由于用户不当使用及一些人为因素而造成的设备损坏,或引起的故障,不在保修范围之内。由于外界所提供的介质质量或者参数变化而造成的设备损坏或引起故障,不在保修范围之内。
- 8.科迈森的服务宗旨是“客户第一”。每位科迈森售后人员在执行售后任务时必须坚持此原则,并愿意接受客户的监督。

9.售后服务人员应急用户之所急，严格按照用户的要求高质量地完成服务任务，认真回答用户提出的问题，积极提供各种解决方案以供用户选择，做到用户满意。

10.服务人员均经过公司严格培训，具备上岗资格。严格遵守用户的各项规章制度，工作中文明操作，尽量减少客户的不便，以维护本部门及用户的形象。

11.服务人员具备专业素质及灵活迅速解决实际问题的能力，力求在最短的时间内完成任务，尽量做到处理故障不隔日，以减少客户的不便及损失。

12.对用户的建议及投诉必须做到逐条登记，认真处理。在最短时间内答复用户。如达不到用户满意，则继续采取措施或报告上级处理，直到用户满意。且对被投诉人员进行批评教育，严重的则予以惩罚，并责令其向用户道歉。

13.定期回访用户，虚心接受用户的意见和建议，以此作为改进工作的依据，不断提高服务质量，并改进产品技术。同时及时纠正用户工作中不规范的操作造成的结果偏差并协助用户对设备进行保养。

14.免费保修期满后，科迈森将提供终身有偿服务，并以最优价提供配件。

售后服务机构：湖南科迈森医疗科技有限公司售后服务中心

地址：湖南省长沙市开福区青竹湖街道青竹湖路769号军民融合科技城A组团架空层01、架空层02。

101、102、201、202、301、302、401、402

电话：0731-85796151/4008355277

戴维产品质量和售后服务承诺

为了更好地服务于广大戴维客户，戴维公司将提供技术咨询、设备选型、直至整体解决方案，确保设备的质量性能、供货时间、服务保障以及设备在保修期内、外的技术支持、维护保养、维修服务和技术培训，并做出如下承诺：

一、产品质量承诺

- 1、戴维公司对本次招投标所提供的设备符合招标方要求的规格型号和技术性能。
- 2、戴维公司保证所供设备是经过出厂检验的合格产品。
- 3、戴维公司承诺对所供设备满足国家有关质量技术标准及相关法律、法规和规定的要求；并附有产品质量合格证、说明书、保修卡。

二、售后服务承诺

- 1、保修范围：用户应严格按照使用说明书使用设备。在保修期内，机器出现质量问题，戴维公司提供免费维修和配件更换。下列情形之一者，则不在免费保修之列，用户应承担器材成本费和人工费用（另行约定），戴维公司会全力协助排除故障，使系统恢复正常。
 - 由于用户不正确使用或违规操作，给用户造成设备损坏，如不小心跌落等，而发生的故障。
 - 由于电网电压不在本设备规定的适用范围而引起的故障及严重损坏等。
 - 由于不可抗力因素（如地震、洪水、火灾、雷电等）造成的故障。
 - 由于未经本公司认可的维修人员之拆修而发生的故障。
 - 对设备的使用超出我方在设计研发仪器时所能预料到的使用目的和使用条件。
 - 由于设备与其他仪器连接使用而发生的故障。
 - 其它非因仪器本身质量问题而发生的故障。
- 2、服务热线：戴维专设全天候24小时免费客户服务热线：4008533221，供客户及时 反馈各种产品使用情况，为客户解决实际问题。
- 3、服务团队：戴维服务人员均经过公司严谨的专项技术培训，并通过相应服务资质的考核，具备过硬的业务技能和深厚的实践经验。
- 4、收费服务：保修期满后，由我公司按市场统一价格提供维修配件及服务。
- 5、配件供应年限：产品零部件保证供应年限不低于产品的寿命期。
- 6、主动关怀服务：工程师现场主动走访，收集客户建议及意见，为客户的设备进行系统的诊断、校准、维护、保养、升级。

三、培训计划

戴维公司承担培训工作，对买方的使用人员及设备维修人员进行培训，使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作，维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除。

- 培训师资：戴维公司专业工程师
- 培训内容：产品基本原理、操作使用、保养维修等有关内容
- 培训地点：用户单位所在地
- 培训费用：费用全免
- 受训人员要求：用户单位专业医护人员
- 培训完成：《售后服务记录单》上签字认可，培训完成。

技术培训方案

培训目标：通过经仪器制造专业培训的工程师的培训，让用户相关人员了解产品的架构、熟悉各部件的名称和作用，熟练仪器的使用方法和日常维护等注意事项。

培训人员数量：不限，由用户指定。

培训实施时间：双方约定，按照约定的培训时间的一周内实施。

培训达到的水平：培训后相关人员能够独立使用、操作和维护设备。

培训内容包括：设备的简介、设备的运用方法、日常维修、简单故障的识别及排除等。

培训费：培训所需全部费用均由我公司支付。

培训形式：

(1) 现场培训：我公司提供现场技术培训(不限次数)，保证使用人员正常操作设备的各种功能；根据设备技术要求，向采购人提供维修技术人员培训(不限次数)，费用由我公司承担。

(2) 集中培训：根据设备管理、技术要求，向采购人提供管理、使用和维护技术人员培训(次数不限)，费用由我公司承担。

(3) 网络教育：提供与各地用户和专家进行网上交流和学习的平台，并随时了解最新的技术进展和各种教育课程、会议信息。

新机入院培训计划

培训时间	培训时长	培训内容	培训人员	培训师
装机一周内	第一天上午	技术理论培训、操作常见问题培训	设备操作者	工程师
	第一天下午	实践操作培训	设备操作者	工程师

零配件供应

在质量保证期内, 我公司将对由于设计不善所引起的任何零配件的消耗负责。

我公司保证设备的原厂零配件或可代替原厂配件的适当零配件在设备的寿命完结前和在安装设备后的10年内均可容易购得, 所有配件更换后, 该设备可以继续良好地运行。

质保期满后, 只按厂价收取所换的零配件费用。

四、保修及服务响应时间承诺

- 1、设备保修期: 保修期从设备“安装验收日”起开始计算; 整机质保 3 年, 设备终身维修。
- 2、服务响应时间: 在接到买方报修通知后, 将在2小时内响应, 12小时内提出解决方案, 如若故障不能排除, 24小时内提供现场服务。

服务响应时间

现质量保证期内, 对采购人的服务通知, 我公司在接报后1小时内响应, 24小时内到达场, 72小时内处理完毕。若在72小时内仍未能有效解决, 我公司72小时内免费提供同档次的设备予采购人临时使用。

产品出现故障时, 我公司立即响应, 24小时内到达现场。“假日无休”, 保证所有服务的及时处理。7x24 小时热线;

我公司(或我所投产品的制造商/代理商)在国内设有稳定的售后服务机构和团队, 并配备受过专业培训的售后服务技术人员, 及时响应采购人的要求。

交货期: 合同签订后 30 日内交货。

交货地点: 采购人指定地点。

维护保养服务承诺

质保期内, 我公司与设备厂家定期派出工程师上门维护保养和更新相应软件, 保证客户在使用设备时顺利流畅。派出的工程师将携带操作规程, 讲解设备的结构和性能, 熟悉安全操作规范。质保期内包修, 产生的费用包含在投标报价中, 质保期后按实际更换的零配件费用收取。

我公司保证所供产品符合招标文件承诺和所签合同规定的技术要求。

我公司保证货物是全新的(出厂日期距离合同签订之日或本项目开标之日不得超过两年), 未曾使用过的, 且进货渠道合法。货物具备出厂合格证或出厂检测报告(进口货物还要提供进口货物报关单、入境货物检验检疫证明), 其质量、规格及技术特征符合招标文件的要求。

货物的包装符合产品运输的要求, 足以保护货物在运输过程中不受锈蚀、损坏或灭失。

凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由我公司承担。

若我公司成交, 保证所提供的产品符合招标文件要求及国家或行业标准。

质保期内:

质保期内, 我可保证每年定期检查维修, 并做好记录; 除不可抗力和使用方责任外, 费用全部由我司承担。质保期内产品质量经权威机构鉴定为不符合质量要求的, 按合同协议承担违约责任。我司将建立完善的维修档案, 为用户提供咨询服务。

- 1) 本公司提供即时响应服务, 对供方的服务指示信息, 1小时内响应, 如需上门维护, 24 小时内到位。
- 2) 及时提供非设备本身质量引起的其它意外故障的处理。
- 3) 在保修期内, 凡设备在开箱检验、安装调试、设备调试运转过程中发现的设备及工程质量问题, 实行包修、包换、包退, 直到产品符合质量要求。承担修理、调换、退货发生的一切费用。

4) 免费负责修理和更换任何由于自身的质量问题造成的损坏及故障。修好后, 我公司将一式两份报告给用户, 包括故障原因、解决措施、完成修理所需时间及恢复正常运行日期。

质保期外:

- (1) 保修期满后我公司对货物终身负责维修、安装服务。
- (2) 产品终身跟踪维护, 同时提供日常周期保养服务。
- (3) 质保期满后上门维修免费, 只按厂价收取所换的配件材料、维修材料费, 不收取任何维护费用。不额外收取人工费和差旅费, 在接到用户要求对所购仪器设备进行维修的通知后, 即给予答复, 并派合格的维修工程师在 24 小时内到达用户现场进行维修。
- (4) 设有专业技术服务热线, 最终用户可以通过电话交流的方式直接与服务工程师沟通, 了解产品的各种性能、操作方法和简单故障排除。
- (5) 软件升级: 依据实际情况提供不同形式的软件终身免费升级服务。

五、其他事项

- 1、返厂维修时请您妥善保管, 防压、防潮, 购买足额运输保险, 以免在运输过程中造成损坏及不必要的损失。
- 2、不论设备因何种原因发生故障, 请立即停止使用并联系我们维修。
- 3、本承诺适用于戴维公司在中华人民共和国境内销售的全部戴维公司产品。
- 4、戴维公司只提供本承诺所包含的服务, 不对任何销售人员或代理商、分销商做出的超出本承诺内容的承诺负责。
- 5、戴维公司保留对本承诺的最终解释权。



7、商务偏离表

四、商务要求偏离表

所投分标：04分标

项目	招标文件商务要求	投标人的承诺	偏离说明
交付的时间和地点	1、交付时间：自合同签订之日起30天内交货并安装调试合格。	1、交付时间：自合同签订之日起30天内交货并安装调试合格。	无偏离
	2、交货地点：采购人指定地点。	2、交货地点：采购人指定地点。	无偏离
付款条件（进度和方式）	本分标项目无预付款,项目验收合格交付使用后30日内支付第一笔合同款的35%,第二笔合同款在验收合格交付使用6个月后的15个工作日内支付合同款的30%,第三笔剩余35%的合同款,在验收合格交付使用12个月的15个工作日内支付(无息)。中标供应商在采购人付款前支付(无息)。中标供应商在采购人开具完税发票给采购人,税费由中标供应商承担。	本分标项目无预付款,项目验收合格交付使用后30日内支付第一笔合同款的35%,第二笔合同款在验收合格交付使用6个月后的15个工作日内支付合同款的30%,第三笔剩余35%的合同款,在验收合格交付使用12个月的15个工作日内支付(无息)。中标供应商在采购人付款前支付(无息)。中标供应商在采购人开具完税发票给采购人,税费由中标供应商承担。	无偏离
售后服务要求及培训要求	1.供应商负责货物运输、保险及卸货至采购人指定地点,提供上门安装调试服务,且不得额外收取运输、安装、调试等任何费用。采购人需要设备开放数据端口接入业务系统时,中标供应商无条件配合并承担	1.供应商负责货物运输、保险及卸货至采购人指定地点,提供上门安装调试服务,且不得额外收取运输、安装、调试等任何费用。采购人需要设备开放数据端口接入业务系统时,中标供应商无条件配合	无偏离

相应接口费用。	并承担相应接口费用。	
2.当采购人需设备开放数据端口以接入业务系统时,中标供应商应无条件开放设备的数据通信技术接口服务全端口;若医院有相关需求,中标交供应商需负责将该产品接入医院的 HIS 系统、LIS 系统、PASS 系统等,相关接口技术服务费由厂家承担。	2.当采购人需设备开放数据端口以接入业务系统时,中标供应商应无条件开放设备的数据通信技术接口服务全端口;若医院有相关需求,中标交供应商需负责将该产品接入医院的 HIS 系统、LIS 系统、PASS 系统等,相关接口技术服务费由厂家承担。	无偏离
3.维修响应:在设备整个使用期内,投标人应确保设备的正常使用,在接到用户维修要求后应2小时内作出回应,在接到报修通知后12小时内派技术员到达现场维修(单个设备有特殊要求的或不可抗力情形除外),一般故障不超过12小时排除,重大故障不超过24个小时排除,特殊情况无法修复的,质保期内中标供应商应无条件更换新设备或提供代用设备;或采取使设备可正常运转的措施。投标人应提供7*24通过远程、上门服务、电话、E-mail等方式为用户提供终身完善的售前和	3.维修响应:在设备整个使用期内,在我公司确保设备的正常使用,在接到用户维修要求后应2小时内作出回应,在接到报修通知后12小时内派技术员到达现场维修(单个设备有特殊要求的或不可抗力情形除外),一般故障不超过12小时排除,重大故障不超过24个小时排除,特殊情况无法修复的,质保期内我公司无条件更换新设备或提供代用设备;或采取使设备可正常运转的措施。我公司提供7*24通过远程、上门服务、电话、E-mail等方式为用户提供终身完善的售前和	无偏离

售后技术咨询服务。质保期内定期对设备进行免费保养和维护，每季度不少于1次定期回访及对系统进行维护。提供终身有偿维护和保养服务。投标人必须设有针对本项目的售后服务点，保证长期良好的售后服务，并列明售后服务点的详细地址、联系电话及技术服务人员。	技术咨询服务。质保期内定期对设备进行免费保养和维护，每季度不少于1次定期回访及对系统进行维护。提供终身有偿维护和保养服务。我公司设有针对本项目的售后服务点，保证长期良好的售后服务，售后服务点详细地址及联系人电话详见售后服务承诺书。	
4.保修期要求为至少3年（如“技术要求”中另有要求的，按其规定）生产厂商有承诺的按生产厂商承诺执行（但不得低于3年，保修期过后，定期对设备提供终身维修、维护服务，维修只收材料成本费。	4.保修期要求为至少3年（如“技术要求”中另有要求的，按其规定）生产厂商有承诺的按生产厂商承诺执行（但不得低于3年，保修期过后，定期对设备提供终身维修、维护服务，维修只收材料成本费。	无偏离
5.人员培训： (1)交货时由生产厂商工程技术人员为用户提供使用技术培训，并使操作人员达到能独立、熟练操作及维护仪器的程度。使用培训为验收要件之一，没有经过培训，视为没能完成验收。培训结束后，中标供应商应为相关人员提供厂家出具的	5.人员培训： (1)交货时由生产厂商工程技术人员为用户提供使用技术培训，并使操作人员达到能独立、熟练操作及维护仪器的程度。使用培训为验收要件之一，没有经过培训，视为没能完成验收。培训结束后，中标供应商应为相关人员提供厂家出具的	无偏离

	产品使用培训证书。	的产品使用培训证书。	
	(2)培训对象：使用单位的设备使用人员及维修人员。	(2)培训对象：使用单位的设备使用人员及维修人员。	无偏离
	(3)培训形式：现场使用培训方式，安装调试结束后，供方培训工程师对机器正确使用方法进行示范操作，保证教会使用人员能正确使用设备。中标供应商供货时每一个产品必须提供详细参数说明书各壹套给采购人存档。否则采购人有权拒绝货物进场，造成的损失由中标人负责。	(3)培训形式：现场使用培训方式，安装调试结束后，供方培训工程师对机器正确使用方法进行示范操作，保证教会使用人员能正确使用设备。中标供应商供货时每一个产品必须提供详细参数说明书各壹套给采购人存档。否则采购人有权拒绝货物进场，造成的损失由中标人负责。	无偏离
质保期	1.所有投标设备必须根据《医疗器械监督管理条例》及相关国家标准、产品技术要求执行，整机质保至少1年（如“技术参数及其性能（配置）要求”中另有要求，按其规定）。质保期自设备验收合格并能正常使用之日起计算。如投标文件中提供产品生产厂家对质保期的承诺，且与投标人承诺不一致时，以生产厂家承诺为准。质保期内，中标人将负责处理并解决故障，并免费更换。	1.所有投标设备必须根据《医疗器械监督管理条例》及相关国家标准、产品技术要求执行，整机质保至少1年（如“技术参数及其性能（配置）要求”中另有要求，按其规定）。质保期自设备验收合格并能正常使用之日起计算。如投标文件中提供产品生产厂家对质保期的承诺，且与投标人承诺不一致时，以生产厂家承诺为准。质保期内，中标人将负责处理并解决故障，并免费更换。	无偏离

	有故障的零、35部件，一切费用由中标人负责。终身提供维修服务，质保期外维修只收材料成本费。	有故障的零、35部件，一切费用由中标人负责。终身提供维修服务，质保期外维修只收材料成本费。	
	2.质保内容:质保整机(整台、整套)质保期内保证设备的合法性使用，国家强制检测由中标人负责，质保期内的质量责任由中标人承担；质保期内保证所保设备全年工作日的开机率至少达到95%，全年工作按照365天计算，未达到的天按1:2比例顺延服务期时间。投标文件必须提供产品核心部件的质保年限清单。	2.质保内容:质保整机(整台、整套)质保期内保证设备的合法性使用，国家强制检测由中标人负责，质保期内的质量责任由中标人承担；质保期内保证所保设备全年工作日的开机率至少达到95%，全年工作按照365天计算，未达到的天按1:2比例顺延服务期时间。投标文件必须提供产品核心部件的质保年限清单。	无偏离
验收要求	1.中标供应商交货时，所有产品均严格按签订的采购合同、响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到要求的不予验收，视为产品验收不合格，采购单位可解除双方的供货合同。	1.中标供应商交货时，所有产品均严格按签订的采购合同、响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到要求的不予验收，视为产品验收不合格，采购单位可解除双方的供货合同。	无偏离
	2.中标供应商所提供的所有设备必须是签订合同之日前1年内生产的机型。若设备生产年限超出约定，	2.中标供应商所提供的所有设备必须是签订合同之日前1年内生产的机型。若设备生产年限超出约定，	无偏离

	采购人有权拒收, 中标人需赔偿合同金额 5% 的违约金, 并承担重新采购的额外成本。	定, 采购人有权拒收, 中标人需赔偿合同金额 5% 的违约金, 并承担重新采购的额外成本。	
	3. 中标供应商所提供的产品必须是具备厂商合法渠道的全新的、完整的、未使用过的产品。	3. 我公司承诺所提供的产品必须是具备厂商合法渠道的全新的、完整的、未使用过的产品。	无偏离
	4. 所提供产品, 如有质量监督、环保等部门要求对产品进行检测、检验时, 必须派出厂方代表协助检查发现产品质量问题, 供货方和制造商应承担全部责任及相应的责任。	4. 所提供产品, 如有质量监督、环保等部门要求对产品进行检测、检验时, 必须派出厂方代表协助检查发现产品质量问题, 供货方和制造商应承担全部费用及相应的责任。	无偏离
	5. 其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目验收管理办法的通知》[桂财采(2015)22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库(2016)205 号]规定执行。	5. 其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目验收管理办法的通知》[桂财采(2015)22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库(2016)205 号]规定执行。	无偏离
包装和运输 (如有)	无	无	无偏离
保险 (如有)	无	无	无偏离
核心产品	本项目第1项、第2项设备“宫腔镜 (一体镜)、冷刀宫腔镜”为本次	本项目第1项、第2项设备“宫腔镜 (一体镜)、冷刀宫腔镜”为本次	无偏离

	采购的核心产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。	采购的核心产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。	
其他要求	1.投标时提供投标文件彩色图片或说明书（标明主要技术参数）。	1.投标时提供投标产品彩色图片或说明书（标明主要技术参数）。	无偏离
	2.采购人设备主管科室对本合同质保服务内容全程对接和监督，并对服务情况进行客观记录，在每个合同年度期结束时，由设备主管科室根据合同约定的服务内容、响应情况、服务态度及过程记录。	2.采购人设备主管科室对本合同质保服务内容全程对接和监督，并对服务情况进行客观记录，在每个合同年度期结束时，由设备主管科室根据合同约定的服务内容、响应情况、服务态度及过程记录。	无偏离
	3.采购人在货物交货验收阶段发现货物的技术参数指标达不到采购文	3.采购人在货物交货验收阶段发现货物的技术参数指标达不到采	无偏离

	件该货物技术参数要求的,属虚假应标行为,采购人将终止合同拒收货物,追究该成交单36位违约责任,赔偿采购人因采购时间延长造成采购经济等方面损失。	购文件该货物技术参数要求的,属虚假应标行为,采购人将终止合同拒收货物,追究该成交单36位违约责任,赔偿采购人因采购时间延长造成采购经济等方面损失。	
	4.中标供应商经营第二类医疗器械的须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》。	4.中标供应商经营第二类医疗器械的须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》。	无偏离
	5.必须无条件向采购人开放数据通讯技术接口服务全端口。	5.无条件向采购人开放数据通讯技术接口服务全端口。	无偏离
	6.如果采购人需求,中标供应商需负责将该产品接入医院的 HIS 系统、LIS 系统、PASS 系统等系统,相关接口技术服务费由厂家承担。	6.如果采购人需求,中标供应商需负责将该产品接入医院的 HIS 系统、LIS 系统、PASS 系统等系统,相关接口技术服务费由厂家承担。	无偏离
医疗器械注册证	投标产品属第一类医疗器械产品的,投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》(国家市场监督管理总局令第 47 号)提供该设备在负责药品监督管理的部门提交备案资料证明材料复印件(或扫描件)加盖投标人电子签章;投标产品属第二、三类医疗器械产品的,投标文件中须按《医疗器械注册与	投标产品属第一类医疗器械产品的,投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》(国家市场监督管理总局令第 47 号)提供该设备在负责药品监督管理的部门提交备案资料证明材料复印件(或扫描件)加盖投标人电子签章;投标产品属第二、三类医疗器械产品的,投标文件中须按《医疗器械注册与	无偏离

	备案管理办法》(国家市场监督管理总局令第 47 号)提供该设备有效的药品监督管理部门出具的医疗器械注册证复印件(或扫描件)加盖投标人电子签章。否则投标无效	册与备案管理办法》(国家市场监督管理总局令第 47 号)提供该设备有效的药品监督管理部门出具的医疗器械注册证复印件(或扫描件)加盖投标人电子签章。否则投标无效	
资料要求	投标产品属第一类医疗器械产品的,投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》(国家市场监督管理总局令第 47 号)提供该设备在负责药品监督管理的部门提交备案资料证明材料复印件(或扫描件)加盖投标人电子签章;投标产品属第二、三类医疗器械产品的,投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》(国家市场监督管理总局令第 47 号)提供该设备有效的药品监督管理部门出具的医疗器械注册证复印件(或扫描件)加盖投标人电子签章。否则投标无效	投标产品属第一类医疗器械产品的,投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》(国家市场监督管理总局令第 47 号)提供该设备在负责药品监督管理的部门提交备案资料证明材料复印件(或扫描件)加盖投标人电子签章;投标产品属第二、三类医疗器械产品的,投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》(国家市场监督管理总局令第 47 号)提供该设备有效的药品监督管理部门出具的医疗器械注册证复印件(或扫描件)加盖投标人电子签章。否则投标无效	无偏离

法定代表人或者委托代理人

投标人(电子签



日期

2026年02月05日

8、技术偏离表

二、技术要求偏离表

技术要求偏离表

所投分标：04分标

项号	标的名称	技术要求	投标响应	偏离说明
1	宫腔镜（一体镜）	一、基本要求 用于宫腔疾病的治疗，包括子宫肌瘤、息肉、粘连、畸形以及异物残留等； 二、配置要求 1、宫腔镜（一体）规格7Fr/30° 数量1pc 2、宫腔镜配套手术器械（剪刀）规格Φ2.0*410或7Fr*385mm 数量1pc 3、宫腔镜配套手术器械（异物钳）规格Φ2.0*410或7Fr*385mm 数量1pc 4、宫腔镜配套手术器械（活检钳）规格Φ2.0*410或7Fr*385mm 数量1pc 5、专用内窥镜消毒盒 数量1pc 三、具体规格及技术参数 1.用于宫腔疾病的治疗，包括子宫肌瘤、息肉、粘连、畸形以及异物残留等； 2.具有 7Fr 的手术器械通道，在可视情况下手术操作； 3.超广角镜头，视场角90°； 4.视向角 30°、景深 3mm~100mm 5.插入部工作长度200mm，插入部最大宽度 ≤5.4mm，免扩宫； 6.插入部前端为圆滑无创设计，减少对宫颈口的损伤，方便进入宫腔 7.可配备多种器械，包括剪刀、活检钳、异物钳等； 8.镜鞘一体，含无创末端，与内窥镜联体设计，镜体更细，进出水更通畅 9.器械插入口为喇叭形，方便器械进入	一、基本要求 用于宫腔疾病的治疗，包括子宫肌瘤、息肉、粘连、畸形以及异物残留等； 二、配置要求 1、宫腔镜（一体）规格7Fr/30° 数量3pc 2、宫腔镜配套手术器械（剪刀）规格Φ2.0*410 数量3pc 3、宫腔镜配套手术器械（异物钳）规格Φ2.0*410 数量 3pc 4、宫腔镜配套手术器械（活检钳）规格Φ2.0*410 数量 3pc 5、专用内窥镜消毒盒 数量 3pc 三、具体规格及技术参数 1.用于宫腔疾病的治疗，包括子宫肌瘤、息肉、粘连、畸形以及异物残留等； 2.具有 7Fr 的手术器械通道，在可视情况下手术操作； 3.超广角镜头，视场角≥90° 4.视向角 30°、景深3mm~100mm 5.插入部工作长度≥200mm，插入部最大宽度≤5.4mm，免扩宫 6.插入部前端为圆滑无创设计，减少对宫颈口的损伤，方便进入宫腔 7.可配备多种器械，包括剪刀、活检钳、异物钳等； 8.镜鞘一体，含无创末端，与内窥镜联体设计，镜体更细，进出水更通畅 9.器械插入口为喇叭形，方便器械进入	无偏离 无偏离 无偏离 正偏离 见配置清单 正偏离 见配置清单 正偏离 见配置清单 正偏离 见配置清单 正偏离 见配置清单 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离

		10. 密封帽内置，双层医用硅胶致密密封防漏水设计，自动闭合操作通道	10. 密封帽内置，双层医用硅胶致密密封防漏水设计，自动闭合操作通道	无偏离
		11. 器械通道无磁片设计，避免影响输卵管疏通导丝等术中耗材通过，且与手术器械紧密包裹，杜绝气泡进入宫腔；	11. 器械通道无磁片设计，避免影响输卵管疏通导丝等术中耗材通过，且与手术器械紧密包裹，杜绝气泡进入宫腔；	无偏离
		12. 进出水口可根据手术需求360° 旋转，防止水路管缠绕，方便医生操作。避免宫颈口损伤；	12. 进出水口可根据手术需求360° 旋转，防止水路管缠绕，方便医生操作避免宫颈口损伤；	无偏离
		13. 可耐高温高压消毒，镜体密封性好，内镜上标有可耐压力蒸汽灭菌（Autoclav）标识；	13. 可耐高温高压消毒，镜体密封性好，内镜上标有可耐压力蒸汽灭菌（Autoclav）标识；	无偏离
		14. 产品符合医疗器械国家标准GB9706.1-2020，GB/T9706.218-2021中规定的要求，设备安全性及稳定性更佳。	14. 产品符合医疗器械国家标准GB9706.1-2020，GB/T9706.218-2021中规定的要求，设备安全性及稳定性更佳。	无偏离
		四、售后服务	四、售后服务	无偏离
		1. 提供不少于壹年的免费质保期；货物在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，提供免费维修服务。	1. 提供壹年的免费质保期；货物在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，提供免费维修服务。	无偏离
		2. 设备验收合格交付使用后，免费为客户进行培训服务。培训内容为理论培训、使用操作培训、技术维护培训等。	2. 设备验收合格交付使用后，免费为客户进行培训服务。培训内容为理论培训、使用操作培训、技术维护培训等。	无偏离
		3. 保修期内，在接到维修电话后半小时内响应，2小时内作出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，专业维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院现场维修，尽快的保证用户恢复正常使用。	3. 保修期内，在接到维修电话后半小时内响应，2小时内作出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，专业维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院现场维修，尽快的保证用户恢复正常使用。	无偏离
2	冷刀宫腔镜	一、配置要求	一、配置要求	无偏离
		宫腔镜1支、鞘套1支、闭孔器1支、专用器械消毒盒1个、防漏水封帽2个	宫腔镜1支、鞘套1支、闭孔器1支、专用器械消毒盒1个、防漏水封帽2个	无偏离
		二、具体规格及技术参数	二、具体规格及技术参数	无偏离
		1. 总体要求：该套系统具有按照国家食品药品监督管理局规定，适用范围仅限于妇产科宫腔手术	1. 总体要求：该套系统具有按照国家食品药品监督管理局规定，适用范围仅限于妇产科宫腔手术	无偏离

		*1. 器械为医用不锈钢材质，不带有电能量，纯金属器械杆（不包裹黑色绝缘层），器械需要提供注册证	*1. 器械为医用不锈钢材质，不带有电能量，纯金属器械杆（不包裹黑色绝缘层），器械提供注册证	无偏离
		2. 360° 可旋转、拥有PEEK材质及金属材质的多功能手柄（不带电极接口）即PEEK无锁、PEEK带锁	2. 360° 可旋转、拥有PEEK材质及金属材质的多功能手柄（不带电极接口）即PEEK无锁、PEEK带锁	无偏离
		*3. 器械工作长度≥350毫米，器械直径≥3毫米；剪刀（单开微型剪1支、双开弯剪1支）、锯齿钳（左弯分离钳1支、鼠齿钳1支）、异物钳（强力抓钳1支）、活检钳1支	*3. 器械工作长度≥350毫米，器械直径≥3毫米；剪刀（单开微型剪1支、双开弯剪1支）、锯齿钳（左弯分离钳1支、鼠齿钳1支）、异物钳（强力抓钳1支）、活检钳1支	无偏离
		三、售后服务	三、售后服务	无偏离
		1、上门安装服务：免费送货上门，免费安装调试，免费培训；按国家标准实行“三包”。	1、上门安装服务：免费送货上门，免费安装调试，免费培训；按国家标准实行“三包”。	无偏离
		2、保修政策：（1）保修服务：提供终身；（2）保修方式：上门维修、寄送修。	2、保修政策：（1）保修服务：提供终身；（2）保修方式：上门维修、寄送修。	无偏离
		3、主机保修期：12月（从终端签收时间开始计算）	3、主机保修期：12月（从终端签收时间开始计算）	无偏离
		4、换货政策：若有质量问题，厂家无条件15天内换全新产品（从终端签收时间开始计算）	4、换货政策：若有质量问题，厂家无条件15天内换全新产品（从终端签收时间开始计算）	无偏离
3	新生儿黄疸治疗箱	一、基本配置：	一、基本配置：	无偏离
		1. 上箱体【含上灯箱（光源为LED）、控制仪、婴儿床】，	1. 上箱体【含上灯箱（光源为LED）、控制仪、婴儿床】，	无偏离
		2. 下箱体【含下灯箱（光源为LED）、储物柜】	2. 下箱体【含下灯箱（光源为LED）、储物柜】	无偏离
		二、产品主要功能、技术参数及要求：	二、产品主要功能、技术参数及要求：	无偏离
		1、电源要求：AC220V/50Hz；	1、电源：AC220V/50Hz；	无偏离
		2、输入功率：≤800VA；	2、输入功率：600VA；	正偏离，见技术参数第2条
		3、黄疸箱温度显示的平均值与实际黄疸箱温度平均值之差（恒温状态下）：≤±0.8℃；	3、黄疸箱温度显示的平均值与实际黄疸箱温度平均值之差（恒温状态下）：≤±0.8℃；	无偏离
		4、温度控制范围：25℃~34℃；	4、温度控制范围：25℃~34℃；	无偏离
		5、床面温度均匀性：0.8℃内；	5、床面温度均匀性：≤0.8℃	无偏离
		6、肤温显示范围：10℃~42℃；	6、皮肤温度显示范围：5℃~65℃	正偏离 见技术参数第6条
		▲7、皮肤温度传感器精度：±0.2℃内；	7、皮肤温度传感器精度：±0.1℃内	正偏离 见技术参数

			第7条
8. 床面温度均匀性: $\leq 0.8^{\circ}\text{C}$	8. 床面温度均匀性: $\leq 0.8^{\circ}\text{C}$	无偏离	
9. 故障报警: 超温报警、断电报警、传感器报警、偏差报警、风机报警、系统报警;	9. 故障报警: 超温报警、断电报警、传感器报警、偏差报警、风机报警、系统报警;	无偏离	
10. 婴儿床面上的工作噪声: $\leq 55\text{dB(A)}$, 环境噪音在 45dB(A) 以下;	10. 婴儿床面上的工作噪声: $\leq 55\text{dB(A)}$, 环境噪音在 45dB(A) 以下;	无偏离	
11. 报警声级: 婴儿床面上 $\leq 80\text{dB(A)}$, 距离控制仪正前方 3m 处, 至少 65dB(A) ;	11. 报警声级: 婴儿床面上 $\leq 80\text{dB(A)}$, 距离控制仪正前方 3m 处, 至少 65dB(A) ;	无偏离	
12. 床面上有效表面内的总辐照度: $\geq 2.0\text{mW}/\text{cm}^2$ (上灯箱光源为LED) $\geq 3.0\text{mW}/\text{cm}^2$ (下灯箱);	12. 床面上有效表面内的总辐照度: $\geq 2.0\text{mW}/\text{cm}^2$ (上灯箱光源为LED) $\geq 3.0\text{mW}/\text{cm}^2$ (下灯箱);	无偏离	
13. 床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值: $\geq 1.5\text{mW}/\text{cm}^2$ (上灯箱光源为LED) $\geq 2.5\text{mW}/\text{cm}^2$ (下灯箱)	13. 床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值: $\geq 1.5\text{mW}/\text{cm}^2$ (上灯箱光源为LED) $\geq 2.5\text{mW}/\text{cm}^2$ (下灯箱)	无偏离	
14. 床面上有效表面内的最高胆红素总辐照度: $2.2\text{mW}/\text{cm}^2$ (上灯箱光源为LED) $3.5\text{mW}/\text{cm}^2$ (下灯箱)	14. 床面上有效表面内的最高胆红素总辐照度: $2.2\text{mW}/\text{cm}^2$ (上灯箱光源为LED) $3.5\text{mW}/\text{cm}^2$ (下灯箱)	无偏离	
15. 床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性: >0.4	15. 床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性: >0.4	无偏离	
▲16. 两侧和正门有机玻璃均可打开, 方便操作	▲16. 两侧和正门有机玻璃均可打开, 方便操作	无偏离	
三、售后服务	三、售后服务	无偏离	
1. 提供 ≥ 3 年的免费质保期, 提供免费维修服务。	1. 提供3年的免费质保期, 提供免费维修服务。	无偏离	
2. 调试安装结束交付使用后, 免费进行培训服务。培训内容为理论培训、使用操作培训、技术维护培训等。	2. 调试安装结束交付使用后, 免费进行培训服务。培训内容为理论培训、使用操作培训、技术维护培训等。	无偏离	
3. 保修期内, 乙方在接到维修电话后半小时内响应, 2小时内作出维修方案决定; 如2小时内无法通过电话解决问题, 专业维修人员必须在接到故障报告后24小时内达到医院现场维修, 尽快的保证用户恢复正常使用。	3. 保修期内, 我司在接到维修电话后半小时内响应, 2小时内作出维修方案决定; 如2小时内无法通过电话解决问题, 专业维修人员必须在接到故障报告后24小时内达到医院现场维修, 尽快的保证用户恢复正常使用。	无偏离	

法定代表人或者委托代理人 (签字) _____

投标人 (电子签章): 上海腾跃医疗设备有限公司

日期: 2026年02月05日

9、设备性能配置清单

一、设备性能配置清单

设备性能配置清单

序号	货物名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
1	宫腔镜（一体镜）	3套	科迈森	KMS-IV（一体）	湖南科迈森医疗科技有限公司	湖南	详见附件1产品技术参数及配置清单
2	冷刀宫腔镜	1套	科迈森	KMS-II（Z）	湖南科迈森医疗科技有限公司	湖南	详见附件1产品技术参数及配置清单
3	新生儿黄疸治疗箱	5台	戴维	XHZ-100A	宁波戴维医疗器械股份有限公司	浙江	详见附件1产品技术参数及配置清单

备注：

以上设备性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则按无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签章）：尹绍南
 投标人（电子签章）：湖南尚德医疗设备有限公司



产品性能参数

(一)、宫腔镜(一体镜)

1. ▲镜体设计为一体式设计,插入部前端截面可观察到进水通道为对称独立通道,与光学镜体间无缝隙,降低感染控制风险;
2. 具有 7Fr 的手术器械通道,在可视情况下手术操作;
3. ▲超广角镜头,视场角 $\geq 90^\circ$;
4. ▲视向角 30° ,景深 $3\text{mm}-100\text{mm}$;
5. 插入部工作长度 $\geq 200\text{mm}$,插入部最大宽度 $\leq 5.4\text{mm}$,免扩宫;
6. 插入部前端为圆滑无创设计,减少对宫颈口的损伤,方便进入宫腔;
7. 可配备多种器械,包括刮匙、电切器、电钩等;
8. 镜鞘一体,全无创鞘,鞘内器械通道设计,镜体更细,进出水更通畅;
9. 器械插入口为喇叭状,方便器械插入;
10. ▲密封帽内置,对腔内器械起到密封防水设计,自动闭合操作通道;
11. ★器械通道无垫片设计,避免影响器械通道等术中耗材通过,且与手术器械紧密包裹,杜绝气漏进入宫腔;
12. 进出水口可根据手术需求 360° 旋转,防止水路管缠绕,方便医生操作,避免宫颈口损伤;
13. ★产品符合医疗器械国家标准 GB9706.1-2020、GB9706.218-2021 中规定的要求,设备安全性及稳定性更优;
14. ★产品可耐高温、低温等离子灭菌,需提供低温等离子灭菌设备校准证书、高温高压灭菌器校准证书、灭菌参数验证报告及原始灭菌数据;
15. ★产品具备优异的密封性,使用寿命更耐久:耐高温高压灭菌 ≥ 600 次,内镜上标有可耐压蒸汽灭菌(Autoclave)标识;
16. ★考虑产品研发及生产过程的质量可控性、性能稳定性,投标产品的注册证和生产许可证信息,注册人和生产企业要同一名称,注册人住所和生产地址应为同一地址,不接受贴牌生产产品。

(二)、宫腔镜 KMS-II (Z)

1. 用于宫腔检查、宫腔疾病的治疗,通过实现宫腔镜手术器械巨型化以完成有困难的手术检查和治疗,如子宫纵膈、子宫肌瘤、宫腔息肉、宫腔粘连以及异物嵌顿或胚胎残留取出等;
2. ★平行视野 Z 型宫腔镜,视向角 22° ,符合临床使用习惯(优于非平行视野的 Y 型镜);
3. 景深 $3\text{mm}-100\text{mm}$;

4. ▲具有超广角视野，视场角 $\geq 100^\circ$ ；
5. ▲最佳镜体外观设计，符合人体工程学，方便握持，Z型镜杆与镜杆更短，镜杆长度 $\leq 6.5\text{cm}$ ，术中旋转镜子更省力，不易从宫腔内滑出，操作方便更安全；
6. 蓝宝石镜面，进口光学玻璃晶棒、光纤、光锥，柱状晶体排列技术，采用新型光学系统设计，高清分辨率，主镜工作长度 $\geq 200\text{mm}$ ；
7. ▲外径 $\leq 6.8\text{mm}$ ，总体插入部外径较细，避免因外径过大，无法顺利通宫颈口的问题，保护了子宫下端至宫颈内口位置的子宫内膜；
8. ▲视场中心角分辨率 $\geq 3.5\text{C}/\text{mm}$ ；(此参数越大成像越清晰)
9. ▲综合边缘光效 $\text{SLe-Z} \geq 0.4$ ；(此参数值越接近1越好)
10. ▲单位相对畸变 VU-Z 的控制量 $\leq 15\%$ ；
11. 目镜和器械通道呈平行型设计，保证摄像头获得视野角度即为实时角度，顺应了医生的使用习惯，避免了误操作；
12. ▲平行视野宫腔镜镜体长度 $\geq 3\text{mm}$ ，器械通道包含在镜体内，镜子手术器械通道 $\geq 3\text{mm}$ ，注液通道 $\geq 1.0\text{mm}$ ；
13. ▲器械通道入口采用喇叭口设计，方便器械进入；
14. ▲密封帽内置设计，双层医用硅胶装置密封闭合，无需单独开关，防止术中宫腔液体向术者喷溅，便于手术中切换不同器械；
15. ★器械通道无磁片设计，避免因非管道通导丝等术中耗材通过，且与手术器械紧密包裹，杜绝气泡进入宫腔；
16. ▲可配备多种器械，至少包括圆头弯剪刀、尖头单开直剪刀、尖头双开直剪刀、微型钩剪刀、弯分离钳、活检钳、重型抓钳、大型抓钳等；各类手术器械工作长度 360mm ， 360° 可旋转手柄，工作头外径 3mm ，具备更有力的操作，不易损坏，更耐用，头部精雕设计，无外露关节，保证操作视野不受影响；
17. 手术器械最小化三折卸设计(手柄、钳杆、钳芯)符合内镜手术器械清洗灭菌要求，清洗更彻底，消毒灭菌更彻底，易损件更换成本更低。可低温等离子、高温高压消毒，避免因消毒不彻底而造成术中感染；
18. ★产品符合医疗器械国家标准 GB9706.1-2020、GB9706.218-2021 中规定的要求，设备安全性及稳定性更佳；
19. ★可耐高温高压消毒，镜体密封性好，内镜上标有可耐压力蒸汽灭菌(Autoclave)标识；
20. ★可低温等离子消毒，可提供厂家低温等离子消毒设备校准证书和验证报告；
21. 进出水高通量设计，持续对流，保证了手术视野的清晰；

22. ▲进出水口均在外鞘实现湍流循环，优于镜体内循环，水流量更大；进出水口可根据手术需求 360 度旋转，防止进出水路管缠绕，方便手术操作；
23. 操作系统配备专用消毒盒，方便医院选择不同消毒方式分别灭菌和存放，保护镊子及器械附件使用功能正常；
24. ▲配套手术器械注册证为宫腔镜配套手术器械，注册适用范围应适用于配合宫腔镜下宫腔内疾病的检查和治疗；
25. ★产品具备优异的密封性，使用寿命更耐久；耐高温高压灭菌≥500 次；
26. ★考虑产品研发及生产过程的质量可控性、性能稳定性，投标产品的注册证和生产许可证信息，注册人和生产企业要同一名称。注册人住所和生产地址应为同一地址。不接受贴牌生产产品。



配置清单

序号	产品名称	型号	规格	数量	品牌
1	宫腔镜	KMS-IV(一体)	7Fr/30"	3pc	科迈森
2	宫腔镜配套手术器械 (剪刀)	KMS-QX-II	Φ2.0*410	3pc	科迈森
3	宫腔镜配套手术器械 (异物钳)	KMS-QX-II	Φ2.0*410	3pc	科迈森
4	宫腔镜配套手术器械 (活检钳)	KMS-QX-II	Φ2.0*410	3pc	科迈森
5	专用内窥镜消毒盒	/	/	3pc	科迈森
6	宫腔镜	KMS-II (Z)	20.8Fr/22"	1pc	科迈森
7	宫腔镜配套手术器械 (单开剪刀)	KMS-QX-II	Φ3*360	1pc	科迈森
8	宫腔镜配套手术器械 (双开剪刀)	KMS-QX-II	Φ3*360	1pc	科迈森
9	宫腔镜配套手术器械 (弯剪刀)	KMS-QX-II	Φ3*360	1pc	科迈森
10	宫腔镜配套手术器械 (电剪刀)	KMS-QX-II	Φ3*360	1pc	科迈森
11	宫腔镜配套手术器械 (弯分离钳)	KMS-QX-II	Φ3*360	1pc	科迈森
12	宫腔镜配套手术器械 (活检钳)	KMS-QX-II	Φ3*360	1pc	科迈森
13	宫腔镜配套手术器械 (大型抓钳)	KMS-QX-II	Φ3*360	1pc	科迈森
14	宫腔镜配套手术器械 (重型抓钳)	KMS-QX-II	Φ3*360	1pc	科迈森
15	专用内窥镜器械消毒盒	/	/	1pc	科迈森

戴维 XHZ-100A 新生儿黄疸治疗箱技术参数

基本配置：上箱体【含上灯箱（光源为 LED）、控制仪、婴儿床】；下箱体【含下灯箱（光源为 LED）、储物柜】

技术规格

1. 电源要求：AC220V/50Hz
2. 输入功率：600VA
3. 温度控制范围：25℃~34℃
4. 黄疸箱温度显示的平均值与实际黄疸箱温度平均值之差（恒温状态下）：≤±0.8℃
5. 床面温度均匀性：≤0.8℃
6. 皮肤温度显示范围：5℃~65℃
7. ★皮肤温度传感器精度：±0.1℃内
8. 上灯箱床面上有效表面内总辐照度：≥2.0mW/cm²
9. 下灯箱床面上有效表面内总辐照度：≥2.0mW/cm²
10. 床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：≥0.8mW/cm²
11. 报警项目：超温报警、断电报警、风机报警、系统故障报警。
12. 箱温控制，肤温监测，提供温度适宜的蓝光治疗环境
13. 具有双面 LED 蓝光辐照功能，高效退黄
14. 光照治疗时间计时功能
15. ★两侧和正门的有机玻璃均可打开
16. 抽拉式水箱，方便拆卸，清洁消毒
17. 正门双重保险设计，双重防护避免正门意外打开
18. 采用无刷直流电机驱动热循环，能有效的控制温度
19. ★具有整机注册证明，符合国家安全需求
20. 婴儿床面上的工作噪声：≤55dB(A)，环境噪音在 45dB(A) 以下
21. 床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥1.5mW/cm²（上灯箱光源为 LED）
≥2.5mW/cm²（下灯箱）
22. 床面上有效表面内的最高胆红素总辐照度：2.2mW/cm²（上灯箱光源为 LED）
3.5mW/cm²（下灯箱）



新生儿黄疸治疗箱装箱清单 (XHZ-100, XHZ-100A, XHZ-100B, XHZ-100C)



下表所列的零、部、配件为产品装箱时应具备的所有物件，请用户在拆箱时核实。

编号	部件	数量	备注
1	上箱体 (包括婴儿床, 输液架)	1	
2	下箱体	1	
3	脚轮	4	
4	弹簧垫圈 12	4	
5	平垫圈 12	4	
6	皮肤温度传感器	1	
7	电源线	1	
8	F 型熔丝管 5AH/250V	2	备用
9	空气过滤材料	1	
10	操作窗塑料套	4	
11	十字螺丝刀	1	
12	内六角扳手 M4	1	随配用
13	扳手 19×22		
14	记录显示板		
15	使用说明书	1	
16	合格证	1	
17	保修卡	1	务请寄回
18	单患者使用皮肤温度传感器	1	



新生儿黄疸治疗箱装箱清单 (XJZ-100, XJZ-100A, XJZ-100B, XJZ-100C)

配件放置一览示意图

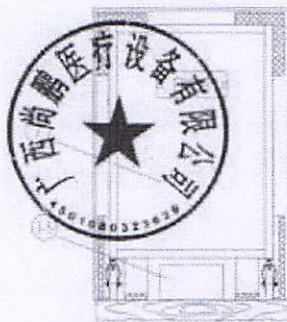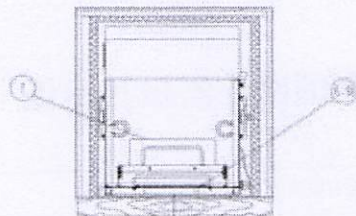

- 注：1、参照本机清单序号，各零件、附件、配件放置位置如图中所示。
2、拆箱后，箱内的干燥剂及包装材料请妥善处理。
3、*为选配部件。



装箱人：

装箱日期：

宁波戴维医疗器械股份有限公司

中华人民共和国 医疗器械变更注册（备案）文件

注册证编号：湘械注准 20222181576

产品名称	宫腔镜
变更内容	1. 产品型号由“KMS、KMS-II(Z)、KMS-III、KMS-IV（一体）”变更为“KMS、KMS-II（Z）、KMS-III、KMS-IV（一体）、KMS-V（一体）、KMS-VI”；2. 产品技术要求变更详见产品技术要求变更对比表；3. 产品结构组成变更详见产品结构组成变更对比表；
备注	“湘械注准 20222181576”注册证共同使用。

审批部门：湖南省药品监督管理局

批准日期：2024 年 04 月 26 日



中华人民共和国
医疗器械变更注册（备案）文件

注册证编号：湘械注准 20222181576

产品名称	宫腔镜
变更内容	1. 注册人住所：湖南省长沙市开福区青竹湖街道青竹湖路 769 号军民融合科技城 A 组团 A1 栋 402 变更为“湖南省长沙市开福区青竹湖街道青竹湖路 769 号军民融合科技城 A 组团架空层 01、架空层 02、101、102、201、202、301、302、401、402”
备注	湘械注准 20222181576”医疗器械注册证共同使用

审批部门：



批准日期：2025 年 03 月 12 日



中华人民共和国
医疗器械变更注册（备案）文件

注册证编号：湘械注准 20222181576

产品名称	宫腔镜
变更内容	1. 生产地址：湖南省长沙市开福区青竹湖街道青竹湖路 769 号军民融合科技城 A 组团 11 栋 101 变更为“湖南省长沙市开福区青竹湖街道青竹湖路 769 号军民融合科技城 A 组团架空层 01、架空层 02、101、102、103、202、301、302、401、402”。
备注	“湘械注准 20222181576” 医疗器械注册证共同使用

审批部门：



批准日期：2025 年 05 月 20 日



中华人民共和国医疗器械注册证

注册证编号:湘械注准 20202020018

注册人名称	湖南科迈森医疗科技有限公司
注册人住所	湖南省长沙开福区青竹湖街道青竹湖路 769 号军民融合科技城 A 组团 A1 栋 101 号
生产地址	湖南省长沙市开福区青竹湖街道青竹湖路 769 号军民融合科技城 A 组团 A2 栋 101 号
代理人名称	不适用
代理人住所	不适用
产品名称	宫腔镜配套手术器械
型号、规格	KMS-QX-II
结构及组成	产品由活检钳、密齿钳、异物钳、取环钳、剪刀(单开剪、双开剪、钩剪、弯剪)、弯分离钳、重型抓钳、大型抓钳、活检钳(勾状)组成。
适用范围	产品与宫腔镜配套,在临床上供宫腔内疾病的检查和治疗用。
附件	产品技术要求
其他内容	
备注	

审批部门:



批准日期:2024 年 09 月 19 日

生效日期:2025 年 01 月 02 日

有效期至:2030 年 01 月 01 日



中华人民共和国
医疗器械变更注册（备案）文件

注册证编号：湘械注准 20202020018

产品名称	宫腔镜配套手术器械
变更内容	注册人在：湖南省长沙市开福区青竹湖街道青竹湖路 769 号军民融合科技城 A 组团 A1 栋 401 号变更为“湖南省长沙市开福区青竹湖街道青竹湖路 769 号军民融合科技城 A 组团架空层 01、架空层 02、101、102、201、202、301、302、401、402”。
备注	湘械注准 20202020018”医疗器械注册证共同使用

市批部门：

批准日期：2025 年 03 月 13 日



中华人民共和国
医疗器械变更注册（备案）文件

注册证编号：湘械注准 20202020018

产品名称	宫腔镜配套手术器械
变更内容	1. 生产地址：湖南省长沙市开福区青竹湖街道青竹湖路 769 号军民融合科技城 A 组团 A1 栋 101，变更为“湖南省长沙市开福区青竹湖街道青竹湖路 769 号军民融合科技城 A 组团架空层 01、架空层 02、101、102、201、202、301、302、401、402”。
备注	湘械注准 20202020018”医疗器械注册证共同使用

审批部门：



批准日期：2025 年 05 月 20 日

新生儿黄疸治疗箱产品医疗器械注册证

中华人民共和国医疗器械注册证

注册证编号：浙械注准20182090033

注册人名称	宁波戴维医疗器械股份有限公司
注册人住所	浙江省宁波市象山石浦科技园区科苑路2号
生产地址	浙江省象山经济开发区滨海工业区金兴路35号；浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路2号
代理人名称	不适用
代理人住所	不适用
产品名称	新生儿黄疸治疗箱
型号、规格	XH-Z-100A, XH-Z-100B, XH-Z-100C, XH-Z-200, XH-Z-200A
结构及组成	产品由主箱体[含灯管（XH-Z-100A, XH-Z-100C光源为LED, XH-Z-100, XH-Z-100B光源为LED灯管）、控制仪、硅胶床垫（XH-Z-100, XH-Z-100A, XH-Z-100B, XH-Z-100C）、床垫（XH-Z-200, XH-Z-200A无硅胶床垫）]、箱体[含下灯箱（XH-Z-100, XH-Z-100A, XH-Z-100B, XH-Z-100C光源为LED）、储物柜和机架（XH-Z-100, XH-Z-100A, XH-Z-100B, XH-Z-100C光源为LED）、婴儿床组成。XH-Z-200, XH-Z-200A有机架并可配升降式机架）]、婴儿床组成。
适用范围	本品光源通过发射主辐射光谱处于400nm至550nm范围内的可见光，来降低新生儿体内的胆红素浓度。
附件	产品技术要求
其他内容	/
备注	原注册证编号：浙械注准20182260033。

地址：浙江省药品监督管理局

批准日期：2022年07月28日
生效日期：2023年01月10日
有效期至：2028年01月09日
(审) 202000146714

中华人民共和国 医疗器械变更注册（备案）文件

注册证编号：浙械注准 20182090033


产品名称	新生儿黄疸检测仪
变更内容	生产地址由浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴路 35 号；浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路 2 号变更为浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路 2 号。申请人根据批准变更内容，自行修订说明书和标签。
备注	本文件与“浙械注准 20182090033”医疗器械注册证共同使用。

审批部门：浙江省药品监督管理局

批准日期：2024 年 07 月 17 日

11、厂家授权书及厂家证件

宫腔镜及冷刀宫腔镜产品医疗器械注册证、厂家授权书、厂家证件



内镜视界 无限未来

授权委托书

敬启者:

我们湖南科迈森医疗科技有限公司(下称“湖南科迈森”),注册地址位于湖南省长沙市开福区青竹湖街道青竹湖路769号军民融合科技城A组团架空层01、架空层02、101、102、201、202、301、302、401、402,负责本公司生产的产品在全国的销售和服务。

湖南科迈森授权并指定[广西尚鹏医疗设备有限公司],作为湖南科迈森的代理人进行下列活动:

1.作为湖南科迈森[宫腔镜、宫腔镜配套手术器械](下称“产品”)在[右江民族医学院附属医院]的代理人,参与产品的销售以及处理产品的售后服务事宜。

2.[广西尚鹏医疗设备有限公司]只能以自己名义亲自参加上述活动,而不能就其根据本授权书获得的授权进行再授权。

本授权书授权期限自[2026]年[01]月[21]日至本项目结束。

本授权书经湖南科迈森书面撤销的,授权期限应当自书面撤销文件日起提前终止,且在任
何情况下,湖南科迈森无需就撤销授权书事宜向[广西尚鹏医疗设备有限公司]或任何第三方承
担任何责任,[广西尚鹏医疗设备有限公司]应自行承担与[右江民族医学院附属医院]产品销售
活动相关的各项责任。

湖南科迈森医疗科技有限公司

[2026]年[01]月[21]日





医疗器械生产许可证

许可证编号: 湘药监械生产许 20200008 号
 统一社会信用代码: 91430111MA4QR1WYX8

企业名称: 湖南科迈森医疗科技有限公司
 法定代表人: 徐露

住所: 湖南省长沙市开福区青竹湖街道青竹湖路 769 号军民融合科技城 A 组团架空层 01、架空层 02、101、102、201、202、301、302、401、402
 企业负责人: 王文超

生产地址: 湖南省长沙市开福区青竹湖街道青竹湖路 769 号军民融合科技城 A 组团架空层 01、架空层 02、101、102、201、202、301、302、401、402

生产范围: Ⅱ类: 18-04-81 产科治疗器械; 18-03-81 产科治疗器械; 18-01-81 产科手术器械; 06-15 内窥镜功能供给装置; 06-14 医用内窥镜; 02-13 手术器械-切割器械; 02-12 手术器械-穿刺导引器; 02-11 手术器械-牵开器; 02-10 手术器械-剥离器; 02-09 手术器械-刮匙; 02-08 手术器械-钩; 02-07 手术器械-针; 02-06 手术器械-夹; 02-05 手术器械-钳; 02-04 手术器械-剪; 02-03 手术器械-镊; 02-02 手术器械-刀; 01-09 内窥镜手术用辅助设备; 01-01 高频/射频手术设备及附件;

许可期限: 自 2025 年 01 月 20 日至 2030 年 01 月 20 日

发证部门: 湖南省药品监督管理局
 发证日期: 2025 年 01 月 28 日



新生儿黄疸治疗箱厂家授权书、厂家证件



授权委托书

兹授权：

南宁吉航医疗器械有限公司在广西地区销售我公司生产及代理的系列产品。我公司主要产品有：婴儿转运培养箱、婴儿培养箱、婴儿辐射保暖台、新生儿黄疸治疗系列、新生儿专用监护仪、医用空气压缩机、医用空气混合器、婴儿T-组合复苏器、经皮黄疸仪、远红外加温器、医用电动吸引器、呼吸复苏(器)囊、婴儿输氧头罩、婴儿头部固定架、医用婴儿床、超声多普勒胎音仪、输液泵、注射泵、医用吊桥吊塔、亚低温治疗仪、哈美顿呼吸机、凯德呼吸潮湿加热器。

授权有效期：2026年01月01日至2026年12月31日。

特此授权！



宁波戴维医疗器械股份有限公司

2026年01月01日



1、产品授权委托书

授权书

致：广西国泰招标咨询有限公司

作为设在南宁市保爱路60号10栋C4号广西总代理经销“宁波戴维医疗系列产品名称：新生儿黄疸治疗箱 XHZ-100A”的 南宁吉航医疗器械有限公司 在此以代理商的名义授权 广西尚膳医疗设备有限公司 用我公司代理的上述货物就 项目名称：购买高档心脏彩色多普勒超声仪、电子胆道内窥镜等一批医疗设备项目，项目编号：GXZC2026-G1-000063-GTJB 的项目进行销售、投标以及后续的合同谈判和签署工作等事宜。


我们在此保证为上述公司就提交的货物承担全部质量、技术、售后服务等保证责任。



授权有效期：2026年1月22日起生效至2026年4月21日。

出具授权书的注册代理商名称：南宁吉航医疗器械有限公司

(公章)



日期：2026年1月22日

供货证明

致：广西国泰招标咨询有限公司

南宁吉航医疗器械有限公司在此以代理商的名义保证为广西尚鹏医疗设备有限公司用我公司代理经销“宁波戴维医疗系列产品名称：新生儿黄疸治疗箱 XHZ-100A” 货物就项目名称：购买高档心脏彩色多普勒超声仪、电子胆道内窥镜等一批医疗设备项目，项目编号：GXZC2026-G1-000063-GTJB 的项目进行销售、投标并承诺按质、按量、按时、提供全新货物。

授权有效期：自 2026 年 1 月 22 日起生效至 2026 年 4 月 21 日。



公司名称：南宁吉航医疗器械有限公司

(公章)



日期：2026 年 1 月 22 日

营 业 执 照

(副)

统一社会信用代码
91330200610257495J (1/2)

名称 宁波康宁医疗器械股份有限公司

类型 股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人 陈再宏

经营范围 许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；技术进出口；货物进出口；进出口代理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；软件销售；软件开发；仪器仪表销售；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在：浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴路35号)

注册资本 贰亿捌仟捌佰万元整

成立日期 1992年09月18日

营业期限 1992年09月18日至长期

住 所 浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路2号

登记机关 宁波市市场监督管理局

2020年05月09日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

第二类医疗器械经营备案凭证

备案编号:浙甬械备(2016)001号

企业名称	宁波威佳医疗器械有限公司
统一社会信用代码	91330206102574951
法定代表人	陈再宏
企业负责人	陈再宏
住 所	浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路2号
经营方式	浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路2号
经营地址	浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路2号
经营范围	2017年分类目录:01, 02, 06, 07, 08, 09, 14, 15, 18; 2002年分类目录:6820, 6821, 6822, 6823, 6824, 6825, 6826, 6894, 6895

备案部门

备案日期

备案专用章

日




医疗器械经营许可证



许可证编号：浙甬食药监械经营许20170195
 企业名称：宁波甬德医疗器械股份有限公司
 住 所：浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路2号
 经营场所：浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路2号
 库房地址：浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路2号

统一社会信用代码：91330200610257496J
 法定代表人：陈再宏
 企业负责人：陈再宏
 经营方式：批发

经营范围：2017年分类目录：01、06、07、08、09、14、18；2002年分类目录：5821、5823、5824、5854、5866

许可期限：自 2023 年 5 月 15 日 至 2028 年 5 月 14 日

发证部门：宁波市市场监督管理局
 发证日期：2023 年 7 月 11 日








医疗器械生产许可证

许可证编号：浙药监械生产许202501245号
 统一社会信用代码：91330200610257495J

企业名称：宁波戴维医疗器械股份有限公司
 法定代表人：蒋再宏


住 所：浙江省宁波市象山石浦科技园区特苑路2号
 企业负责人：蒋再宏

生产地址：浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路2号



生产范围：第Ⅲ类：09-03-急救设备；第Ⅱ类：02-01-手术器械-剪（钳）合器械及材料；07-03-生理参数
 分析测量设备；07-04-监护设备；08-01-急救设备辅助装置；08-07-医用供气排气相关设备；
 09-02-温热（冷）治疗设备/器具；09-03-医用灯设备；09-04-血管内导管配套用体外器械；14-15-病人护理防护用品

许可期限：自 2025 年 1 月 9 日 至 2030 年 1 月 9 日

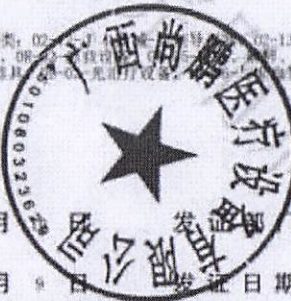 发证日期：2025 年 1 月 27 日





统一社会信用代码
91450103310124455(1-1)



营业执照
(副本)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称 南宁吉航医疗器械有限公司

类型 其他有限责任公司

法定代表人 安晋

经营范围 销售：医疗器械（涉及行政许可的，具体项目以审批部门批准的为准）、消毒用品（不含危险品）、计算机软硬件及耗材、化工产品（除危险化学品）、家用电器、电子产品、文化用品、数码产品、日用百货、五金交电、办公用品、实验设备及耗材、机械设备、化妆品；仪器租赁（除国家专项规定外）；医疗软件的研究与开发；医疗技术咨询服务（不含诊疗服务）；医疗器械、家电的安装、维修及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

注册资本 叁佰万圆整

成立日期 2014年08月26日

住所 南宁市青秀区保爱路60号10栋第三层C4号



登记机关

2023年 02月 24日



国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

第二类医疗器械经营备案凭证

备案编号: 桂南药监械经营备20190772

企业名称	南宁吉航医疗器械有限公司
统一社会信用代码	914501033101254155
法定代表人	安晋
企业负责人	
住所	南宁市青秀区金浦路60号10栋第三层C4号
经营范围	
经营场所	南宁市青秀区金浦路60号10栋第三层C4号
库房地址	南宁市青秀区金浦路60号10栋第二层B8号
经营范围	6801, 6802, 6803, 6804, 6805, 6806, 6807, 6808, 6809, 6810, 6812, 6813, 6815, 6816, 6820, 6821, 6822, 6823, 6824, 6825, 6826, 6827, 6830, 6831, 6833, 6834, 6840 (诊断试剂除外), 6841, 6845, 6854, 6855, 6856, 6857, 6858, 6863, 6864, 6865, 6866, 6870, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22



备案部门(盖章): 南宁市市场监督管理局

备案日期: 2025年 月 5日



医疗器械经营许可证

许可证编号：桂南药监械经营许20190273号

统一社会信用代码：914501033101254155

企业名称：南宁杏航医疗器械有限公司

法定代表人：安晋

住所：南宁市青秀区保爱路60号10栋第三层C4号

企业负责人：安晋

经营场所：南宁市青秀区保爱路60号10栋第三层C4号

经营方式：批发

库房地址：南宁市青秀区保爱路60号10栋第三层C4号

经营范围：

6804, 6815, 6821, 6822, 6823, 6824, 6825, 6826, 6828, 6831, 6832, 6840 (诊断试剂除外),
6845, 6854, 6858, 6863, 6864, 6865, 6866, 6867, 6870, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22



许可期限：自 2024 年 6 月 7 日

发证部门：南宁市行政审批局

至 2029 年 6 月 6 日

发证日期：2024 年 6 月 6 日



统一社会信用代码 91450108MA7BRFFM3Q(2-1)		营业执照 (副本)		 扫描二维码登录 国家企业信用 信息公示系统 了解更多登记、 备案、许可、监 管信息。	
名称	广西尚腾医疗设备有限公司	注册资本	贰佰万圆整		
类型	有限责任公司(自然人独资)	成立日期	2021年09月14日		
法定代表人	李展	住所	中国(广西)自由贸易试验区南宁片区玉 洞大道44号云创谷1号办公楼十二层1242号 办公		
经营范围	一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；医用口罩批发；医用口罩零售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；互联网数据服务；云计算装备技术服务；区块链技术服务；软件和信息技术服务；软件开发；软件外包服务；人工智能应用软件开发；人工智能公共服务平台技术支持；网络与信息安全软件开发；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；物联网设备销售；光通信设备销售；通讯设备销售；电子产品销售；国内贸易代理；专用设备修理；玻璃纤维增强塑料制品销售；日用百货销售；机械配件销售；塑料制品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；健康咨询服务(不含诊疗服务)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)				
登记机关		 2025年03月12日			

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

12、供应商资格证件



医疗器械经营许可证

许可证编号：桂南药监械经营许20230900号

统一社会信用代码：91450108MA7BRFFM3Q

企业名称：广西尚鹏医疗设备有限公司

法定代表人：李展

住所：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区玉洞大道44号云创谷1号办公楼十二层1242号办公

企业负责人：凌宏

经营场所：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区玉洞大道44号云创谷1号办公楼十二层1242号办公

经营方式：批发

库房地址：南宁市吴圩镇明阳大道50号1号厂房第1-3层东边（委托广西华永丰科技有限公司贮存、配送）

经营范围：

6804, 6815, 6821, 6822, 6823, 6824, 6825, 6826, 6828, 6830, 6832, 6833, 6840（诊断试剂需低温冷藏运输贮存），
6845, 6846, 6854, 6858, 6863, 6864, 6865, 6866, 6870, 6877, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22

许可期限：自 2023 年 12 月 1 日
至 2028 年 11 月 30 日

发证部门：南宁市政务服务中心
发证日期：2025 年 4 月 30 日



第二类医疗器械经营备案凭证

备案编号: 桂南药监械经营备20230282号

企业名称	广西尚鹏医疗设备有限公司
统一社会信用代码	91450108MA7BRFFM3Q
法定代表人	李展
企业负责人	凌宏
住 所	中国(广西)自由贸易试验区南宁片区玉洞大道44号云创谷1号办公楼十二层1242号办公
经营方式	批发
经营场所	中国(广西)自由贸易试验区南宁片区玉洞大道44号云创谷1号办公楼十二层1242号办公
库房地址	南宁市吴圩镇明阳大道50号1号厂房第1-3层东边(委托广西华永丰科技有限公司贮存、配送)
经营范围	6801, 6802, 6803, 6804, 6805, 6806, 6807, 6808, 6809, 6810, 6812, 6813, 6815, 6816, 6820, 6821, 6822, 6823, 6824, 6825, 6826, 6827, 6830, 6831, 6833, 6834, 6840 (诊断试剂需低温冷藏运输贮存), 6841, 6845, 6846, 6854, 6858, 6863, 6855, 6856, 6857, 6864, 6865, 6866, 6870, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22



备案部门(盖章): 南宁市市场监督管理局

备案日期: 2023年5月7日



13、法定代表人身份证明及身份证复印件

二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证复印件

法定代表人身份证明

投 标 人：广西尚鹏医疗设备有限公司

地 址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区玉洞大道44号云创谷1号办公楼十二层1242号办公

姓 名：李展 性 别：男

年 龄：45岁 职 务：总经理

身份证号码：452132196007010032

系广西尚鹏医疗设备有限公司的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）：广西尚鹏医疗设备有限公司
2026年02月05日



附件：法定代表人有效身份证正反面复印件



14、授权委托书及被授权人身份证复印件

三、授权委托书及授权代理人有效身份证正反面复印件

授权委托书

致：右江民族医学院附属医院：

我 李展系广西尚鼎医疗设备有限公司的法定代表人现授权委托尹绍高以我方的名义参加购买高档心脏彩色多普勒超声仪、电子胆道内窥镜等一批医疗设备项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字/电子签名）：尹绍高

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：李展

委托代理人身份证号码：45250219970112525X

投标人（电子签名）：广西尚鼎医疗设备有限公司
2025年02月05日



委托代理人有效身份证正反面复印件



15、中标通知书

广西国泰招标咨询有限公司购买高档心脏彩色多普勒超声仪、电子胆道内窥镜等一批医疗设备项目（4分标）中标通知书

广西尚鹏医疗设备有限公司:

经评定,编号为GXZC2026-G1-000063-GTJB采购文件中的购买高档心脏彩色多普勒超声仪、电子胆道内窥镜等一批医疗设备项目-4分标-宫腔镜(一体镜)、冷刀宫腔镜、新生儿黄疸治疗箱,确定你公司中标,采购内容为:采购宫腔镜(一体镜)3套、冷刀宫腔镜1套、新生儿黄疸治疗箱5台,中标价格为821900元。

自此通知书发出之日起30天内,与采购人签订政府采购合同。合同签订前,需按本项目采购文件和你公司投标(响应)文件等约定拟定合同文本(合同格式见采购文件),报我机构项目联系人确认。

采购人联系人:覃老师
电话:0776-2831452
代理机构联系人:田仁貌
电话:13768066634



宫腔镜 生产批号: 20250101 注册证编号: 国械注准(2018)2140008号 注册人名称/生产企业/售后服务单位: 湖南科迈医疗科技有限公司 注册人住所/生产企业住所/生产地址: 湖南省长沙市开福区青竹湖街道青竹湖100号至102号(注册地址: 湖南长沙开福区青竹湖街道青竹湖100号、101、102、103、104、105、106、107、108、109、110、111、112、113、114、115、116、117、118、119、120、121、122、123、124、125、126、127、128、129、130、131、132、133、134、135、136、137、138、139、140、141、142、143、144、145、146、147、148、149、150、151、152、153、154、155、156、157、158、159、160、161、162、163、164、165、166、167、168、169、170、171、172、173、174、175、176、177、178、179、180、181、182、183、184、185、186、187、188、189、190、191、192、193、194、195、196、197、198、199、200、201、202、203、204、205、206、207、208、209、210、211、212、213、214、215、216、217、218、219、220、221、222、223、224、225、226、227、228、229、230、231、232、233、234、235、236、237、238、239、240、241、242、243、244、245、246、247、248、249、250、251、252、253、254、255、256、257、258、259、260、261、262、263、264、265、266、267、268、269、270、271、272、273、274、275、276、277、278、279、280、281、282、283、284、285、286、287、288、289、290、291、292、293、294、295、296、297、298、299、300、301、302、303、304、305、306、307、308、309、310、311、312、313、314、315、316、317、318、319、320、321、322、323、324、325、326、327、328、329、330、331、332、333、334、335、336、337、338、339、340、341、342、343、344、345、346、347、348、349、350、351、352、353、354、355、356、357、358、359、360、361、362、363、364、365、366、367、368、369、370、371、372、373、374、375、376、377、378、379、380、381、382、383、384、385、386、387、388、389、390、391、392、393、394、395、396、397、398、399、400、401、402、403、404、405、406、407、408、409、410、411、412、413、414、415、416、417、418、419、420、421、422、423、424、425、426、427、428、429、430、431、432、433、434、435、436、437、438、439、440、441、442、443、444、445、446、447、448、449、450、451、452、453、454、455、456、457、458、459、460、461、462、463、464、465、466、467、468、469、470、471、472、473、474、475、476、477、478、479、480、481、482、483、484、485、486、487、488、489、490、491、492、493、494、495、496、497、498、499、500、501、502、503、504、505、506、507、508、509、510、511、512、513、514、515、516、517、518、519、520、521、522、523、524、525、526、527、528、529、530、531、532、533、534、535、536、537、538、539、540、541、542、543、544、545、546、547、548、549、550、551、552、553、554、555、556、557、558、559、560、561、562、563、564、565、566、567、568、569、570、571、572、573、574、575、576、577、578、579、580、581、582、583、584、585、586、587、588、589、590、591、592、593、594、595、596、597、598、599、600、601、602、603、604、605、606、607、608、609、610、611、612、613、614、615、616、617、618、619、620、621、622、623、624、625、626、627、628、629、630、631、632、633、634、635、636、637、638、639、640、641、642、643、644、645、646、647、648、649、650、651、652、653、654、655、656、657、658、659、660、661、662、663、664、665、666、667、668、669、670、671、672、673、674、675、676、677、678、679、680、681、682、683、684、685、686、687、688、689、690、691、692、693、694、695、696、697、698、699、700、701、702、703、704、705、706、707、708、709、710、711、712、713、714、715、716、717、718、719、720、721、722、723、724、725、726、727、728、729、730、731、732、733、734、735、736、737、738、739、740、741、742、743、744、745、746、747、748、749、750、751、752、753、754、755、756、757、758、759、760、761、762、763、764、765、766、767、768、769、770、771、772、773、774、775、776、777、778、779、780、781、782、783、784、785、786、787、788、789、790、791、792、793、794、795、796、797、798、799、800、801、802、803、804、805、806、807、808、809、810、811、812、813、814、815、816、817、818、819、820、821、822、823、824、825、826、827、828、829、830、831、832、833、834、835、836、837、838、839、840、841、842、843、844、845、846、847、848、849、850、851、852、853、854、855、856、857、858、859、860、861、862、863、864、865、866、867、868、869、870、871、872、873、874、875、876、877、878、879、880、881、882、883、884、885、886、887、888、889、890、891、892、893、894、895、896、897、898、899、900、901、902、903、904、905、906、907、908、909、910、911、912、913、914、915、916、917、918、919、920、921、922、923、924、925、926、927、928、929、930、931、932、933、934、935、936、937、938、939、940、941、942、943、944、945、946、947、948、949、950、951、952、953、954、955、956、957、958、959、960、961、962、963、964、965、966、967、968、969、970、971、972、973、974、975、976、977、978、979、980、981、982、983、984、985、986、987、988、989、990、991、992、993、994、995、996、997、998、999、1000、1001、1002、1003、1004、1005、1006、1007、1008、1009、1010、1011、1012、1013、1014、1015、1016、1017、1018、1019、1020、1021、1022、1023、1024、1025、1026、1027、1028、1029、1030、1031、1032、1033、1034、1035、1036、1037、1038、1039、1040、1041、1042、1043、1044、1045、1046、1047、1048、1049、1050、1051、1052、1053、1054、1055、1056、1057、1058、1059、1060、1061、1062、1063、10	
---	--



注册人、生产企业：宁夏德信医疗器械有限公司
注册人住所、生产企业住所：浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路1号
生产地址：浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路1号
生产许可证编号：浙药监械生产许20100125号 电话：(0574) 87600002、87601003

医疗器械注册证编号：浙械注准20182090033

产品名称：新生儿黄疸治疗箱

型号规格：XH2-100A

额定电压：220V~

额定频率：50Hz

输入功率：600VA

使用期限：6年



(01)06820716300475
(11)251124
(17)311123
(21)AS2BE0014030



(01)06820716300475



(11)251124(17)311123(21)AS2BE0014030



AS2BE0014030

2025-11 I类

其他内容详见说明书

