

政府采购合同

采购人（甲方）：玉林市红十字会医院

供应商（乙方）：江西蓝君贸易有限公司

项目名称：玉林市红十字会医院麻醉机（重）

项目编号：YLZC2025-J1-990540-GXWM

签定日期：2026 年 2 月 2 日

政府采购合同（货物类）

合同编号：12N49933811420261

采购人（甲方）：玉林市红十字会医院

供应商（乙方）：江西蓝君贸易有限公司

采购计划号：YLZC2025-J1-11909

项目名称：玉林市红十字会医院麻醉机（重）

项目编号：YLZC2025-J1-990540-GXWM

合同类型：买卖合同

本合同为中小企业预留合同：否。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和乙方竞标承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

序号	标的的名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价（元）	金额（元）
1	麻醉机	迈瑞	A5	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	5	台	413000.00	2065000.00
合计金额（人民币）： <u>（大写） 贰佰零陆万伍仟元整 （小写） 2065000.00 元</u>								

第二条 标的质量

1. 乙方所提供标的的名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等内容必须与乙方投标（响应）文件及有关承诺相一致，且满足项目实施要求。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到响应文件的承诺。

第三条 履行时间（期限）、地点和方式

1. 履行时间（期限）：自签订合同之日起 30 日内到货安装调试完毕并交付使用。

2. 履行地点：甲方指定地点。

3. 履行方式

(1) 乙方负责货物运输，货物的运输方式：物流运输。

(2) 交货方式

☒ 乙方将货物送到甲方指定地点。

☐ 甲方自行到乙方指定地点提货。

☐ 其他：_____。

第四条 包装方式

1. 乙方提供的货物均应按响应文件承诺的包装材料、包装标准、包装方式进行包装。

2. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防水、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

3. 货物的使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、质量合格证、随配附件和工具以及清单一并附于货物包装内。

第五条 合同价款及支付

1. 本合同以人民币付款。

2. 合同价款（或者报酬）：贰佰零陆万伍仟元整（¥2065000.00元）。

3. 合同价款包括竞标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），竞标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和谈判文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。

4. 付款进度安排：经现场安装调试，采购人验收合格后，采购人 60 天内凭票支付货款的 97%，余款 3%在一年后成交人提出支付申请后 60 天内一次性付清（无息）。

5. 资金支付方式：（银行转账）。

第六条 验收、交付标准和方法

1. 验收标准和方法

(1) 验收标准：货物验收标准，伴随工程、服务验收标准（符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范）

(2) 验收程序及方法：

1) 乙方完成货物安装调试和培训后，书面向甲方提交验收申请。

2) 甲方收到乙方验收申请之日起7个工作日内进行验收，逾期不验收的，视同验收合格。

3) 本项目验收由验收小组按照采购合同约定对每一项技术和商务要求的履约情况进行确

认。

4) 验收结束后, 验收小组出具采购验收书, 验收书应当包括每一项技术和商务要求的履约情况, 并列明项目总体评价, 由验收小组、甲方和乙方共同签署。

5) 验收过程中所产生的一切费用均由乙方承担。

6) 验收书一式 2 份, 甲乙双方各执 1 份、受托第三方机构一份 (如有)。

7) 验收结论不合格的, 乙方应自收到验收书后 7 日内及时予以解决。经乙方对验收结论不合格的货物进行整改后, 仍然达不到要求的, 经双方协商, 可按以下办法处理:

①更换: 由乙方承担所发生的全部费用。

②贬值处理: 由甲乙双方协议定价。

2. 交付标准和方法

(1) 除售后服务验收外, 验收结论合格的, 乙方应自收到验收书后 7 日内向甲方交付使用。

(2) 货物的所有权和风险自交付时起由乙方转移至甲方, 货物交付给甲方之前所有风险均由乙方承担。

第七条 售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律法规规定以及投标 (响应) 文件承诺, 为甲方提供售后服务。

2. 质量保修范围: 整机 (易损件除外);

质量保修期: 质保 3 年。

第八条 履约保证金: 本项目不收取履约金。

第九条 违约责任

1. 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的, 应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2. 乙方未按本合同和投标 (响应) 文件承诺提供售后服务的, 乙方应按本合同价款 (报酬) 的 1 % 向甲方支付违约金。

3. 因某一方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的, 该方应当对另一方受到的损失予以赔偿或者补偿。

4. 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

第十条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内, 任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同, 则合同履行期可延长, 其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，按下列(2)方式解决：

- (1) 向玉林仲裁委员会申请仲裁；
- (2) 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十二条 合同的变更、中止或者终止

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2. 采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

第十三条 合同文件构成

1. 政府采购合同
2. 成交通知书；
3. 响应文件；
4. 采购文件及更正公告（澄清或补充通知）；
5. 标准、规范及有关技术文件；
6. 双方约定的其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十四条 知识产权和保密要求

1. 甲方在履行合同过程中提供给乙方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于甲方。

2. 除采购文件采购需求另有约定外，甲方不因签署和履行合同而享有乙方在履行合同过程中提供给甲方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

3. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的知识产权或者其他权利。如合

同货物涉及知识产权，则乙方保证甲方在使用合同货物过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

4. 如果甲方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，乙方在收到甲方通知后，应以甲方名义并在甲方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿甲方因此发生的费用和遭受的损失。如果乙方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到甲方通知后 28 日内未作表示，甲方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由乙方承担。

5. 未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条款、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的其他人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

6. 乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第十五条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 合同生效后，甲乙双方不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。

4. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5. 本合同一式八份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲方五份，乙方一份（可根据需要另增加）。

甲方（盖章）：玉林市红十字会医院
法定代表人或者委托代理人（签字）：

签订日期：2026 年 2 月 2 日

乙方（盖章）：江西蓝君贸易有限公司
法定代表人或者委托代理人（签字）：

签订日期：2026 年 2 月 2 日

开户名称：江西蓝君贸易有限公司

银行账号：1504200419000101064

开户行：中国工商银行股份有限公司萍乡正大支

广西威盟项目管理有限公司 成交通知书

江西蓝君贸易有限公司：

广西威盟项目管理有限公司受玉林市红十字会医院的委托，就玉林市红十字会医院麻醉机（重）（YLZC2025-J1-990540-GXWM）采用竞争性谈判采购方式进行采购，按规定程序进行了谈判采购，经谈判小组评定，采购人确认，贵公司为本项目的成交供应商，其成交项目采购内容：采购麻醉机 5 台，如需进一步了解详细内容，详见附件；成交金额为人民币贰佰零陆万伍仟元整（2065000.00 元）。

请贵公司接此通知书后在二十五日内与采购人签订合同，并按竞争性谈判采购文件的要求和响应文件的承诺履行完合同。

特此通知。

采购人：玉林市红十字会医院（盖公章）

日 期：2026 年 01 月 09 日

采购代理机构：广西威盟项目管理有限公司（盖公章）

日 期：2026 年 01 月 09 日

附件 2 竞标报价表

竞标报价表

项目名称：玉溪市红十字医院麻醉机（重）

项目编号：YLZC5025-1-990640-GXHM


分标（如有）：

供应商名称：玉溪市蓝世贸易有限公司

单位：元

项号	标的名称	数量及单位 ①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
1	麻醉机	5 台	迈瑞	A5	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	深圳	一、工作条件及基本配件 1、工作环境，温度：10℃-40℃，湿度：15%-95% 2、电源：220V-240V，50-60Hz，支持 4 个辅助电源接口 3、标配锂电池（非铅酸）后备电池，支持 1 块电池使用时间 90 分钟 4、标配 4 个辅助电源接口 5、接口：1 个 LAN 接口支持网络和软件升级，1 个 RS-232 接口，1 个视频信号接口，2 个 USB 接口； 6、机架：中央刹车系统，大脚轮配有防缆线缠绕功能，带工作台侧栏杆推车 7、显示屏可 360 度旋转，俯仰角度可调节，保证站姿和坐姿都能轻松操作	413000.00	2065000.00

						8、适合内窥镜手术模式；具备工作台照明光，且亮度可调，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明 9、非待机状态转动关机旋钮，主机具备 10 秒延迟关机功能，以避免误操作保证病人安全 10、▲用于对成人、儿童和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理 二、气源 1、标配氧气、空气源，可选氧气、空气、笑气气源 2、具备氧笑联动系统，保证接入氧气和笑气时氧浓度不低于 25% 3、快速充氧范围 25 - 75 L/min 三、流量计 1、电子显示流量计，空气范围：0L/min~15L/min，氧气范围：0L/min~15L/min，笑气范围：0L/min~12L/min 2、电子流量计配备各支路流量数字显示和屏幕虚拟	
--	--	--	--	--	--	--	--



						流量管显示，屏幕可显示新鲜气体设置总流量和氧浓度 3、具备辅助吸氧流量计 4、▲配备高流量给氧功能或提供高流量给氧的单机，流量范围2-60L/min，氧浓度设置范围21-100% 四、挥发罐 标配双麻醉罐位 标配一个高品质七氟醚挥发罐，挥发罐和主机同品牌，具备压力、流速和温度补偿 五、呼吸回路 1、一体化集成回路，具有可观测的吸气呼气单向阀，机械气道压力表以及手动/机控切换开关 2、回路部件可以耐受131℃高温高压消毒以避免院内交叉感染(包括流量传感器) 3、▲二氧化碳吸收罐，容积1500ml，满足临床低微流量麻醉需要 4、内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端，流量传感器用户无需工具可		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

自行校准

5、具有回路整体加温功能，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激

6、标配 CO₂ 旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需关停机械通气，可方便直接更换

7、具备智能回路识别报警系统，当钠石灰罐未安装到位时，机器能智能识别并报警提示

8、呼吸系统漏气（60mL/min 在 10kPa 压力下条件下）

六、呼吸机

1、▲气动电控呼吸机，全中文操作和显示

2、提供辅助/控制通气，标配通气模式：VCV、PCV、压力控制容量保证通气（PCV-VG）和 SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC）、PS 模式，可选配/升级 SIMV-VG、CPAP/PS、APRV 模式

3、可根据病人理想体重自

						14、具备心肺旁流模式 CPB，且心肺旁流模式可在手动通气模式和机控通气模式下启动 15、能配肺保护工具：支持两种复张手法——单通膨和多通膨，支持定时膨胀功能 16、能配高频喷射通气功能，提供高频叠加常频喷射通气模式，或提供高频喷射呼吸机，并且支持高频叠加常频通气连接同一通气附件 七、数字和波形监测 1、具备三级声光报警功能，有独立红黄绿警灯显示 2、15 英寸彩色触摸屏，可同屏显示波形和呼吸环路 3、支持显示 P-V，V-F，P-F 三种类型环路 4、电容触摸屏，支持手势操作 5、内置 3 槽位插件槽，可直接热插拔插件 6、插件可在同品牌监护仪和麻醉机之间通用	
--	--	--	--	--	--	--	--

						7、配备插件：AG 麻醉气体模块可同时监测 5 种麻醉气体浓度及 EtCO₂ 浓度，可单独配 EtCO₂、BIS 8、可监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性、弹性、驱动压、机械能；麻醉气体分析（N₂O、EtCO₂，自动识别五种麻醉气体吸入呼出浓度监测）、呼吸环路 P-V、P-F、V-F 监测，能配氧电池监测吸入氧浓度、BIS 监测 9、同屏幕 4 通道图形显示（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形，CO₂ 或麻醉气体浓度波形等） 10、潮气量监测范围：0-3000ml 11、分钟通气量监测范围：0-100L/min 12、可视化报警，技术报警提示中对于导致报警的原因给予文字和图形提示，具备自动报警限功能		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

								13、图示化自检，系统自检失败时给予文字和图示提醒可能出错的原因		
								八、麻醉工作站功能		
								1、可连接同一品牌监护仪		
								2、可扩展连接支持 HL7 协议的设备		
合计金额大写：人民币 贰佰零肆万伍仟元整 （¥ 2065000.00 元）										

注：

1. 以上竞标报价表中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件按无效处理。
2. 供应商的报价表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其响应文件按无效处理。
3. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商单位电子签章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者授权委托人签字（或者电子签名），否则其响应文件按无效处理。
4. 谈判文件中列明采购专用耗材的，应按谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：江西蓝盾贸易有限公司

日期：2026 年 1 月 4 日



附件 3：采购需求

第三章 采购需求

采购项目技术规格、参数及要求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本竞争性谈判采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商电子签章），否则响应文件按无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。

2. “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效处理的条款。

3. 采购需求中出现的品牌、型号或者生产供应商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产供应商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。

4. 供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

5.所属行业：工业（制造业）

序号	名称	技术要求	单位	数量	备注
1	麻醉机	一、工作条件及基本配件 1、工作环境，温度：10℃ -40℃，湿度：15%-95% 2、电源：220V-240V，50/60Hz，支持≥4 个辅助电源接口	台	5	

	3、标配锂电池(非铅酸)后备电池，支持1块电池使用时间≥ 90分钟 4、标配4个辅助电源接口 5、接口：1个LAN接口支持网络 and 软件升级，1个RS-232接口，1个视频信号接口，2个USB接口； 6、机架：中央刹车系统，大脚轮配有防缆线缠绕功能，带工作台侧栏杆推车 7、显示屏可360度旋转，俯仰角度可调节，保证站姿和坐姿都能轻松操作 8、适合内窥镜手术模式：具备工作台照明光，且亮度可调，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作面照明 9、非待机状态转动关机旋钮，主机具备10秒延迟关机功能，以避免误操作保证病人安全 10、▲用于对成人、儿童和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理 二、气源 1、标配氧气、空气两气源，可选氧气、空气和笑气三气源 2、具备氧笑联动系统，保证接入氧气和笑气时氧浓度不低于25% 3、快速充氧范围25 - 75 L/min 三、流量计 1、电子显示流量计，空气范围：0L/min~15L/min，氧气范围：0L/min~15L/min，笑气范围：0L/min~12L/min 2、电子流量计配备各支路流量数字显示和屏幕虚拟流量管显示，屏幕可显示新鲜气体设置总流量和氧浓度 3、具备辅助吸氧流量计 4、▲配备高流量给氧功能或提供高流量给氧的单机，流量范围2-60L/min，氧浓度设置范围21~100%			
--	--	--	--	--

	四、挥发罐 标配双麻醉罐位 标配一个高品质七氟醚挥发罐，挥发罐和主机同品牌，具备压力、流速和温度补偿 五、呼吸回路 1、一体化集成回路，具有可观测的吸气呼气单向阀，机械气道压力表以及手动/机控切换开关 2、回路部件可以耐受 134℃ 高温高压消毒以避免院内交叉感染(包括流量传感器) 3、▲二氧化碳吸收罐，容积≤1500ml，满足临床低微流量麻醉需要 4、内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端，流量传感器用户无需工具可自行校准 5、具有回路整体加温功能，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激 6、标配 CO2 旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需关停机械通气，可方便直接更换 7、具备智能回路识别报警系统，当钠石灰罐未安装到位时，机器能智能识别，并报警提示 8、呼吸系统泄漏量≤60mL/min(在 3.0kPa 压力条件下) 六、呼吸机 1、▲气动电控呼吸机，全中文操作和显示 2、提供辅助/控制通气，标配通气模式：VCV、PCV、压力控制容量保证通气（PCV-VG）和 SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC）、PS 模式，可选配/升级 SIMV-VG、CPAP/PS、APRV 模式 3、可根据病人理想体重自动关联潮气量，调节潮气量时可显示潮气量/理想体重			
--	---	--	--	--

	4、▲容量控制（VCV）潮气量设置范围：10ml-1500ml 5、吸气压力设置范围：5-70 cmH₂O 6、支持压力：0，3cmH₂O~60 cmH₂O 7、▲呼吸频率：3-100 次/分钟 8、吸呼比：4:1 到 1:10 9、压力限制范围：10-100 cmH₂O 10、▲电子 PEEP，显示屏设置，范围：OFF，3-50 cmH₂O 11、吸气暂停：OFF，5%-60% 12、呼吸机吸气阀峰值流速：180 L/min 13、具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差。 14、具备心肺旁流模式 CPB，且心肺旁流模式可在手动通气模式和机控通气模式下启动 15、能配肺保护工具：支持两种复张手法——单周期和多周期，支持定时膨肺功能 16、能配高频喷射通气功能，提供高频叠加常频喷射通气模式，或提供高频喷射单机，并且支持高频叠加常频通气连接同一通气附件 七、数字和波形监测 1、具备三级声光报警功能，有独立红黄报警灯显示 2、不小于 15 英寸彩色触摸屏，可同屏显示波形和呼吸环图 3、支持显示 P-V，V-F，P-F 三种类型环图 4、电容触摸屏，支持手势操作 5、内置≥3 槽位插件槽，可直接热插拔插件 6、插件可在同品牌监护仪和麻醉机之间通用 7、配备插件：AG 麻醉气体模块可同时监测 5 种麻醉气			
--	--	--	--	--

	体浓度及 EtCO₂ 浓度、可单独配 EtCO₂, BIS 8、可选监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性、弹性、驱动压、机械能；麻醉气体分析（N₂O, EtCO₂, 自动识别五种麻醉气体吸入呼出浓度监测）、呼吸环（P-V, P-F, V-F）监测；能配氧电池法吸入氧浓度、BIS 监测 9、同屏幕≥4 通道波形显示（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形，CO₂ 或麻醉气体浓度波形等） 10、潮气量监测范围：0-3000ml 11、分钟通气量监测范围：0-99L/min 12、可视化报警，技术报警提示中对于导致报警的原因给予文字和图形提示，具备自动报警限功能 13、图示化自检，系统自检失败时给予文字和图示提醒可能出错的原因 八、麻醉工作站功能 1、可连接同一品牌监护仪 2、可扩展连接支持 HL7 协议的设备			
一、商务要求				
交货时间和地点	1. 交货时间：自签订合同之日起 30 日内到货安装调试完毕并交付使用。 2. 交货地点：广西玉林市采购人指定地点。			
合同签订时间	自成交通知书发出之日起 25 日内			
付款条件	经现场安装调试，采购人验收合格后，采购人 60 天内凭票支付货款的 97%，余款 3%在一年后成交人提出支付申请后 60 天内一次性付清（无息）。			
售后服务要求	1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质量保修期除特别注明外，整机质保 3 年(易损件除外)，自设备验收合格并投入使用之日起计算。要求设备使用年限不少于 5 年，设备的生产日期和合同签订的时间间隔不大于 6 个月。			

	质量保修期内负责上门服务、维护、更换配件，不得收取任何费用。超过保修期的机器设备，终生免费上门维护，维修时只收部件成本费。 2、故障响应时间：成交供应商应设有维保电话，设备在使用过程中发生质量问题，成交供应商接到故障通知后1小时内响应，一般问题在2小时内通过远程方式解决遇到大的问题8小时内派技术人员到达现场维修，48小时维修完毕。设备维修时，供应商应提供同型号的备用品以免影响用户业务的正常进行。维修不需更换零配件的，每次维修时间不超过48小时维修；维修需更换配件的，每次维修时间不超过5个工作日： 3、备品备件要求：提供功能完好，可正常使用的备品，为保证设备正常运行，成交供应商应设置有备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期。 4、其他 (1)质量保修期内，每季度至少进行一次定期回访以及对设备维护保养，解决使用中出现的的问题。质量保修期过后，不定期回访使用科室及对设备使用运行情况提供咨询服务： (2)安装时提供完整的使用手册，提供配套技术材料，供采购人验收： (3)设备验收合格后，成交供应商负责对采购人的使用人员进行操作及相关知识的培训，并确保采购人的使用人员熟练使用设备，并能排除简单的软硬件故障： (4)质量保修期内每季度至少由专业人员进行一次例行保养，包括设备的除尘、清洁、消杀等；整机质量保修期内每季度至少由专业人员进行一次操作系统维护，定期维护数据库，及时安装厂家发布的软件更新；整机质量保修期内每季度至少定期进行图像校准一次，保证图像质量： (5)在设备使用年限内（不少于5年），成交供应商应保证配件、耗材的供应：若因设备升级等原因导致原有配件、耗材不能使用，或原有配件、耗材不再生产，成交供应商应负责提供设备硬件或软件的升级，确保设备正常使用。 (6)如设备数据需要采集到医院业务系统的，供应商需出具报告单，则设备与医院业务系统对接产生的软硬件接口费用由设备成交人承担其余不更改。 (7)其余按竞标人承诺。
--	--

包装和运输	符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。
产品质量要求	要求竞标货物及其所有零部件、配件必须是符合国家有关质量和安全强制要求和标准的产品。
报价要求	竞标报价是履行合同的最终价格。竞标人应对本项目的所有内容范围的货物及服务进行总报价，采购人不再支付任何费用，包括：（1）货物、服务的价格（包括但不限于货物及标准附件、备品备件、专用工具、配套技术资料的价格）；（2）必要的保险费用和各项税金；（3）其他（如设备运输运送、装卸、保管、安装、调试、验收、人员培训、技术支持、售后服务、更新升级、安装保险等费用）。供应商竞标报价时应考虑各种风险因素。
二、与实现项目目标相关的其他要求	
（一）验收标准	
1、验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担。 2、采购标的需执行国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，如有最新的按最新的执行。 3、产品到达现场后，成交供应商应在采购单位人员在场情况下当面核验,共同核对、检查，作出记录双方签字确认。成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有质量问题，由成交供应商负责调换、补齐或赔偿。 4、供应商提供所招标采购的货物、配套设备、所属装置等有关技术资料作为验收的参考依据。 5、验收不通过的，根据采购人意见进行整改，直到验收通过为止，期间产生相关费用由供应商承担。 6、成交供应商在验收时附上设备有效的医疗器械注册证及完整内容的医疗器械注册证附件（注册产品标准/产品技术要求）复印件。（如涉及 2 类、3 类医疗器械时提供，1 类医疗器械如有请提供，不涉及不提供） 7、按采购文件要求及响应文件所承诺的质量标准。	
三、进口产品的说明	
本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与竞标的作无效标处理。	

附件 4：商务及技术偏离表

4. 商务要求偏离表：

商务要求偏离表

所竞分标： 无

项目	谈判文件商务要求	供应商的响应	偏离说明
交货时间和地点	1. 交货时间：自签订合同之日起 30 日内到货安装调试完毕并交付使用。	1. 交货时间：自签订合同之日起 30 日内到货安装调试完毕并交付使用。	无偏离
	2. 交货地点：广西玉林市采购人指定地点。	2. 交货地点：广西玉林市采购人指定地点。	
合同签订时间	自成交通知书发出之日起 25 日内	自成交通知书发出之日起 25 日内	无偏离
付款条件	经现场安装调试，采购人验收合格后，采购人 60 天内凭票支付货款的 97%，余款 3%在一年后成交人提出支付申请后 60 天内一次性付清（无息）。	经现场安装调试，采购人验收合格后，采购人 60 天内凭票支付货款的 97%，余款 3%在一年后成交人提出支付申请后 60 天内一次性付清（无息）。	无偏离
售后服务要求	1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质量保修期除特别注明外，整机质保 3 年（易损件除外），自设备验收合格并投入使用之日起计算。要求设备使用年限不少于 5 年，设备的生产日期和合同签订的时间间隔不大于 6 个月。质量保修期内负责上门服务、维护、更换配件，不得收取任何费用。超过保修期的机器设备，终生免费上门维护，维修时只收部件成本费。	1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质量保修期除特别注明外，整机质保 3 年（易损件除外），自设备验收合格并投入使用之日起计算。 设备使用年限 10 年 ，设备的生产日期和合同签订的时间间隔 6 个月以内。质量保修期内负责上门服务、维护、更换配件，不收取任何费用。超过保修期的机器设备，终生免费上门维护，维修时只收部件成本费。	正偏离
	2、故障响应时间：成交供应商应设有维保电话，设备在使用过程中发生质量问题，成交供应商接到	2、故障响应时间：我方设有维保电话，设备在使用过程中发生质量问题，我方接到故障通	无偏离

故障通知后 1 小时内响应，一般问题在 2 小时内通过远程方式解决遇到大的问题 8 小时内派技术人员到达现场维修，48 小时维修完毕。设备维修时，供应商应提供同型号的备用品以免影响用户业务的正常进行。维修不需更换零配件的，每次维修时间不超过 48 小时；维修需更换配件的，每次维修时间不超过 5 个工作日；	知后 1 小时内响应，一般问题在 2 小时内通过远程方式解决遇到大的问题 8 小时内派技术人员到达现场维修，48 小时维修完毕。设备维修时，我方提供同型号的备用品以免影响用户业务的正常进行。维修不需更换零配件的，每次维修时间不超过 48 小时；维修需更换配件的，每次维修时间不超过 5 个工作日；	
3、备品备件要求：提供功能完好，可正常使用的备品，为保证设备正常运行，成交供应商应设置备品库，存入所有必须的备件，并保证 5 年以上的供应期。	3、备品备件：提供功能完好，可正常使用的备品，为保证设备正常运行，我方设置备品库，存入所有必须的备件，并保证 5 年以上的供应期。	无偏离
4、其他	4、其他	无偏离
(1) 质量保修期内，每季度至少进行一次定期回访以及对设备维护保养，解决使用中出现的問題。质量保修期过后，不定期回访使用科室及对设备使用运行情况提供咨询服务；	(1) 质量保修期内，每季度至少进行一次定期回访以及对设备维护保养，解决使用中出现的問題。质量保修期过后，不定期回访使用科室及对设备使用运行情况提供咨询服务；	无偏离
(2) 安装时提供完整的使用手册，提供配套技术资料，供采购人验收；	(2) 安装时提供完整的使用手册，提供配套技术资料，供采购人验收；	无偏离
(3) 设备验收合格后，成交供应商负责对采购人的使用人员进行操作及相关知识的培训，并确保采购人的使用人员熟练使用设备，并能排除简单的软硬件故障；	(3) 设备验收合格后，我方负责对采购人的使用人员进行操作及相关知识的培训，并确保采购人的使用人员熟练使用设备，并能排除简单的软硬件故障；	无偏离
(4) 质量保修期内每季度至少由专业人员进行一次例行保养，包	(4) 质量保修期内每季度至少由专业人员进行一次例行保	无偏离

	括设备的除尘、清洁、消杀等；整机质量保修期内每季度至少由专业人员进行一次操作系统维护，定期维护数据库，及时安装厂家发布的软件更新；整机质量保修期内每季度至少定期进行图像校准一次，保证图像质量：	养，包括设备的除尘、清洁、消杀等；整机质量保修期内每季度至少由专业人员进行一次操作系统维护，定期维护数据库，及时安装厂家发布的软件更新；整机质量保修期内每季度至少定期进行图像校准一次，保证图像质量：	
	(5) 在设备使用年限内(不少于5年)，成交供应商应保证配件、耗材的供应；若因设备升级等原因导致原有配件、耗材不能使用，或原有配件、耗材不再生产，成交供应商应负责提供设备硬件或软件的升级，确保设备正常使用。	(5) 在设备使用年限内(10年)，我方保证配件、耗材的供应；若因设备升级等原因导致原有配件、耗材不能使用，或原有配件、耗材不再生产，我方负责提供设备硬件或软件的升级，确保设备正常使用。	无偏离
	(6) 如设备数据需要采集到医院业务系统的，供应商需出具报告单，则设备与医院业务系统对接产生的软硬件接口费用由设备成交人承担其余不更改。	(6) 如设备数据需要采集到医院业务系统的，我方出具报告单，则设备与医院业务系统对接产生的软硬件接口费用由我方承担其余不更改。	无偏离
	(7) 其余按竞标人承诺。	(7) 其余按竞标人承诺。	无偏离
包装和运输	符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。	符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。	无偏离
产品质量要求	要求竞标货物及其所有零部件、配件必须是符合国家有关质量和安全强制要求和标准的产品。	竞标货物及其所有零部件、配件保证是符合国家有关质量和安全强制要求和标准的产品。	无偏离
报价要求	竞标报价是履行合同的最终价格。竞标人应对本项目的所有内容范围的货物及服务进行总报价，采购人不再支付任何费用，包括：(1) 货物、服务的价格（包括但不限于货物及标准附件、备品备件、专用	竞标报价是履行合同的最终价格。我方对本项目的所有内容范围的货物及服务进行总报价，采购人不再支付任何费用，包括：(1) 货物、服务的价格（包括但不限于货物及标准附件、备	无偏离

	工具、配套技术资料的价格)；(2)必要的保险费用和各项税金；(3)其他(如设备运输运送、装卸、保管、安装、调试、验收、人员培训、技术支持、售后服务、更新升级、安装保险等费用)。供应商竞标报价时应考虑各种风险因素。	品备件、专用工具、配套技术资料的价格)；(2)必要的保险费用和各项税金；(3)其他(如设备运输运送、装卸、保管、安装、调试、验收、人员培训、技术支持、售后服务、更新升级、安装保险等费用)。我方竞标报价时已考虑各种风险因素。	
--	--	---	--

注：

1. 说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的商务要求逐条明确响应，并作出偏离说明。
2. 供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
3. 如果采购需求为小于、小于或等于、大于、大于或等于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购需求，响应文件承诺内容应当写明商务响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：_____

供应商（电子签章）：江西蓝君贸易有限公司

日期： 2026 年 1 月 4 日



7. 技术要求偏离表:

技术要求偏离表

采购项目编号: YLZC2025-J1-990540-GXWM

采购项目名称: 玉林市红十字会医院麻醉机（重）

分标号: 无

	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
1	麻醉机	一、工作条件及基本配件	一、工作条件及基本配件	无偏离
		1、工作环境，温度：10℃ -40℃，湿度：15%-95%	1、工作环境，温度：10℃ -40℃，湿度：15%-95%	无偏离
		2、电源：220V-240V，50/60Hz，支持≥4 个辅助电源接口	2、电源：220V-240V，50/60Hz，支持 4 个辅助电源接口	无偏离
		3、标配锂电子(非铅酸)后备电池，支持 1 块电池使用时间≥90 分钟	3、标配锂电子(非铅酸)后备电池，支持 1 块电池使用时间 90 分钟	无偏离
		4、标配 4 个辅助电源接口	4、标配 4 个辅助电源接口	无偏离
		5、接口：1 个 LAN 接口支持网络和软件升级，1 个 RS-232 接口，1 个视频信号接口，2 个 USB 接口；	5、接口：1 个 LAN 接口支持网络和软件升级，1 个 RS-232 接口，1 个视频信号接口，2 个 USB 接口；	无偏离
		6、机架：中央刹车系统，大脚轮配有防缆线缠绕功能，带工作台侧栏杆推车	6、机架：中央刹车系统，大脚轮配有防缆线缠绕功能，带工作台侧栏杆推车	无偏离
		7、显示屏可 360 度旋转，俯仰角度可调节，保证站姿和坐姿都能轻松操作	7、显示屏可 360 度旋转，俯仰角度可调节，保证站姿和坐姿都能轻松操作	无偏离
		8、适合内窥镜手术模式：具备工作台照明光，且亮度可调，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明	8、适合内窥镜手术模式：具备工作台照明光，且亮度可调，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明	无偏离

9、非待机状态转动关机旋钮，主机具备 10 秒延迟关机功能，以避免误操作保证病人安全	9、非待机状态转动关机旋钮，主机具备 10 秒延迟关机功能，以避免误操作保证病人安全	无偏离
10、▲用于对成人、儿童和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理	10、▲用于对成人、儿童和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理	无偏离 (详见技术参数：第 47 页)
二、气源	二、气源	无偏离
1、标配氧气、空气两气源，可选氧气、空气和笑气三气源	1、标配氧气、空气两气源，可选氧气、空气和笑气三气源	无偏离
2、具备氧笑联动系统，保证接入氧气和笑气时氧浓度不低于 25%	2、具备氧笑联动系统，保证接入氧气和笑气时氧浓度不低于 25%	无偏离
3、快速充氧范围 25 - 75 L/min	3、快速充氧范围 25 - 75 L/min	无偏离
三、流量计	三、流量计	无偏离
1、电子显示流量计，空气范围：0L/min ~ 15L/min，氧气范围：0L/min ~ 15L/min，笑气范围：0L/min ~ 12L/min	1、电子显示流量计，空气范围：0L/min ~ 15L/min，氧气范围：0L/min ~ 15L/min，笑气范围：0L/min ~ 12L/min	无偏离
2、电子流量计配备各支路流量数字显示和屏幕虚拟流量管显示，屏幕可显示新鲜气体设置总流量和氧浓度	2、电子流量计配备各支路流量数字显示和屏幕虚拟流量管显示，屏幕可显示新鲜气体设置总流量和氧浓度	无偏离
3、具备辅助吸氧流量计	3、具备辅助吸氧流量计	无偏离
4、▲配备高流量给氧功能或提供高流量给氧的单机，流量范围 2-60L/min，氧浓度设置范围 21~100%	4、▲配备高流量给氧功能或提供高流量给氧的单机，流量范围 2-60L/min，氧浓度设置范围 21~100%	无偏离 (详见技术参数：第 47 页)

	四、挥发罐	四、挥发罐	无偏离
	标配双麻醉罐位	标配双麻醉罐位	无偏离
	标配一个高品质七氟醚挥发罐，挥发罐和主机同品牌，具备压力、流速和温度补偿	标配一个高品质七氟醚挥发罐，挥发罐和主机同品牌，具备压力、流速和温度补偿	无偏离
	五、呼吸回路	五、呼吸回路	无偏离
	1、一体化集成回路，具有可观测的吸气呼气单向阀，机械气道压力表以及手动/机控切换开关	1、一体化集成回路，具有可观测的吸气呼气单向阀，机械气道压力表以及手动/机控切换开关	无偏离
	2、回路部件可以耐受 134℃ 高温高压消毒以避免院内交叉感染(包括流量传感器)	2、回路部件可以耐受 134℃ 高温高压消毒以避免院内交叉感染(包括流量传感器)	无偏离
	3、▲二氧化碳吸收罐，容积≤1500ml，满足临床低微流量麻醉需要	3、▲二氧化碳吸收罐，容积≤1500ml，满足临床低微流量麻醉需要	无偏离 (详见技术参数：第 48 页)
	4、内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端，流量传感器用户无需工具可自行校准	4、内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端，流量传感器用户无需工具可自行校准	无偏离
	5、具有回路整体加温功能，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激	5、具有回路整体加温功能，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激	无偏离
	6、标配 CO2 旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需关停机械通气，可方便直接更换	6、标配 CO2 旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需关停机械通气，可方便直接更换	无偏离
	7、具备智能回路识别报警系统，当钠石灰罐未安装到位时，机器能	7、具备智能回路识别报警系统，当钠石灰罐未安装到位时，机器能	无偏离

智能识别，并报警提示	智能识别，并报警提示	
8、呼吸系统泄漏量 $\leq 60\text{mL}/\text{min}$ （在3.0kPa 压力条件下）	8、呼吸系统泄漏量 $60\text{mL}/\text{min}$ （在3.0kPa 压力条件下）	无偏离
六、呼吸机	六、呼吸机	无偏离
1、▲气动电控呼吸机，全中文操作和显示	1、▲气动电控呼吸机，全中文操作和显示	无偏离 （详见技术参数：第48页）
2、提供辅助/控制通气，标配通气模式：VCV、PCV、压力控制容量保证通气(PCV-VG)和SIMV(SIMV-VC、SIMV-PC)、PS 模式，可选配/升级SIMV-VG、CPAP/PS、APRV 模式	2、提供辅助/控制通气，标配通气模式：VCV、PCV、压力控制容量保证通气(PCV-VG)和SIMV(SIMV-VC、SIMV-PC)、PS 模式，可选配/升级SIMV-VG、CPAP/PS、APRV 模式	无偏离
3、可根据病人理想体重自动关联潮气量，调节潮气量时可显示潮气量/理想体重	3、可根据病人理想体重自动关联潮气量，调节潮气量时可显示潮气量/理想体重	无偏离
4、▲容量控制（VCV）潮气量设置范围：10ml-1500ml	4、▲容量控制（VCV）潮气量设置范围：10ml-1500ml	无偏离 （详见技术参数：第48页）
5、吸气压力设置范围：5-70 cmH ₂ O	5、吸气压力设置范围：5-70 cmH ₂ O	无偏离
6、支持压力：0, 3cmH ₂ O~60 cmH ₂ O	6、支持压力：0, 3cmH ₂ O~60 cmH ₂ O	无偏离
7、▲呼吸频率：3-100 次/分钟	7、▲呼吸频率：2-100 次/分钟	正偏离 （详见技术参数：第48页）

8、吸呼比：4:1 到 1:10	8、吸呼比：4:1 到 1:10	无偏离
9、压力限制范围：10-100 cmH2O	9、压力限制范围：10-100 cmH2O	无偏离
10、▲电子 PEEP，显示屏设置，范围：OFF，3-50 cmH2O	10、▲电子 PEEP，显示屏设置，范围：OFF，3-50 cmH2O	无偏离 (详见技术参数：第 49 页)
11、吸气暂停：OFF，5%-60%	11、吸气暂停：OFF，5%-60%	无偏离
12、呼吸机吸气阀峰值流速：180 L/min	12、呼吸机吸气阀峰值流速：180 L/min	无偏离
13、具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差。	13、具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差。	无偏离
14、具备心肺旁流模式 CPB，且心肺旁流模式可在手动通气模式和机控通气模式下启动	14、具备心肺旁流模式 CPB，且心肺旁流模式可在手动通气模式和机控通气模式下启动	无偏离
15、能配肺保护工具：支持两种复张手法——单周期和多周期，支持定时膨胀功能	15、能配肺保护工具：支持两种复张手法——单周期和多周期，支持定时膨胀功能	无偏离
16、能配高频喷射通气功能，提供高频叠加常频喷射通气模式，或提供高频喷射单机，并且支持高频叠加常频通气连接同一通气附件	16、能配高频喷射通气功能，提供高频叠加常频喷射通气模式，或提供高频喷射单机，并且支持高频叠加常频通气连接同一通气附件	无偏离
七、数字和波形监测	七、数字和波形监测	无偏离
1、具备三级声光报警功能，有独	1、具备三级声光报警功能，有独	无偏离

立红黄报警灯显示	立红黄报警灯显示	
2、不小于 15 英寸彩色触摸屏，可同屏显示波形和呼吸环图	2、15 英寸彩色触摸屏，可同屏显示波形和呼吸环图	无偏离
3、支持显示 P-V，V-F，P-F 三种类型环图	3、支持显示 P-V，V-F，P-F 三种类型环图	无偏离
4、电容触摸屏，支持手势操作	4、电容触摸屏，支持手势操作	无偏离
5、内置≥3 槽位插件槽，可直接热插拔插件	5、内置 3 槽位插件槽，可直接热插拔插件	无偏离
6、插件可在同品牌监护仪和麻醉机之间通用	6、插件可在同品牌监护仪和麻醉机之间通用	无偏离
7、配备插件：AG 麻醉气体模块可同时监测 5 种麻醉气体浓度及 EtCO ₂ 浓度、可单独配 EtCO ₂ ，BIS	7、配备插件：AG 麻醉气体模块可同时监测 5 种麻醉气体浓度及 EtCO ₂ 浓度、可单独配 EtCO ₂ ，BIS	无偏离
8、可选监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性、弹性、驱动压、机械能；麻醉气体分析（N ₂ O，EtCO ₂ ，自动识别五种麻醉气体吸入呼出浓度监测）、呼吸环（P-V，P-F，V-F）监测；能配氧电池法吸入氧浓度、BIS 监测	8、可选监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性、弹性、驱动压、机械能；麻醉气体分析（N ₂ O，EtCO ₂ ，自动识别五种麻醉气体吸入呼出浓度监测）、呼吸环（P-V，P-F，V-F）监测；能配氧电池法吸入氧浓度、BIS 监测	无偏离
9、同屏幕≥4 通道波形显示（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形，CO ₂ 或麻醉气体浓度波形等）	9、同屏幕 4 通道波形显示（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形，CO ₂ 或麻醉气体浓度波形等）	无偏离
10、潮气量监测范围：0-3000ml	10、潮气量监测范围：0-3000ml	无偏离
11、分钟通气量监测范围：0-99L/min	11、分钟通气量监测范围：0-100L/min	正偏离 （详见

			技术参数：第 50 页)
	12、可视化报警，技术报警提示中对于导致报警的原因给于文字和图形提示，具备自动报警限功能	12、可视化报警，技术报警提示中对于导致报警的原因给于文字和图形提示，具备自动报警限功能	无偏离
	13、图示化自检，系统自检失败时给于文字和图示提醒可能出错的原因	13、图示化自检，系统自检失败时给于文字和图示提醒可能出错的原因	无偏离
	八、麻醉工作站功能	八、麻醉工作站功能	无偏离
	1、可连接同一品牌监护仪	1、可连接同一品牌监护仪	无偏离
	2、可扩展连接支持 HL7 协议的设备	2、可扩展连接支持 HL7 协议的设备	无偏离


注：

1. 说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的技术要求实质性响应，并作出偏离说明。
2. 供应商应根据竞标设备的性能指标，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
3. 供应商认为其竞标响应有正偏离、采购需求中带“▲”的条款或负偏离的，请在技术要求偏离表中逐一列明，且需在响应文件中提供竞标产品的彩页或国家认可有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家的技术参数说明证明作为佐证，否则按竞标无效处理。
4. 如采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购需求，响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数的具体数值，否则按竞标无效处理。
5. 负偏离超过允许偏离的项数竞标无效。
6. 如技术要求偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：江西蓝君贸易有限公司

日期： 2026 年 1 月 4 日



附件 5：竞标声明

6. 竞标声明：

竞标声明

致：（玉林市红十字会医院）：

我方（江西蓝盾贸易有限公司）系中华人民共和国合法供应商，经营地址江西省萍乡市安源区卧江街医疗科技产业园金盾物流园区 2 栋 4 楼 418 室。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称：玉林市红十字会医院麻醉机（重））项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 在此，我方宣布同意如下：

- （1）将按谈判文件的约定履行合同责任和义务；
- （2）已详细审查全部谈判文件，包括补遗文件（如有）；
- （3）同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；
- （4）响应谈判文件规定的竞标有效期。

4. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （6）法律、行政法规规定的其他条件。

5. 我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：
(两项内容中必须选择一项)

☒ 我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

☐ 我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：_____；

7. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：江西省萍乡市安源区丹江街医疗科技产业园金盾物流园区2栋4楼418室

邮政编号：337000

电话/传真：18169603543

电子邮箱：951353774@qq.com

开户银行：中国工商银行股份有限公司萍乡正大支行

账号/行号：1504200419000101064

8. 以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。


特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体牵头人法定代表人分别签字或者盖章或者电子签名，否则响应文件按无效处理。

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：夏美

供应商（电子签章）：江西蓝科贸易有限公司

2026 年 1 月 4 日



附件 6：配置清单

6. 货物配置清单（均不含报价）：

货物配置清单

项目编号： YLZC2025-J1-990540-GXWM
项目名称： 玉林市红十字会医院麻醉机（重）
所竞分标： 无

序号	货物名称	数量 及单位	品牌	规格 型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
1	麻醉机	5 台	迈瑞	A5	深圳迈瑞 生物医疗 电子股份 有限公司	深圳	一、工作条件及基本配件 1、工作环境，温度：10℃-40℃，湿度：15%-95% 2、电源：220V-240V，50/60Hz，支持 4 个辅助电源接口 3、标配锂电子(非铅酸)后备电池，支持 1 块电池使用时间 90 分钟 4、标配 4 个辅助电源接口 5、接口：1 个 LAN 接口支持网络和软件升级，1 个 RS-232 接口，1 个视频信号接口，2 个 USB 接口； 6、机架：中央刹车系统，大脚轮配有防缆线缠绕功能，带工作台侧栏杆推车 7、显示屏可 360 度旋转，俯仰角度可调节，保证站姿和坐姿都能轻松操作 8、适合内窥镜手术模式：具备

						工作台照明光，且亮度可调，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明 9、非待机状态转动关机旋钮，主机具备 10 秒延迟关机功能，以避免误操作保证病人安全 10、▲用于对成人、儿童和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理 二、气源 1、标配氧气、空气两气源，可选氧气、空气和笑气三气源 2、具备氧笑联动系统，保证接入氧气和笑气时氧浓度不低于 25% 3、快速充氧范围 25 - 75 L/min 三、流量计 1、电子显示流量计，空气范围：0L/min~15L/min，氧气范围：0L/min~15L/min，笑气范围：0L/min~12L/min 2、电子流量计配备各支路流量数字显示和屏幕虚拟流量管显示，屏幕可显示新鲜气体设置总流量和氧浓度 3、具备辅助吸氧流量计 4、▲配备高流量给氧功能或提供高流量给氧的单机，流量范围 2-60L/min，氧浓度设置范围 21~100%
--	--	--	--	--	--	--



						四、挥发罐 标配双麻醉罐位 标配一个高品质七氟醚挥发罐，挥发罐和主机同品牌，具备压力、流速和温度补偿 五、呼吸回路 1、一体化集成回路，具有可观测的吸气呼气单向阀，机械气道压力表以及手动/机控切换开关 2、回路部件可以耐受 134℃ 高温高压消毒以避免院内交叉感染(包括流量传感器) 3、▲二氧化碳吸收罐，容积 1500ml，满足临床低微流量麻醉需要 4、内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端，流量传感器用户无需工具可自行校准 5、具有回路整体加热功能，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激 6、标配 CO2 旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需关停机械通气，可方便直接更换 7、具备智能回路识别报警系统，当钠石灰罐未安装到位时，
--	--	--	--	--	--	---



						机器能智能识别，并报警提示 8、呼吸系统泄漏量 60mL/min (在 3.0kPa 压力条件下) 六、呼吸机 1、▲气动电控呼吸机，全中文操作和显示 2、提供辅助/控制通气，标配通气模式：VCV、PCV、压力控制容量保证通气（PCV-VG）和 SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC）、PS 模式，可选配/升级 SIMV-VG、CPAP/PS、APRV 模式 3、可根据病人理想体重自动关联潮气量，调节潮气量时可显示潮气量/理想体重 4、▲容量控制（VCV）潮气量设置范围：10ml-1500ml 5、吸气压力设置范围：5-70 cmH₂O 6、支持压力：0，3cmH₂O~60 cmH₂O 7、▲呼吸频率：2-100 次/分钟 8、吸呼比：4:1 到 1:10 9、压力限制范围：10-100 cmH₂O 10、▲电子 PEEP，显示屏设置，范围：OFF，3-50 cmH₂O 11、吸气暂停：OFF，5%-60%
--	--	--	--	--	--	--



						12、呼吸机吸气阀峰值流速： 180 L/min 13、具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差。 14、具备心肺旁流模式 CPB，且心肺旁流模式可在手动通气模式和机控通气模式下启动 15、能配肺保护工具：支持两种复张手法——单周期和多周期，支持定时膨胀功能 16、能配高频喷射通气功能，提供高频叠加常频喷射通气模式，或提供高频喷射单机，并且支持高频叠加常频通气连接同一通气附件 七、数字和波形监测 1、具备三级声光报警功能，有独立红黄报警灯显示 2、15 英寸彩色触摸屏，可同屏显示波形和呼吸环图 3、支持显示 P-V，V-F，P-F 三种类型环图 4、电容触摸屏，支持手势操作 5、内置 3 槽位插件槽，可直接
--	--	--	--	--	--	---



						热插拔插件 6、插件可在同品牌监护仪和麻醉机之间通用 7、配备插件：AG 麻醉气体模块可同时监测 5 种麻醉气体浓度及 EtCO₂ 浓度、可单独配 EtCO₂，BIS 8、可选监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性、弹性、驱动压、机械能；麻醉气体分析（N₂O，EtCO₂，自动识别五种麻醉气体吸入呼出浓度监测）、呼吸环（P-V，P-F，V-F）监测；能配氧电池法吸入氧浓度、BIS 监测 9、同屏幕 4 通道波形显示（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形，CO₂ 或麻醉气体浓度波形等） 10、潮气量监测范围：0-3000ml 11、分钟通气量监测范围：0-100L/min 12、可视化报警，技术报警提示中对于导致报警的原因给予文字和图形提示，具备自动报警限功能 13、图示化自检，系统自检失
--	--	--	--	--	--	---



							败时给予文字和图示提醒可能出错的原因 八、麻醉工作站功能 1、可连接同一品牌监护仪 2、可扩展连接支持 HL7 协议的设备
--	--	--	--	--	--	--	--

备注：

以上货物配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无。填写有缺漏的，响应文件按无效处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“竞标报价表”一致，否则响应文件按无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：
 供应商（电子签章）：江西蓝君贸易有限公司
 日期：2026 年 1 月 4 日



附件 7：注册证及使用年限证明

9.4 设备医疗器械注册证



中华人民共和国医疗器械注册证

注册证编号：国械注准20233081170

注册人名称	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
注册人住所	深圳市南山区高新技术产业园科技南十二路迈瑞大厦1-4层
生产地址	深圳市光明新区南环大道1203号
代理人名称	/
代理人住所	/
产品名称	麻醉系统
型号、规格	A4、A4C、A4e、A5、A5C、A5e、A6、A6C、A6e、A7、A7C、A7e
结构及组成	产品由主机、麻醉呼吸机、麻醉气体输送系统、麻醉蒸发器(型号V60，适用的麻醉剂：异氟醚、七氟醚，型号V80，适用的麻醉剂：地氟醚)、麻醉呼吸系统(包括气道压力表、呼吸机、二氧化碳吸收器、吸气(和呼气)单向阀、吸气和呼气流量传感器、排气阀、手动机械控制开关、储气囊连接端口、吸气和呼气端口接头)、麻醉气体净化系统、负压吸引装置、二氧化碳气体监测模块、麻醉气体监测模块、氧饱和度监测模块、脑电麻醉深度指数监测模块、呼吸监测模块、蓄电池和附件组成。详见附页。
适用范围	本产品预期在专业医疗机构内用于成人、儿童和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理。本产品应由培训合格获得授权的医务人员使用。
附件	产品技术要求
其他内容	/
备注	

审批部门：



批准日期：二〇二三年八月十六日
生效日期：二〇二三年八月十六日
有效期至：二〇二八年八月十五日

结构及组成附页

1. 模块列表

名称	型号	功能	制造商
AG 模块	AG-1	支持AG参数监护	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	AG-2	支持AG、O ₂ 和BIS参数监护	
	AG-3	支持AG和O ₂ 参数监护	
	AG-4	支持AG和BIS参数监护	
旁流 CO ₂ 模块	CO2-3	支持旁流CO ₂ 参数监护	
	CO2-4	支持旁流CO ₂ 和O ₂ 参数监护	
主流 CO ₂ 模块	CO2-2	支持主流CO ₂ 参数监护	
BIS 模块	BIS	支持BIS参数监护	
NMT 模块	NMT	支持NMT参数监护	
ESI 模块	ESI	支持ESI参数监护	

2. 附件列表

附件	名称	型号	类型	制造商	备注
AG模块附件	水槽	100-000080-00	可重复使用	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	不与人体直接接触，无需灭菌
		100-000081-00			
	气路采样管	60-15200-00	一次性		
		60-15300-00			
	气路适配器	60-14100-00	一次性		
		040-001187-00			
旁流CO ₂ 模块附件	水槽	100-000080-00	可重复使用	Salter labs, INC	与人体直接接触，无需灭菌
		100-000081-00			
	气路采样管	60-15200-00	一次性		
		60-15300-00			
	鼻腔采样管	4701	一次性		
		4703			
主流CO ₂ 模块附件	气路适配器	60-14100-00	一次性	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	不与人体直接接触，无需灭菌
		040-001187-00			
	气路适配器	60-14200-00	一次性	Respironis Novametrics, LLC	不与人体直接接触，无需灭菌
		6421			
		6063			
		6312			
		7007	可重复使用		

附件	名称	型号	类型	制造商	备注
	传感器	1036698	可重复使用	深圳迈瑞生物 医疗电子股份 有限公司	
	气路适配器	GA3201	一次性		
		GA3202			
		GA3211	可重复使用		
		GA3212			
	传感器	GA3701	可重复使用		
BIS模块附件	麻醉深度电缆	186-0195-MR	可重复使用	Covidien llc	与人体直接接 触，无需 灭菌
	麻醉深度电缆	186-0224-MR	可重复使用		
	BIS传感器	186-0200	一次性	Covidien llc	
	BIS传感器	186-0106			
	BIS传感器	186-0212			
NMT模块附件	肌松电缆	NM13101	可重复使用	深圳迈瑞生物 医疗电子股份 有限公司	不与人体直接 接触，无 需灭菌
		NM13401			
		NM13701			
ESI模块附件	ESI分体式主电 缆	ES9601	可重复使用	深圳迈瑞生 物医疗电子 股份有限公 司	与人体直接接 触，无 需灭菌
	ESI一体式电缆	ES9602	一次性		
	ESI一次性脑电 传感器(成人)	ES9101			
	ESI一次性脑电 传感器(小儿)	ES9102			
高频喷射通 气附件	喷射导管	RAJC-000S	一次性	广州艾默克 医疗器械有 限公司	与人体直接接 触，灭 菌提供
		RAJC-000			
		RAJC-000L			
		RAJC-010			
		RAJC-010L			
		RAJC-011			
		RAJC-011L			
		RAJC-010			
		RAJC-010L			
		RAJC-111			
		RAJC-111L			



中华人民共和国
医疗器械变更注册（备案）文件

注册证编号：国械注准20233081170

产品名称	麻醉系统
变更内容	变更产品型号规格、结构及组成和产品技术要求，详见变更对比表。
备注	按照现行《分类目录》，该产品管理类别为三类，分类编码为08。 附件与“国械注准20233081170”注册证共同使用。

审批部门：国家药品监督管理局

批准日期：二〇二五年十月九日

产品型号、规格变更对比表

变更前	变更后
A4、A4C、A4e、A5、A5C、A5e、A6、A6C、A6e、A7、A7C、A7e	A4、A4C、A4e、A4 Pro、A5、A5C、A5e、A5 Pro、A6、A6C、A6e、A6 Pro、A7、A7C、A7e、A7 Pro

产品结构及组成变更对比表

变更前  产品由主机、麻醉呼吸机、麻醉气体输送系统、麻醉蒸发器(型号V60, 麻醉剂: 异氟烷、七氟烷; 型号 V80, 适用的麻醉剂: 地氟烷、七氟烷、二氟二氯乙烷、氟烷和七氟烷)	变更后 产品由主机、麻醉呼吸机、麻醉气体输送系统、麻醉蒸发器(型号V60, 麻醉剂: 异氟烷、七氟烷; 型号 V80, 适用的麻醉剂: 地氟烷、七氟烷、二氟二氯乙烷、氟烷和七氟烷)
--	--

变更前				变更后			
结构及组成附页				结构及组成附页			
1.模块列表				1.模块列表			
名称	型号	功能	制造商	名称	型号	功能	
AG 模块	AG-1	支持AG参数监护	深圳迈瑞生物医疗 电子股份 有限公司	AG 模块	AG-1	支持AG参数监护	
	AG-2	支持AG、O ₂ 和BIS参数监护			AG-2	支持AG、O ₂ 和BIS参数监护	
	AG-3	支持AG和O ₂ 参数监护			AG-3	支持AG和O ₂ 参数监护	
	AG-4	支持AG和BIS参数监护			AG-4	支持AG和BIS参数监护	
旁流 CO ₂ 模块	CO2-3	支持旁流CO ₂ 参数监护	深圳迈瑞生物医疗 电子股份 有限公司	旁流 CO ₂ 模块	CO2-3	支持旁流CO ₂ 参数监护	
	CO2-4	支持旁流CO ₂ 和O ₂ 参数监护			CO2-4	支持旁流CO ₂ 和O ₂ 参数监护	
主流 CO ₂ 模块	CO2-2	支持主流CO ₂ 参数监护		主流 CO ₂ 模块	CO2-2	支持主流CO ₂ 参数监护	
BIS 模块	BIS	支持BIS参数监护		微流 CO ₂ 模块	CO2-1	支持微流CO ₂ 参数监护	
NMT 模块	NMT	支持NMT参数监护		BIS 模块	BIS	支持BIS参数监护	
ESI 模块	ESI	支持ESI参数监护		NMT 模块	NMT	支持NMT参数监护	
				ESI 模块	ESI	支持ESI参数监护	

2.附件列表				2.附件列表			
附件	名称	型号	类型	制造商	备注	附件	名称
AG模块 附件	水槽	100-000080-00 100-000081-00	可重复 使用	深圳迈瑞生 物医疗电子 股份有限公司	不与人 体直接 接触， 无需灭 菌	AG模块 附件	型号
	气路采样管	60-15200-00 60-15300-00	一次性				类型
	气路适配器	040-001187-00 60-14200-00	可重复 使用				可重复使用
	水槽	100-000080-00 100-000081-00	可重复 使用				可重复使用
旁流 CO ₂ 模 块附件	气路采样管	60-15200-00 60-15300-00	一次性	Salter labs, INC	与人 体直接 接触，无 菌	旁流 CO ₂ 模 块附件	型号
	气路适配器	040-001187-00 60-14200-00	可重复 使用				类型
	水槽	100-000080-00 100-000081-00	可重复 使用				可重复使用
	气路采样管	60-15200-00 60-15300-00	一次性				可重复使用
主流 CO ₂ 模 块附件	气路采样管	60-15200-00 60-15300-00	一次性	Respiromis Novamatrix LLC	不与人 体直接 接触，无 菌	主流 CO ₂ 模 块附件	型号
	气路适配器	040-001187-00 60-14200-00	可重复 使用				类型
	水槽	100-000080-00 100-000081-00	可重复 使用				可重复使用
	气路采样管	60-15200-00 60-15300-00	一次性				可重复使用

高频喷射通气附件	电传感器(小)	RAJC-000S	与人体直接接触，天雀提供	德州艾默克医疗器械有限公司	一次性	高频喷射通气附件	喷射导管	一次性
		RAJC-000						
		RAJC-000L						
		RAJC-100S						
		RAJC-100						
		RAJC-100L						
		RAJC-010						
		RAJC-010L						
		RAJC-011						
		RAJC-011L						
		RAJC-110						
		RAJC-110L						
高频喷射通气附件	电传感器(小)	RAJC-111	与人体直接接触，天雀提供	德州艾默克医疗器械有限公司	一次性	高频喷射通气附件	喷射导管	一次性
		RAJC-111L						
		RAJC-000S						
		RAJC-000						
		RAJC-000L						
		RAJC-010						
		RAJC-010L						
		RAJC-011						
		RAJC-011L						
		RAJC-110						
		RAJC-110L						
		RAJC-111						
		RAJC-111L						



第 31 页 / 共 31 页

使用年限证明，设备铭牌：



附件 8：售后服务承诺

9.2 售后服务承诺书

GNT202512260167

编号: MRYF-04-R0001 版本号: V6.0

mindray 迈瑞

迈瑞产品质量和售后服务承诺

(V6.0)

为了更好地服务于广大深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（简称“迈瑞公司”）的客户，迈瑞公司将提供技术咨询、产品选型、以及整体解决方案，确保产品的质量性能、供货时间、服务保障以及产品的技术支持、维护保养、维修服务和技术培训，并做出如下承诺：

一、 产品质量承诺

1. 迈瑞公司对本次招投标所提供的产品符合【项目名称：玉林市红十字会医院超声机（重），项目编号：YLZC2025-J1-990540-GXWM】要求的规格型号和技术性能。
2. 迈瑞公司保证所供产品是经过出厂检验的合格产品。
3. 迈瑞公司承诺对所供产品满足国家有关质量技术标准及相关法律、法规要求；并附有产品质量合格证、说明书、操作卡、保修卡。


二、 售后服务承诺

1. 保修范围：用户应按照说明书、操作卡使用所购买的产品。在保修期内，机器出现故障，迈瑞公司提供免费维修和配件更换。如故障属于下列情形之一引起，则不在免费保修之列，用户应承担配件成本和人工费（另行约定），但迈瑞公司会尽快协助排除故障，使系统恢复正常。
 - 由于用户不正确安装使用或者用户人为造成产品损坏，如不小心跌落等，而发生的故障。
 - 由于电网电压在产品规定的适用范围外引起的故障及严重损坏等。
 - 由于不可抗力引起机器损坏或灭失，如地震、洪水、火灾、失窃等。
 - 由于未经本公司认可的维修人员拆卸而发生的故障。
 - 对产品的使用超出我方在设计研发仪器时所能预料到的使用目的和使用条件。
 - 由于产品与其他仪器连接使用而发生的故障。
 - 其它非因产品本身质量问题而发生的故障。

2. 服务热线：

迈瑞专设客户交互中心全天候 24 小时接听服务申告热线及客户投诉，热线号码：400 700 5652。供客户及时反馈各种产品使用情况，为客户解决实际问题，第一时间响应并全程响应和支持客户的需求。

3. 迈瑞产品服务请求处理流程图:

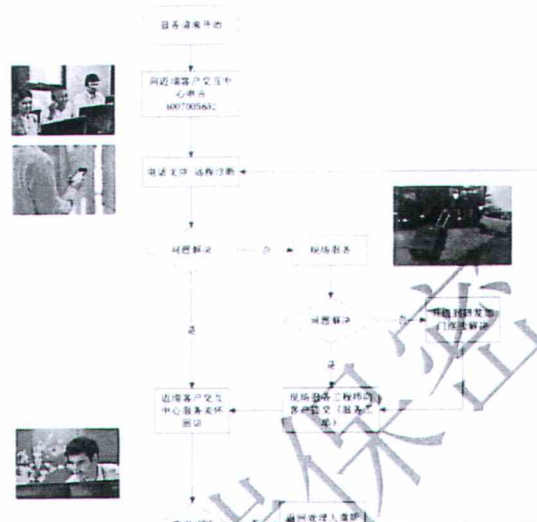

4. 服务团队：迈瑞服务人员均经过公司严谨的专项技术培训，并通过相应服务资质的考核，具备过硬的业务技能和深厚的实践经验。



5. 敏捷高效的备件中心：迈瑞公司拥有总部、6个大区物流中心、55个城市备件中心、37个驻点地区备件中心和授权服务分包常用备件库四级备件支持架构，零担、快速。

急送三级物流派送服务,保障产品全生命周期备件供应及时、充足。

- 6、收费服务:保修期满后,客户可以与迈瑞签订《保修销售合同》进行续保,或由我公司按市场统一价格提供维修配件及服务。
- 7、关怀服务:客户交互中心为客户提供技术咨询电话;迈瑞服务人员在保修期内提供公司规定的主动服务,如主动走访,为产品进行系统的诊断、校准、维护、保养、升级等。

三、 培训计划

迈瑞公司将按与买方的约定对最终用户进行培训。

1、培训方式:

根据客户需求,组织客户进行集中培训或到现场、线上定期或不定期的技术培训。

2、培训内容:

涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用、保养维修、临床应用等有关内容。

3、培训资料:

产品的培训资料由迈瑞公司免费提供。

四、 其他事项

- 1、返厂维修时请您妥善包装,防压、防潮,购买足额运输保险,以免在运输过程中造成损坏及不必要的损失。
- 2、不论产品因何原因发生损坏,请立即停止使用并联系我们维修。
- 3、本承诺适用于迈瑞公司在中华人民共和国境内(港、澳、台地区除外)销售的全部迈瑞公司产品。
- 4、迈瑞公司只提供本承诺所包含的服务,不对任何销售人员或代理商、分销商做出的超出本承诺范围的内容负责。
- 5、迈瑞公司保留对本承诺的最终解释权。
- 6、迈瑞联系方式

24小时服务热线	400 700 5652		
迈瑞公司	广东省深圳市南山区高新技术产业园科技南十二路迈瑞大厦		
全球用户服务部地址	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司		
全球用户服务部总经理	张亚帅	邮编	518057
服务中心	【南宁】	服务中心邮编	【530022】
服务中心联系人	【姚春全】	服务中心联系电话	【18565681391】
服务中心联系地址	【广西南宁市青秀区中柬路8号 龙光世纪A座1号楼34楼】		

五、 保修及服务响应时间承诺

仅限 【项目名称: 玉林市红十字会医院麻醉机(重);项目编号: YLZC2025-J1-990540-GXWM 】

1、 产品保修期: 保修期从产品“安装验收日”起开始计算。

投标产品型号	主机免费保修期(月)
【麻醉系统 A5】	【36】
保修期内非仪器故障平均开机率: ≥95%, 即每年停机不超过 13 个工作日(一年 250 个工作日), 超过一天保修期顺延一天。	

2、 附件、试剂、超声探头或其他模块保修期:

产品	保修期(月)
附件	【/】
试剂	【/】
超声探头或其他模块	【/】

3、 保修期间, 对迈瑞公司提供的产品出现的故障, 迈瑞公司承诺的服务时间如下:

服务时间	市区内	市区外
响应时间	1 小时内	
上门服务时间	【8】	【8】

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

二〇二五年十二月二十九日