

广西政府采购云平台合同编号: 12N4993381142026403

政 府 采 购

超声电子气管镜系统合同

项目编号: YLZC2025-G1-990483-GXRZ

计划编号: YLZC2025-G1-11691

采购人: 玉林市红十字会医院

中标供应商: 江西润派医疗器械有限公司



签订日期: 2026 年 2 月 4 日

目录

一、采购合同-----	1
二、合同附件-----	9
1、中标通知书-----	9
2、招标文件货物需求一览表-----	10
3、投标报价表-----	16
4、投标产品技术资料表、商务条款偏离表-----	23
5、投标产品配置清单-----	34
6、售后服务承诺-----	40



采购合同

合同编号: 12N4993381142026403

项目名称: 超声电子气管镜系统

项目编号: YLZC2025-G1-990483-GXRZ

甲方(买方): 玉林市红十字会医院

乙方(卖方): 江西润派医疗器械有限公司

根据 2026 年 1 月 14 日政府采购项目的采购结果及《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定,按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺,甲乙双方签订本合同。

1. 采购内容

1.1 货物名称: 超声电子气管镜系统

1.2 数量(单位): 1 套

1.3 品牌、厂家、型号、规格、配置:

序号	标的名称	品牌	型号	生产厂家	数量	单价(元)
1	超声电子气管镜系统	富士	EP-6000	富士胶片株式会社	1 套	3495000.00

1.4 技术参数:


序号	标的名称	数量	单位	技术参数及要求
1	超声电子气管镜系统	1	套	(一) 超声处理器 (型号: SU-9000-H-) 1.扫描模式: B 模式、M 模式、THI、彩色多普勒、能量多普勒、脉冲波多普勒 复合谐波模式 造影谐波模式 弹性成像模式 声速校正模式以及局部声速校正功能。 2.扫描方式: 电子扫描 3.超声波中心频率: 5~12MHz 宽频扫描 4.多普勒发射频率: 2 种 5.超声波输出功率: 超声波输出功率可调 6.图像旋转: 360 ° 旋转 7.半圆型显示: 上半圆、下半圆、左半圆、右半圆 8.具有穿刺引导功能。 9.数字化输出: DVI、HD-SDI 10.测量功能: 一般测量(包括距离、面积、体积、角度、直方图等)、多普勒血流测量系统 11.画中画功能: 内镜/超声图像切换,并可根据医生的习惯进行设定



			12.放大功能：整体放大以及 ROI 放大 (二) 超声电子气管镜（型号： EB-530US） 内镜功能： 1.成像原件：Super CCD 2.视野角度：120 ° 3.视野方向：10 °（前斜视） 4.观察范围：3-100mm 5.画质：全电子高清画质 6.先端部外径：6.7mm 7.插入部外径：6.3mm 8.有效长度：610mm 9.弯曲角度：上/下 130 ° /90 ° 10.钳道内径：2.0mm 超声功能： 1.显示模式：B 模式、M 模式、彩色多普勒、能量多普勒、脉冲波多普勒、造影谐波、弹性成像 2.扫查方式：电子凸形扫描 3.扫查角度：65 ° 4.频 率：5MHz, 7.5MHz, 10MHz, 12MHz 等 5.穿刺引导功能：有。 6.接触方式：水囊法、直接接触法 (三) 电子内窥镜处理器（型号： EP-6000） 1.信号传输：数字 HDTV 、 模拟 SDTV 2.色彩调节：亮度, RGB,色度：9 档可调 3.测光模式：平均测光、峰值测光及自动测光。 4.特殊光模式：BLI、BLI-bright、 LCI 等同类技术 5.冻结模式：实时冻结，三种冻结模式可选 6.光源：LED 7.灯寿命：14400 小时 8.自动亮度调整：自动亮度调整、手动调整 9.兼容同品牌内窥镜：可兼容高清电子胃、肠镜，高清治疗电子胃、肠镜，光学放大胃、肠镜，高清经鼻内镜，高清电子十二指肠镜，环扫/扇扫超声胃镜，超声支气管镜，高清支气管镜，高清鼻咽喉镜 10.病人信息：病人 ID，病人姓名，性别，年龄，生日，记录，医院名称，医生姓名 11.送气功能：横隔膜式气泵，有高/中/低/关压力切换 12.前面板显示：透射照明/光照限制/照明模式 (四) 电子气管内窥镜（治疗型） (型号： EB-580T) 1.观察方向：0 ° (直视) 2.视野角度：120 ° 3.观察景深：2~100mm 4.头端部外径： Φ5.8mm 5.插入最大部外径： Φ5.9mm 6.有效长度：600mm
--	--	--	---

			7.弯曲角度：上：180 °、下：130 ° 8.钳道直径： Φ2.8mm 9.CCD 类型：高分辨率 CCD，无彩虹现象 (五) 电子气管内窥镜（检查型） (型号：EB-580S) 1.观察方向：0 °（直视） 2.视野角度：120 °（广角） 3.观察范围：2~100mm 4.先端直径： Φ5.3mm 5.插入部直径： Φ5.1mm 6.有效长度：600mm 7.全长：870mm 8.弯曲角度：上 210 ° /下 130 ° 9.钳道直径： Φ2.2mm (六) 监视器（型号：LMD-2710MC） 1.液晶面板 2.图像尺寸（对角线）：684mm 3.有效图像尺寸：596×335mm 4.分辨率：3840×2160 像素 5.宽高比：16：9 6.背光灯：LED 7.对比度：1000：1 8.彩色：10.7 亿色 9.输入：HDMI，DVI-D，SDI 输入，模块化接口 10.输出：DVI-D,SDI,显示器端口输出 11.电源：交流输入:100V 到 240V. 50/60Hz,1.5A-0.7A。直流输入:26V,5.2A(使用交流适配器) 12.功耗：149W 13.操作温度：0-35℃ (七) 内窥镜专用台车（型号：JY-18-18XS） 1.净重 80kg 2.承重 150kg 3.产品规格：长 720mm×宽 680mm ×高 1450mm 4.设备层板数量：共 3 层 包含键盘托 5.标准供电：220V 50HZ (八) 图文工作站 1.内存容量：16G 2.CPU 型号：i5-14500 3.系统：Windows 11 4.机箱大小：3-9.9L 5.硬盘容量：512GB SSD+1TB HDD 6.核心数：十核 7.屏幕尺寸：19 寸 8.显卡型号：集成显卡 9.适用场景：商用
--	--	--	---



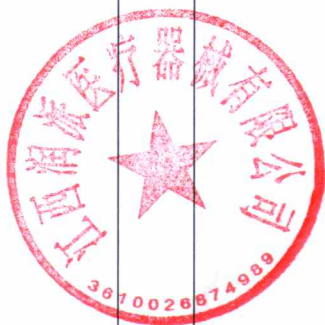

10.采集卡：配备				
二、配置要求				
序号	名称	型号	数量	单位
1	超声内镜处理器	SU-9000-H-	1	台
2	超声电子支气管镜	EB-530US	1	条
3	全数字化内窥镜图像处理器	EP-6000	1	台
4	高清电子支气管镜（治疗型）	EB-580T	1	条
5	高清电子支气管镜（检查型）	EB-580S	1	条
6	高清监视器	LMD-2710M C	1	台
7	测漏器	LT-7F	1	台
8	内窥镜专用台车	JY-18-18XS	1	套
9	图文工作站	/	1	套

2. 合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：人民币叁佰肆拾玖万伍仟元整（¥3495000.00元）。（详见投标报价表）

3. 交货要求

3.1 交货期：自合同签订之日起 90 日历天内完成供货、安装及验收并交付使用。

3.2 交货地点：采购人指定地点。

3.3 交货方式：现场交货。

3.4 乙方必须按投标文件承诺的技术参数、性能要求、质量标准等向甲方提供全新、完整、未经使用的货物。

4. 履约保证金：无

5. 质量保证及售后服务

5.1 质量保证期：3 年（自交货安装及验收并交付使用之日起计）。

5.2 如乙方提供的货物在使用过程中发生质量问题，乙方接到甲方故障通知后应在 24 小时内到达甲方指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理。

5.3 乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1) 更换：由乙方承担所发生的全部费用；

(2) 贬值处理：由甲乙双方协议定价；

(3) 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担与该货物相关的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

5.4 在质量保证期内，乙方负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但乙方也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

5.5 超过质量保证期的货物，乙方提供终生维修、保养服务，维修时只收部件成本费。

5.6 乙方随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。

6. 合同款支付

6.1 付款方式：签订合同后 7 个工作日内预付合同总额的 30%，验收合格后 60 个工作日内支付合同总额的 40%，验收合格后 120 个工作日内支付剩余合同总额的 30%。（付款前供应商必须提供真实、有效、合法的正式发票，如提供假发票的，供应商除须向采购人重开合法发票外，还须按发票票面金额一倍的赔偿违约金给采购人，与此相关的行政处罚、刑事责任亦由供应商承担）。

6.2 支付合同款时，按当地财政支付程序将款项直接支付给供应商。

6.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，甲方可以在报经财政部门审核同意后，在不改变合同其他条款的前提下与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。供应商应根据实际使用数量供货，合同的最终结算金额按实际使用数量乘以成交单价进行计算。

6.4 政府采购过程中，如采购人、供应商或采购代理机构存在违法行为，玉林市政府采购监督管理部门可视情况书面通知采购人暂停采购活动，并延期支付合同款。

7. 产权

7.1 乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

7.2 乙方保证所交付货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第 11.3 项的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金还应负担甲方由此产生的一切损失。

8. 技术资料

8.1 甲方向乙方提供货物的有关技术资料。

8.2 乙方应在招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

8.3 没有甲方事先书面同意，乙方不得将甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的其他任何人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

9. 货物包装、发运及运输

9.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

9.2 使用说明书、质量检验证明书、保修单据、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

9.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

9.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

9.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

10. 调试和验收

10.1 乙方将货物运达约定的交货地点后，甲方应在五个工作日内对乙方提交的货物依据招标文件、投标文件要求和国家标准或行业标准进行现场初步验收。对外观、说明书符合要求的，给予签收；对不符合要求或有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，乙方不得拒绝和延误。

10.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

10.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

10.4 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告。

10.5 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，相关费用由甲方承担。

11. 违约责任

11.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收该货款总值的千分之一违约金。

11.2 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。乙方逾期超过本合同约定交货日期十个工作日不能交货的，甲方

可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.3 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

12. 不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

13. 诉讼

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为：采购人指定地点。

14. 合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

14.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经市财政部门审批，并签书面补充协议报玉林市政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

14.3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

- (1) 中标通知书；
- (2) 招标文件货物需求一览表；
- (3) 招标文件的澄清和修改（如有）；
- (4) 投标报价表；
- (5) 投标产品技术资料表、商务条款偏离表；
- (6) 投标产品配置清单；
- (7) 中标供应商澄清函（如有）；
- (8) 其他与本合同相关的资料。

14.4 1 本合同未尽事宜，可经双方协商签订书面补充协议，补充协议的内容与本合同的内容不一致的，以补充协议的内容为准。



14.5 本合同正本一式捌份，具有同等法律效力，甲方执伍份，乙方执二份，采购代理机构存档一份。(可根据需要另增加)。

14.6 本合同甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效，自签订之日起二个工作日内，甲方或采购代理机构应当将合同副本在政采云系统合同公告。

甲方：玉林市红十字会医院

地址：玉林市玉州区金旺路1号

法定代表人：超谢印文

委托代理人：4509024236749

电话：0775-2286030

传真：

邮政编码：

乙方：江西润派医疗器械有限公司

地址：江西省抚州市临川区才都工业园众创

基地2号楼三楼34A37室

法定代表人：喻金莲

委托代理人：

电话：15360689820

传真：

邮政编码：344100

开户银行：中国工商银行股份有限公司抚州
南关支行

开户名称：江西润派医疗器械有限公司

银行账号：1511200609200107958

合同签订地点：玉林市玉州区金旺路1号

合同签订日期：2026年2月4日

1、中标通知书:

广西瑞真工程造价咨询有限责任公司
超声电子气管镜系统
【项目编号: YLZC2025-G1-990483-GXRZ】
中 标 通 知 书

江西润派医疗器械有限公司:

你单位参加了本招标机构代理的: 超声电子气管镜系统的投标, 项目编号:
YLZC2025-G1-990483-GXRZ (采购计划文号: YLZC2025-G1-11691), 经评
标委员会评定, 采购人确认, 确定你单位中标, 中标内容: 超声电子气管镜系统
项目采购所包含内容, 中标金额: 人民币叁佰肆拾玖万伍仟元整(¥3495000.00);
交货期: 自合同签订之日起 90 日历天内完成供货、安装及验收并交付使用。

现将有关事项通知如下:

一、请接到本通知后, 与采购单位 (玉林市红十字会医院) 按采购文件规
定时间内签订合同。

二、签订合同详细地点: 广西壮族自治区玉林市玉州区金旺路1号

特此通知

采购单位联系人: 俸欢 联系电话: 0775-2286030

采购代理机构项目联系人: 陈雪姣、蒋福军、周筱熙

联系电话: 0771-5800672



广西瑞真工程造价咨询有限责任公司



2、招标文件货物需求一览表

序号	采购货物名称 (标的名称)	数量	单位	技术参数及要求	分项预算合计 (万元)
1	超声电子气管镜系统	1	套	(一) 超声内镜处理器 ▲1. 扫描模式: B 模式、M 模式、THI、彩色多普勒、能量多普勒、脉冲波多普勒 复合谐波模式 造影谐波模式 弹性成像模式 声速校正模式以及局部声速校正功能。 2. 扫描方式: 电子扫描 3. 超声波中心频率: 5~12MHz 宽频扫描 4. 多普勒发射频率: ≥ 2 种 5. 超声波输出功率: 超声波输出功率可调 6. 图像旋转: 360° 旋转 7. 半圆型显示: 上半圆、下半圆、左半圆、右半圆 ▲8. 具有穿刺引导功能。 9. 数字化输出: DVI、HD-SDI 10. 测量功能: 一般测量 (包括距离、面积、体积、角度、直方图等)、多普勒血流测量系统 11. 画中画功能: 内镜/超声图像切换, 并可根 据医生的习惯进行设定 12. 放大功能: 整体放大以及 ROI 放大 (二) 超声电子支气管镜 内镜功能: 1. 成像原件: CCD 或 CMOS 2. 视野角度: $\geq 120^\circ$ ※3. 视野方向: $\leq 10^\circ$ (前斜视) 4. 观察范围: 3-100mm 5. 画质: 全电子高清画质 6. 先端部外径: $\leq 6.7\text{mm}$ 7. 插入部外径: $\leq 6.3\text{mm}$ 8. 有效长度: $\geq 610\text{mm}$ 9. 弯曲角度: 上/下 $\geq 130^\circ / 90^\circ$	350.00



			10. 钳道内径：≥2.0mm 超声功能： 1. 显示模式：B 模式、M 模式、彩色多普勒、能量多普勒、脉冲波多普勒、造影谐波、弹性成像 2. 扫查方式：电子凸形扫描 3. 扫查角度：≥65° 4. 频率：5MHz，7.5MHz，10MHz，12MHz 等 ▲5. 穿刺引导功能：有。 6. 接触方式：水囊法、直接接触法 （三）全数字化内窥镜图像处理器 1. 信号传输：数字 HDTV、模拟 SDTV 2. 色彩调节：亮度，RGB，色度：≥9 档可调 3. 测光模式：平均测光、峰值测光及自动测光。 4. 特殊光模式：BLI、BLI-bright、LCI 或 NBI 等同类技术 5. 冻结模式：实时冻结，三种冻结模式可选 6. 光源：LED ※7. 灯寿命：≥10000 小时 8. 自动亮度调整：自动亮度调整、手动调整 ※9. 兼容同品牌内窥镜：可兼容高清电子胃、肠镜，高清治疗电子胃、肠镜，光学放大胃、肠镜，高清经鼻内镜，高清电子十二指肠镜，环扫/扇扫超声胃镜，超声支气管镜，高清支气管镜，高清鼻咽喉镜 10. 病人信息：病人 ID，病人姓名，性别，年龄，生日，记录，医院名称，医生姓名 11. 送气功能：横隔膜式气泵，有高/中/低/关压力切换 12. 前面板显示：透射照明/光照限制/照明模式 （四）高清电子支气管镜（治疗型） 1. 观察方向：0°（直视）	
--	--	--	--	--





			2. 视野角度: $\geq 120^\circ$ ※3. 观察景深: 2~100mm 4. 头端部外径: $\Phi \leq 5.9\text{mm}$ 5. 插入最大部外径: $\Phi \leq 5.9\text{mm}$ 6. 有效长度: $\geq 600\text{mm}$ 7. 弯曲角度: 上: $\geq 180^\circ$、下: $\geq 130^\circ$ 8. 钳道直径: $\Phi \geq 2.8\text{mm}$ 9. CCD 类型: 高分辨率 CCD, 无彩虹现象 (五) 高清电子支气管镜 (检查型) 1. 观察方向: 0° (直视) 2. 视野角度: $\geq 120^\circ$ (广角) ※3. 观察范围: 2~100mm 4. 先端直径: $\Phi \leq 5.3\text{mm}$ 5. 插入部直径: $\Phi \leq 5.1\text{mm}$ 6. 有效长度: $\geq 600\text{mm}$ 7. 全长: $\geq 870\text{mm}$ 8. 弯曲角度: 上 $\geq 180^\circ$ / 下 $\geq 130^\circ$ 9. 钳道直径: $\Phi \geq 2.0\text{mm}$ (六) 监视器 1. 液晶面板 2. 图像尺寸 (对角线): 约 684mm 3. 有效图像尺寸: 约 596×335mm 4. 分辨率: 约 3840×2160 像素 5. 宽高比: 16: 9 6. 背光灯: LED 7. 对比度: 1000: 1 8. 彩色: 约 10.7 亿色 9. 输入: HDMI, DVI-D, SDI 输入, 模块化接口 10. 输出: DVI-D, SDI, 显示器端口输出 11. 电源要求: 交流输入: 100V 到 240V. 50/60Hz, 1.5A-0.7A。直流输入: 26V, 5.2A (使用交流适配器) 12. 功耗: 约 149W	
--	--	--	--	--

13. 操作温度：0-35℃

(七) 内窥镜专用台车

1. 净重≥80kg

2. 承重≥150kg

3. 产品规格：约长 720mm × 宽 680mm × 高 1450mm

4. 设备层板数量：共 3 层 包含键盘托

5. 标准供电：220V 50HZ

(八) 图文工作站

1. 内存容量：≥16G

2. CPU 型号：i5-14500

3. 系统：Windows 11

4. 机箱大小：3-9.9L

5. 硬盘容量：512GB SSD+1TB HDD


6. 核心数：十核

7. 屏幕尺寸：≥19 寸

8. 显卡型号：集成显卡

9. 适用场景：商用

10. 采集卡：配备

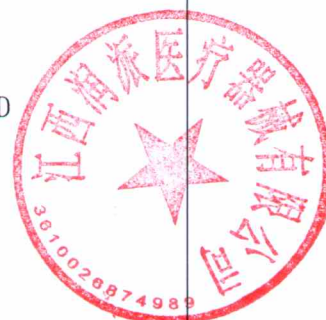

二、配置要求

序号	名称	数量	单位
1	超声内镜处理器	1	台
2	超声电子支气管镜	1	条
3	全数字化内窥镜图像处理器	1	台
4	高清电子支气管镜（治疗型）	1	条
5	高清电子支气管镜（检查型）	1	条
6	监视器	1	台
7	内窥镜专用台车	1	台
8	图文工作站	1	套

一、合同签订期：自中标通知书发出之日起 25 日内。

▲二、交货期：自合同签订之日起 90 日历天内完成供货、安装及验收并交付使用。

三、交货地点：采购人指定地点。

四、交货方式：现场交货。

五、售后服务要求：

▲1、质量保证期不少于 2 年（自交货安装及验收并交付使用之日起计）。

2、售后技术服务要求：

1) 故障响应时间：供应商接到故障通知后需在 30 分钟内做出响应（电话），在 24 小时内派维修工程师到现场进行故障解除，如 48 小时内无法排除故障的，必须提供不低于故障产品规格型号和档次的备用产品供用户使用，直至故障产品修复，保证系统恢复正常运行。

2) 在保修期内由供应商负责保修，排除故障，无偿提供非操作不当造成的部件、配件的更换，供应商从在其指定地点收到故障产品之日起 7 天内将修理后的产品或替换产品运至最终用户现场。因操作不当或外部原因损坏，造成部件的更换，应由采购人承担有关费用。保修期内，所有维修服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。

3) 供应商须向采购人承诺终身优惠提供配件和维修。

4) 供应商应免费培训采购人维护人员，保证维护人员能进行日常运行维护工作，提供用户操作手册和维修手册；并能熟练地排除故障、管理设备、分析故障等。

5) 如需升级软件，免费升级软件。

六、其他要求：

▲1、投标报价包括但不限于：

1) 货物的价格；

2) 货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

3) 运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；

4) 必要的保险费用和各项税费；

5) 包括安装费用；

6) 检测部门产品检测费用；

7) 审核部门费用；

8) 如果设备数据需要采集到医院业务系统，并出具报告单，则设备与医院业务系统对接产生的软硬件接口费用由设备成交人承担。



▲2、设备在验收过程中出现无法满足招标文件规定的参数及要求的，采购人不予验收并终止合同，一切后果由供应商承担。

3、付款方式：签订合同后 7 个工作日内预付合同总额的 30%，验收合格后 60 个工作日内支付合同总额的 40%，验收合格后 120 个工作日内支付剩余合同总额的 30%。（付款前供应商必须提供真实、有效、合法的正式发票，如提供假发票的，供应商除须向采购人重开合法发票外，还须按发票票面金额一倍的赔偿违约金给采购人，与此相关的行政处罚、刑事责任亦由供应商承担）

4、本项目的“超声电子气管镜系统”已经过进口设备论证，采购进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不得对其加以限制，应当按照公平竞争原则实施采购；采购的进口产品医疗器械部分必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。



3、投标报价表

二、开标一览表(单位均为人民币元)

项目名称: 超声电子气管镜系统 项目编号: YLZC2025-G1-990483-GXRZ 分标: 无

投标人名称: 江西润派医疗器械有限公司

序号	货物名称	生产厂家、品牌及型号	具体货物内容	数量①	单价(元)②	单项合价(元) ③=①×②/费率	货物要求(年限)	备注
1	超声电子气管镜系统	生产厂家: 富士胶片株式会社、品牌: 富士、型号: EP-6000	(一) 超声处理器 (型号: SU-9000-H) 1. 扫描模式: B 模式、M 模式、THI、彩色多普勒、能量多普勒、脉冲波多普勒 复合谐波模式 造影谐波模式 弹性成像模式 声速修正模式以及局部声速修正功能。 2. 扫描方式: 电子扫描 3. 超声波中心频率: 5~12MHz 宽频扫描 4. 多普勒发射频率: 2 种 5. 超声波输出功率: 超声波输出功率可调 6. 图像旋转: 360° 旋转 7. 半圆型显示: 上半圆、下半圆、左半圆、右半圆 8. 具有穿刺引导功能。 9. 数字化输出: DVI、HD-SDI 10. 测量功能: 一般测量 (包括距离、面积、体积、角度、直方图等) 多普勒血流测量系统 11. 画中画功能: 内镜/超声图像切	1 套	349500.00	3495000.00	质保 3 年, 使用年限 6 年	无

		换, 并可根据医生的习惯进行设定 12. 放大功能: 整体放大以及 ROI 放大 (二) 超声电子气管镜 (型号: EB-530US) 内镜功能: 1. 成像原件: Super CCD 2. 视野角度: 120° 3. 视野方向: 10° (前斜视) 4. 观察范围: 3-100mm 5. 画质: 全电子高清画质 6. 先端部外径: 6.7mm 7. 插入部外径: 6.3mm 8. 有效长度: 610mm 9. 弯曲角度: 上/下 130° /90° 10. 钳道内径: 2.0mm 超声功能: 1. 显示模式: B 模式、M 模式、彩色多普勒、能量多普勒、脉冲波多普勒、造影谐波、弹性成像 2. 扫查方式: 电子凸形扫描 3. 扫查角度: 65° 4. 频率: 5MHz, 7.5MHz, 10MHz, 12MHz 等 5. 穿刺引导功能: 有。 6. 接触方式: 水囊法、直接接触法 (三) 电子内窥镜处理器 (型号: EP-6000) 1. 信号传输: 数字 HDTV、模拟 SDTV 2. 色彩调节: 亮度, RGB, 色度, 9 档可调 3. 测光模式: 平均测光、峰值测光及自动测光。				
--	--	--	--	--	--	--







		4. 特殊光模式: BLI、BLI-bright、LCI 等同类技术 5. 冻结模式: 实时冻结, 三种冻结模式可选 6. 光源: LED 7. 灯寿命: 14400 小时 8. 自动亮度调整: 自动亮度调整、手动调整 9. 兼容同品牌内窥镜: 可兼容高清电子胃、肠镜, 高清治疗电子胃、肠镜, 光学放大胃、肠镜, 高清经鼻内镜, 高清电子十二指肠镜, 环扫/扇扫超声胃镜, 超声支气管镜, 高清支气管镜, 高清鼻咽喉镜 10. 病人信息: 病人 ID, 病人姓名, 性别, 年龄, 生日, 记录, 医院名称, 医生姓名 11. 送气功能: 横隔膜式气泵, 有高/中/低/关压力切换 12. 前面板显示: 透射照明/光照限制/照明模式 (四) 电子气管内窥镜 (治疗型) (型号: EB-580T) 1. 观察方向: 0° (直视) 2. 视野角度: 120° 3. 观察景深: 2~100mm 4. 头端部外径: $\Phi 5.8\text{mm}$ 5. 插入最大部外径: $\Phi 5.9\text{mm}$ 6. 有效长度: 600mm 7. 弯曲角度: 上: 180°、下: 130° 8. 钳道直径: $\Phi 2.8\text{mm}$ 9. CCD 类型: 高分辨率 CCD 无彩虹现象 (五) 电子气管内窥镜 (检查型)				
--	--	--	--	--	--	--



			(型号: EB-580S) 1. 观察方向: 0° (直视) 2. 视野角度: 120° (广角) 3. 观察范围: 2~100mm 4. 先端直径: $\Phi 5.3\text{mm}$ 5. 插入部直径: $\Phi 5.1\text{mm}$ 6. 有效长度: 600mm 7. 全长: 870mm 8. 弯曲角度: 上 210° / 下 130° 9. 钳道直径: $\Phi 2.2\text{mm}$ (六) 监视器 (型号: LMD-2710MC) 1. 液晶面板 2. 图像尺寸 (对角线): 684mm 3. 有效图像尺寸: 596×335mm 4. 分辨率: 3840×2160 像素 5. 宽高比: 16: 9 6. 背光灯: LED 7. 对比度: 1000: 1 8. 彩色: 10.7 亿色 9. 输入: HDMI, DVI-D, SDI 输入, 模块化接口 10. 输出: DVI-D, SDI, 显示器端口输出 11. 电源: 交流输入: 100V 到 240V. 50/60Hz, 1.5A-0.7A. 直流输入: 26V, 5.2A (使用交流适配器) 12. 功耗: 149W 13. 操作温度: 0-35°C (七) 内窥镜专用台车 (型号: JY-18-18XS) 1. 净重 80kg 2. 承重 150kg 3. 产品规格: 长 720mm × 宽 680mm × 高 1450mm				
--	--	--	---	--	--	--	--



		4. 设备层板数量：共 3 层 包含键 盘托																																													
		5. 标准供电：220V 50HZ																																													
		（八）图文工作站																																													
		1. 内存容量：16G																																													
		2. CPU 型号：i5-14500																																													
		3. 系统：Windows 11																																													
		4. 机箱大小：3-9.9L																																													
		5. 硬盘容量：512GB SSD+1TB HDD																																													
		6. 核心数：十核																																													
		7. 屏幕尺寸：19 寸																																													
		8. 显卡型号：集成显卡																																													
		9. 适用场景：商用																																													
		10. 采集卡：配备																																													
		二、配置																																													
		<table><tr><th>序 号</th><th>名称</th><th>型号</th><th>数 量</th><th>单 位</th></tr><tr><td>1</td><td>超声内 镜处理 器</td><td>SU-90 00-H-</td><td>1</td><td>台</td></tr><tr><td>2</td><td>超声电 子支气 管镜</td><td>EB-53 0US</td><td>1</td><td>条</td></tr><tr><td>3</td><td>全数字 化内窥 镜图像 处理器</td><td>EP-60 00</td><td>1</td><td>台</td></tr><tr><td>4</td><td>高清电 子支气 管镜(治 疗型)</td><td>EB-58 0T</td><td>1</td><td>条</td></tr><tr><td>5</td><td>高清电 子支气 管镜(检 查型)</td><td>EB-58 0S</td><td>1</td><td>条</td></tr><tr><td>6</td><td>高清监 视器</td><td>LMD-2 710MC</td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>测漏器</td><td>LT-7F</td><td></td><td></td></tr></table>	序 号	名称	型号	数 量	单 位	1	超声内 镜处理 器	SU-90 00-H-	1	台	2	超声电 子支气 管镜	EB-53 0US	1	条	3	全数字 化内窥 镜图像 处理器	EP-60 00	1	台	4	高清电 子支气 管镜(治 疗型)	EB-58 0T	1	条	5	高清电 子支气 管镜(检 查型)	EB-58 0S	1	条	6	高清监 视器	LMD-2 710MC			7	测漏器	LT-7F							
序 号	名称	型号	数 量	单 位																																											
1	超声内 镜处理 器	SU-90 00-H-	1	台																																											
2	超声电 子支气 管镜	EB-53 0US	1	条																																											
3	全数字 化内窥 镜图像 处理器	EP-60 00	1	台																																											
4	高清电 子支气 管镜(治 疗型)	EB-58 0T	1	条																																											
5	高清电 子支气 管镜(检 查型)	EB-58 0S	1	条																																											
6	高清监 视器	LMD-2 710MC																																													
7	测漏器	LT-7F																																													



			8	内窥镜 专用台 车	JY-18 -18XS	1	套						
			9	图文工 作站	/	1	套						

报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 叁佰肆拾玖万伍仟元整（¥ 3495000.00 元）

无 分标

验收标准：

1. 乙方将货物运达约定的交货地点后，甲方在五个工作日内对乙方提交的货物依据招标文件、投标文件要求和国家标准或行业标准进行现场初步验收。对外观、说明书符合要求的，给予签收；对不符合要求或有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，乙方不得拒绝和延误。
2. 乙方交货前对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果随货物交甲方。
3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
4. 验收时乙方在现场，验收完毕后作出验收结果报告。
5. 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，相关费用由甲方承担。

优惠及其它：

- 1) 故障响应时间：我公司接到故障通知后在 30 分钟内做出响应（电话），在 24 小时内派维修工程师到现场进行故障解除，如 48 小时内无法排除故障的，提供不低于故障产品规格型号和档次的备用产品供用户使用，直至故障产品修复，保证系统恢复正常运行。
- 2) 在保修期内由我公司负责保修，排除故障，无偿提供非操作不当造成的部件、配件的更换，我公司从在其指定地点收到故障产品之日起 7 天内将修理后的产品或替换产品运至最终用户现场。因操作不当或外部原因损坏，造成部件的更换，由采购人承担有关费用。保修期内，所有维修服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。
- 3) 我公司向采购人承诺终身优惠提供配件和维修。

注：

- 1、 投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空。如有多分标，按分标分别

第 8 页

-
- 2、提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。
- 2、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。
- 3、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。
- 4、以上表格要求细分项目及报价，在“具体货物内容”一栏中，填写货物具体技术参数及要求，否则其投标作无效标处理。
- 5、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。
- 6、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。
- 注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。



投标人名称(电子签章): 江西润派医疗器械有限公司

日期: 2026年01月05日



4、投标产品技术资料表、商务条款偏离表

技术需求偏离表



一、技术需求偏离表


所投分标： 无


项 号	招标文件需求		投标文件承诺		偏离说 明
	货物名称	货物参数要求	货物名称	数量	货物参数
1	超声 电子 气 管 镜 系 统	1套	超声 电子 气 管 镜 系 统	1套	(一) 超声处理器 (型号：SU-9000-H-)
		▲1. 扫描模式：B 模式、M 模式、THI、彩色多普勒、能量多普勒、脉冲波多普勒 复合谐波模式 造影谐波模式 弹性成像模式 声速修正模式以及局部声速修正功能。			▲1. 扫描模式：B 模式、M 模式、THI、彩色多普勒、能量多普勒、脉冲波多普勒 复合谐波模式 造影谐波模式 弹性成像模式 声速修正模式以及局部声速修正功能。
		2. 扫描方式：电子扫描			2. 扫描方式：电子扫描
		3. 超声波中心频率：5~12MHz 宽频扫描			3. 超声波中心频率：5~12MHz 宽频扫描
		4. 多普勒发射频率：≥2 种			4. 多普勒发射频率：2 种
		5. 超声波输出功率：超声波输出功率可调			5. 超声波输出功率：超声波输出功率可调
		6. 图像旋转：360° 旋转			6. 图像旋转：360° 旋转
		7. 半圆型显示：上半圆、下半圆、左半圆、右半圆			7. 半圆型显示：上半圆、下半圆、左半圆、右半圆
		▲8. 具有穿刺引导功能。			▲8. 具有穿刺引导功能。
		9. 数字化输出：DVI、HD-SDI			9. 数字化输出：DVI、HD-SDI
		10. 测量功能：一般测量（包括距离、面积、体积、角度、直方图等）、多普勒血流测量系统			10. 测量功能：一般测量（包括距离、面积、体积、角度、直方图等）、多普勒血流测量系统
		11. 画中画功能：内镜/超声图像切换，并可根据医			11. 画中画功能：内镜/超声图像切换，并可根据医生的习惯进行

	生的习惯进行设定		设定	
	12. 放大功能：整体放大以及 ROI 放大		12. 放大功能：整体放大以及 ROI 放大	无偏离
	(二) 超声电子支气管镜		(二) 超声电子气管镜 (型号：EB-530US)	无偏离
	内镜功能：		内镜功能：	无偏离
	1. 成像原件：CCD 或 CMOS		1. 成像原件：Super CCD	无偏离
	2. 视野角度：≥120°		2. 视野角度：120°	无偏离
	※3. 视野方向：≤10° (前斜视)		※3. 视野方向：10° (前斜视)	无偏离
	4. 观察范围：3-100mm		4. 观察范围：3-100mm	无偏离
	5. 画质：全电子高清画质		5. 画质：全电子高清画质	无偏离
	6. 先端部外径：≤6.7mm		6. 先端部外径：6.7mm	无偏离
	7. 插入部外径：≤6.3mm		7. 插入部外径：6.3mm	无偏离
	8. 有效长度：≥610mm		8. 有效长度：610mm	无偏离
	9. 弯曲角度：上/下 ≥130° /90°		9. 弯曲角度：上/下 130° /90°	无偏离
	10. 钳道内径：≥2.0mm		10. 钳道内径：2.0mm	无偏离
	超声功能：		超声功能：	无偏离
	1. 显示模式：B 模式、M 模式、彩色多普勒、能量多普勒、脉冲波多普勒、造影谐波、弹性成像		1. 显示模式：B 模式、M 模式、彩色多普勒、能量多普勒、脉冲波多普勒、造影谐波、弹性成像	无偏离
	2. 扫查方式：电子凸形扫描		2. 扫查方式：电子凸形扫描	无偏离
	3. 扫查角度：≥65°		3. 扫查角度：65°	无偏离
	4. 频率：5MHz, 7.5MHz, 10MHz, 12MHz 等		4. 频率：5MHz, 7.5MHz, 10MHz, 12MHz 等	无偏离
	▲5. 穿刺引导功能：有。		▲5. 穿刺引导功能：有。	无偏离
	6. 接触方式：水囊法、直接接触法		6. 接触方式：水囊法、直接接触法	无偏离
	(三) 全数字化内窥镜图像处理		(三) 电子内窥镜处理器 (型号：EP-6000)	无偏离
	1. 信号传输：数字 HDTV、		1. 信号传输：数字 HDTV、模拟	无偏离

 	模拟 SDTV		SDTV	
	2. 色彩调节：亮度，RGB，色度：≥9 档可调		2. 色彩调节：亮度，RGB，色度：9 档可调	无偏离
	3. 测光模式：平均测光、峰值测光及自动测光。		3. 测光模式：平均测光、峰值测光及自动测光。	无偏离
	4. 特殊光模式：BLI、BLI-bright、LCI 或 NBI 等同类技术		4. 特殊光模式：BLI、BLI-bright、LCI 等同类技术	无偏离
	5. 冻结模式：实时冻结，三种冻结模式可选		5. 冻结模式：实时冻结，三种冻结模式可选	无偏离
	6. 光源：LED		6. 光源：LED	无偏离
	※7. 灯寿命：≥10000 小时		※7. 灯寿命：14400 小时	无偏离
	8. 自动亮度调整：自动亮度调整、手动调整		8. 自动亮度调整：自动亮度调整、手动调整	无偏离
	※9. 兼容同品牌内窥镜：可兼容高清电子胃、肠镜，高清治疗电子胃、肠镜，光学放大胃、肠镜，高清经鼻内镜，高清电子十二指肠镜，环扫/扇扫超声胃镜，超声支气管镜，高清支气管镜，高清鼻咽喉镜		※9. 兼容同品牌内窥镜：可兼容高清电子胃、肠镜，高清治疗电子胃、肠镜，光学放大胃、肠镜，高清经鼻内镜，高清电子十二指肠镜，环扫/扇扫超声胃镜，超声支气管镜，高清支气管镜，高清鼻咽喉镜	无偏离
	10. 病人信息：病人 ID，病人姓名，性别，年龄，生日，记录，医院名称，医生姓名		10. 病人信息：病人 ID，病人姓名，性别，年龄，生日，记录，医院名称，医生姓名	无偏离
	11. 送气功能：横隔膜式气泵，有高/中/低/关压力切换		11. 送气功能：横隔膜式气泵，有高/中/低/关压力切换	无偏离
	12. 前面板显示：透射照明/光照限制/照明模式		12. 前面板显示：透射照明/光照限制/照明模式	无偏离
	(四) 高清电子支气管镜 (治疗型)		(四) 电子气管内窥镜 (治疗型) (型号：EB-580T)	无偏离
	1. 观察方向：0° (直视)		1. 观察方向：0° (直视)	无偏离

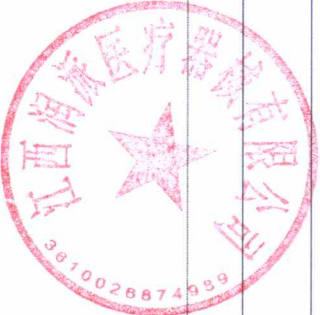		2. 视野角度: $\geq 120^\circ$	2. 视野角度: 120°	无偏离
		※3. 观察景深: 2~100mm	※3. 观察景深: 2~100mm	无偏离
		4. 头端部外径: $\Phi \leq 5.9\text{mm}$	4. 头端部外径: $\Phi 5.8\text{mm}$	无偏离
		5. 插入最大部外径: $\Phi \leq 5.9\text{mm}$	5. 插入最大部外径: $\Phi 5.9\text{mm}$	无偏离
		6. 有效长度: $\geq 600\text{mm}$	6. 有效长度: 600mm	无偏离
		7. 弯曲角度: 上: $\geq 180^\circ$ 、 下: $\geq 130^\circ$	7. 弯曲角度: 上: 180° 、下: 130°	无偏离
		8. 钳道直径: $\Phi \geq 2.8\text{mm}$	8. 钳道直径: $\Phi 2.8\text{mm}$	无偏离
		9. CCD 类型: 高分辨率 CCD, 无彩虹现象	9. CCD 类型: 高分辨率 CCD, 无彩虹现象	无偏离
		(五) 高清电子支气管镜 (检查型)	(五) 电子气管内窥镜 (检查型) (型号: EB-580S)	无偏离
		1. 观察方向: 0° (直视)	1. 观察方向: 0° (直视)	无偏离
		2. 视野角度: $\geq 120^\circ$ (广角)	2. 视野角度: 120° (广角)	无偏离
		※3. 观察范围: 2~100mm	※3. 观察范围: 2~100mm	无偏离
		4. 先端直径: $\Phi \leq 5.3\text{mm}$	4. 先端直径: $\Phi 5.3\text{mm}$	无偏离
		5. 插入部直径: $\Phi \leq 5.1\text{mm}$	5. 插入部直径: $\Phi 5.1\text{mm}$	无偏离
		6. 有效长度: $\geq 600\text{mm}$	6. 有效长度: 600mm	无偏离
		7. 全长: $\geq 870\text{mm}$	7. 全长: 870mm	无偏离
		8. 弯曲角度: 上 $\geq 180^\circ$ / 下 $\geq 130^\circ$	8. 弯曲角度: 上 210° / 下 130°	无偏离
		9. 钳道直径: $\Phi \geq 2.0\text{mm}$	9. 钳道直径: $\Phi 2.2\text{mm}$	无偏离
		(六) 监视器	(六) 监视器 (型号: LMD-2710MC)	无偏离
		1. 液晶面板	1. 液晶面板	无偏离
		2. 图像尺寸 (对角线): 约 684mm	2. 图像尺寸 (对角线): 684mm	无偏离
		3. 有效图像尺寸: 约 596 × 335mm	3. 有效图像尺寸: 596 × 335mm	无偏离
		4. 分辨率: 约 3840 × 2160 像素	4. 分辨率: 3840 × 2160 像素	无偏离
		5. 宽高比: 16: 9	5. 宽高比: 16: 9	无偏离

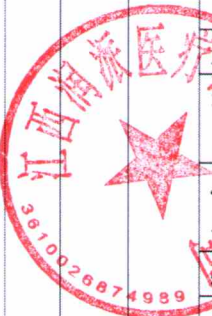 		6. 背光灯: LED	6. 背光灯: LED	无偏离
		7. 对比度: 1000: 1	7. 对比度: 1000: 1	无偏离
		8. 彩色: 约 10.7 亿色	8. 彩色: 10.7 亿色	无偏离
		9. 输入: HDMI, DVI-D, SDI 输入, 模块化接口	9. 输入: HDMI, DVI-D, SDI 输入, 模块化接口	无偏离
		10. 输出: DVI-D, SDI, 显示器端口输出	10. 输出: DVI-D, SDI, 显示器端口输出	无偏离
		11. 电源要求: 交流输入: 100V 到 240V. 50/60Hz, 1. 5A -0. 7A. 直流输入: 26V, 5. 2 A(使用交流适配器)	11. 电源: 交流输入: 100V 到 240 V. 50/60Hz, 1. 5A-0. 7A。直流输入: 26V, 5. 2A(使用交流适配器)	无偏离
		12. 功耗: 约 149W	12. 功耗: 149W	无偏离
		13. 操作温度: 0-35°C	13. 操作温度: 0-35°C	无偏离
		(七) 内窥镜专用台车	(七) 内窥镜专用台车 (型号: JY-18-18XS)	无偏离
		1. 净重≥80kg	1. 净重 80kg	无偏离
		2. 承重≥150kg	2. 承重 150kg	无偏离
		3. 产品规格: 约长 720mm ×宽 680mm×高 1450mm	3. 产品规格: 长 720mm×宽 680mm ×高 1450mm	无偏离
		4. 设备层板数量: 共 3 层 包含键盘托	4. 设备层板数量: 共 3 层 包含键盘托	无偏离
		5. 标准供电: 220V 50HZ	5. 标准供电: 220V 50HZ	无偏离
		(八) 图文工作站	(八) 图文工作站	无偏离
		1. 内存容量: ≥16G	1. 内存容量: 16G	无偏离
		2. CPU 型号: i5-14500	2. CPU 型号: i5-14500	无偏离
		3. 系统: Windows 11	3. 系统: Windows 11	无偏离
		4. 机箱大小: 3-9. 9L	4. 机箱大小: 3-9. 9L	无偏离
		5. 硬盘容量: 512GB SSD+1TB HDD	5. 硬盘容量: 512GB SSD+1TB HDD	无偏离
		6. 核心数: 十核	6. 核心数: 十核	无偏离
		7. 屏幕尺寸: ≥19 寸	7. 屏幕尺寸: 19 寸	无偏离
		8. 显卡型号: 集成显卡	8. 显卡型号: 集成显卡	无偏离
		9. 适用场景: 商用	9. 适用场景: 商用	无偏离
		10. 采集卡: 配备	10. 采集卡: 配备	无偏离

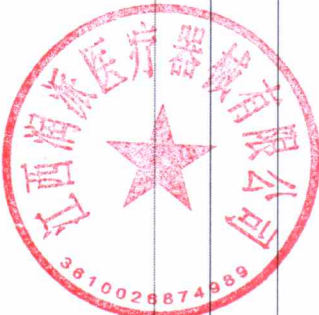	二、配置要求				无偏离
	序号	名称	数量	单位	
	1	超声内镜处理器	1	台	
		超声电子支气管镜	1	条	
		全数字化内窥镜图像处理器	1	台	
	4	高清电子支气管镜（治疗型）	1	条	
	5	高清电子支气管镜（检查型）	1	条	
	6	监视器	1	台	
	7	内窥镜专用台车	1	台	
	8	图文工作站	1	套	
	二、配置				无偏离
	序号	名称	型号	数量	单位
	1	超声内镜处理器	SU-9000-H-	1	台
	2	超声电子支气管镜	EB-530US	1	条
	3	全数字化内窥镜图像处理器	EP-6000	1	台
	4	高清电子支气管镜（治疗型）	EB-580T	1	条
	5	高清电子支气管镜（检查型）	EB-580S	1	条
	6	高清监视器	LMD-2710MC	1	台
	7	测漏器	LT-7F	1	台
	8	内窥镜专用台车	JY-18-18XS	1	套
	9	图文工作站	/	1	套

注：

- 1.说明：应对照招标文件“第二章”中“货物需求一览表”的采购清单及技术参数条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。
- 2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标
- 3.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。
- 4.如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，投标文件承诺不得直

接复制采购需求，投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数的具体数值，否则按投标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“投标无效”条款。

5. 如技术偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

投标人名称(电子签章): 江西润派医疗器械有限公司

日期: 2026年01月06日



商务条款偏离表

四、商务条款偏离表

分标号：_____ 无 _____

项号	招标文件的商务需求	投标文件承诺的商务条款	偏离说明
一	一、合同签订期：自中标通知书发出之日起 25 日内。	一、合同签订期：自中标通知书发出之日起 25 日内。	无偏离
二	二、交货期：自合同签订之日起 90 日历天内完成供货、安装及验收并交付使用。	二、交货期：自合同签订之日起 90 日历天内完成供货、安装及验收并交付使用。	无偏离
三	三、交货地点：采购人指定地点。	三、交货地点：采购人指定地点。	无偏离
四	四、交货方式：现场交货。	四、交货方式：现场交货。	无偏离
五	五、售后服务要求：	五、售后服务要求：	无偏离
	▲1、质量保证期不少于 2 年（自交货安装及验收并交付使用之日起计）。	▲1、质量保证期 3 年（自交货安装及验收并交付使用之日起计）。	正偏离
	2、售后服务要求：	2、售后服务：	无偏离
	1) 故障响应时间：供应商接到故障通知后需在 30 分钟内做出响应（电话），在 24 小时内派维修工程师到现场进行故障解除，如 48 小时内无法排除故障的，必须提供不低于故障产品规格型号和档次的备用产品供用户使用，直至故障产品修复，保证系统恢复正常运行。	1) 故障响应时间：我公司接到故障通知后在 30 分钟内做出响应（电话：15360689820），在 24 小时内派维修工程师到现场进行故障解除，如 48 小时内无法排除故障的，提供不低于故障产品规格型号和档次的备用产品供用户使用，直至故障产品修复，保证系统恢复正常运行。	无偏离
	2) 在保修期内由供应商负责保修，排除故障，无偿提供非操作不当造成的部件、配件的更换，供应商从在其指定地点收到故障产品之日起 7 天内将修理后的产品或替换产品运至最终用户现场。因操作不	2) 在保修期内由我公司负责保修，排除故障，无偿提供非操作不当造成的部件、配件的更换，我公司从在其指定地点收到故障产品之日起 7 天内将修理后的产品或替换产品运至最终用户现场。因操作不	无偏离

	当或外部原因损坏，造成部件的更换，应由采购人承担有关费用。保修期内，所有维修服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。	当或外部原因损坏，造成部件的更换，由采购人承担有关费用。保修期内，所有维修服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。	
	3) 供应商须向采购人承诺终身优惠提供配件和维修。	3) 我公司向采购人承诺终身优惠提供配件和维修。	无偏离
	4) 供应商应免费培训采购人维护人员，保证维护人员能进行日常运行维护工作，提供用户操作手册和维修手册；并能熟练地排除故障、管理设备、分析故障等。	4) 我公司免费培训采购人维护人员，保证维护人员能进行日常运行维护工作，提供用户操作手册和维修手册；并能熟练地排除故障、管理设备、分析故障等。	无偏离
	5) 如需升级软件，免费升级软件。	5) 如需升级软件，免费升级软件。	无偏离
六	六、其他要求：	六、其他：	无偏离
	▲1、投标报价包括但不限于：	▲1、投标报价包括但不限于：	无偏离
	1) 货物的价格；	1) 货物的价格；	无偏离
	2) 货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；	2) 货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；	无偏离
	3) 运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；	3) 运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；	无偏离
	4) 必要的保险费用和各项税费；	4) 必要的保险费用和各项税费；	无偏离
	5) 包括安装费用；	5) 包括安装费用；	无偏离
	6) 检测部门产品检测费用；	6) 检测部门产品检测费用；	无偏离
	7) 审核部门费用；	7) 审核部门费用；	无偏离
	8) 如果设备数据需要采集到医院业务系统，并出具报告单，则设备与医院业务系统对接产生的软硬件接口费用由设备成交人承担。	8) 如果设备数据需要采集到医院业务系统，并出具报告单，则设备与医院业务系统对接产生的软硬件接口费用由我公司承担。	无偏离
	▲2、设备在验收过程中出现无法满足招标文件规定的参数及要求的，采购人不予验收并终止合同，	▲2、设备在验收过程中出现无法满足招标文件规定的参数及要求的，采购人不予验收并终止合同，	无偏离

	一切后果由供应商承担。	一切后果由我公司承担。	
	3、付款方式：签订合同后 7 个工作日内预付合同总额的 30%，验收合格后 60 个工作日内支付合同总额的 40%，验收合格后 120 个工作日内支付剩余合同总额的 30%。（付款前供应商必须提供真实、有效、合法的正式发票，如提供假发票的，供应商除须向采购人重开合法发票外，还须按发票票面金额一倍的赔偿违约金给采购人，与此相关的行政处罚、刑事责任亦由供应商承担）	3、付款方式：签订合同后 7 个工作日内预付合同总额的 30%，验收合格后 60 个工作日内支付合同总额的 40%，验收合格后 120 个工作日内支付剩余合同总额的 30%。（付款前我公司提供真实、有效、合法的正式发票，如提供假发票的我公司除向采购人重开合法发票外，还按发票票面金额一倍的赔偿违约金给采购人，与此相关的行政处罚、刑事责任亦由我公司承担）	无偏离
	本项目的“超声电子气管镜系统”已经过进口设备论证，采购进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不得对其加以限制，应当按照公平竞争原则实施采购；采购的进口产品医疗器械部分必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。	本项目的“超声电子气管镜系统”已经过进口设备论证，采购进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不得对其加以限制，应当按照公平竞争原则实施采购；采购的进口产品医疗器械部分为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时我公司负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。	无偏离

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。
2. 投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假

应标。

3. 表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

4. 如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，投标文件承诺不得直接复制采购需求，投标文件承诺内容应当写明商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“投标无效”条款。

投标人名称(电子签章): 江西润嘉医疗器械有限公司

日期: 2026年01月05日



5、投标产品配置清单

二、配置清单



货物配置清单

序号	货物名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
1	超声电子气管镜系统	1 套	富士	EP-6000	富士胶片株式会社	东京	(一) 超声处理器 (型号: SU-9000-H) 1. 扫描模式: B 模式、M 模式、THI、彩色多普勒、能量多普勒、脉冲波多普勒 复合谐波模式 造影谐波模式 弹性成像模式 声速校正模式以及局部声速校正功能。 2. 扫描方式: 电子扫描 3. 超声波中心频率: 5~12MHz 宽频扫描 4. 多普勒发射频率: 2 种 5. 超声波输出功率: 超声波输出功率可调 6. 图像旋转: 360° 旋转 7. 半圆型显示: 上半圆、下半圆、左半圆、右半圆 8. 具有穿刺引导功能。 9. 数字化输出: DVI、HD-SDI 10. 测量功能: 一般测量 (包括距离、面积、体积、角度、直方图等)、多普勒血流测量系统 11. 画中画功能: 内镜/超声图像切换, 并可根据医生的习惯进行设定 12. 放大功能: 整体放大以及 ROI 放大 (二) 超声电子气管镜 (型号: EB-530US)

		 				内镜功能: 1. 成像原件: Super CCD 2. 视野角度: 120° 3. 视野方向: 10° (前斜视) 4. 观察范围: 3-100mm 5. 画质: 全电子高清画质 6. 先端部外径: 6.7mm 7. 插入部外径: 6.3mm 8. 有效长度: 610mm 9. 弯曲角度: 上/下 130° /90° 10. 钳道内径: 2.0mm 超声功能: 1. 显示模式: B 模式、M 模式、彩色多普勒、能量多普勒、脉冲波多普勒、造影谐波、弹性成像 2. 扫查方式: 电子凸形扫描 3. 扫查角度: 65° 4. 频率: 5MHz, 7.5MHz, 10MHz, 12MHz 等 5. 穿刺引导功能: 有。 6. 接触方式: 水囊法、直接接触法 (三) 电子内窥镜处理器 (型号: EP-6000) 1. 信号传输: 数字 HDTV、模拟 SDTV 2. 色彩调节: 亮度, RGB, 色度: 9 档可调 3. 测光模式: 平均测光、峰值测光及自动测光。 4. 特殊光模式: BLI、BLI-bright、LCI 等同类技术 5. 冻结模式: 实时冻结, 三种冻结模式可选 6. 光源: LED
--	--	--	--	--	--	---

 						7. 灯寿命：14400 小时 8. 自动亮度调整：自动亮度调整、手动调整 9. 兼容同品牌内窥镜：可兼容高清电子胃、肠镜，高清治疗电子胃、肠镜，光学放大胃、肠镜，高清经鼻内镜，高清电子十二指肠镜，环扫/扇扫超声胃镜，超声支气管镜，高清支气管镜，高清鼻咽喉镜 10. 病人信息：病人 ID，病人姓名，性别，年龄，生日，记录，医院名称，医生姓名 11. 送气功能：横隔膜式气泵，有高/中/低/关压力切换 12. 前面板显示：透射照明/光照限制/照明模式 （四）电子气管内窥镜（治疗型） （型号：EB-580T） 1. 观察方向：0°（直视） 2. 视野角度：120° 3. 观察景深：2~100mm 4. 头端部外径：Φ5.8mm 5. 插入最大部外径：Φ5.9mm 6. 有效长度：600mm 7. 弯曲角度：上：180°、下：130° 8. 钳道直径：Φ2.8mm 9. CCD 类型：高分辨率 CCD，无彩虹现象 （五）电子气管内窥镜（检查型） （型号：EB-580S） 1. 观察方向：0°（直视） 2. 视野角度：120°（广角） 3. 观察范围：2~100mm 4. 先端直径：Φ5.3mm
---	--	--	--	--	--	---

						5. 插入部直径：Φ5.1mm 6. 有效长度：600mm 7. 全长：870mm 8. 弯曲角度：上 210° /下 130° 9. 钳道直径：Φ2.2mm (六) 监视器 (型号：LMD-2710MC) 1. 液晶面板 2. 图像尺寸 (对角线)：684mm 3. 有效图像尺寸：596×335mm 4. 分辨率：3840×2160 像素 5. 宽高比：16：9 6. 背光灯：LED 7. 对比度：1000：1 8. 彩色：10.7 亿色 9. 输入：HDMI，DVI-D，SDI 输入，模块化接口 10. 输出：DVI-D, SDI, 显示器端口输出 11. 电源：交流输入：100V 到 240V. 50/60Hz, 1.5A-0.7A。直流输入：26V, 5.2A (使用交流适配器) 12. 功耗：149W 13. 操作温度：0-35℃ (七) 内窥镜专用台车 (型号：JY-18-18XS) 1. 净重 80kg 2. 承重 150kg 3. 产品规格：长 720mm×宽 680mm×高 1450mm 4. 设备层板数量：共 3 层 包含键盘托 5. 标准供电：220V 50HZ (八) 图文工作站 1. 内存容量：16G
--	--	--	--	--	--	--

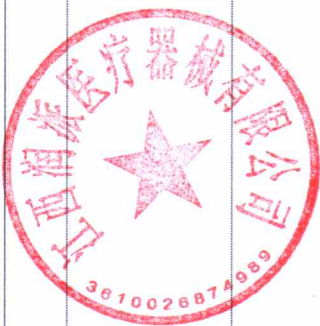 						2. CPU 型号: i5-14500 3. 系统: Windows 11 4. 机箱大小: 3-9.9L 5. 硬盘容量: 512GB SSD+1TB HDD 6. 核心数: 十核 7. 屏幕尺寸: 19 寸 8. 显卡型号: 集成显卡 9. 适用场景: 商用 10. 采集卡: 配备																																																		
						二、配置																																																		
						<table><tr><th>序号</th><th>名称</th><th>型号</th><th>数量</th><th>单位</th></tr><tr><td>1</td><td>超声内镜处理器</td><td>SU-9000-H-</td><td>1</td><td>台</td></tr><tr><td>2</td><td>超声电子支气管镜</td><td>EB-530US</td><td>1</td><td>条</td></tr><tr><td>3</td><td>全数字化内窥镜图像处理</td><td>EP-6000</td><td>1</td><td>台</td></tr><tr><td>4</td><td>高清电子支气管镜(治疗型)</td><td>EB-580T</td><td>1</td><td>条</td></tr><tr><td>5</td><td>高清电子支气管镜(检查型)</td><td>EB-580S</td><td>1</td><td>条</td></tr><tr><td>6</td><td>高清监视器</td><td>LMD-2710MC</td><td>1</td><td>台</td></tr><tr><td>7</td><td>测漏器</td><td>LT-7F</td><td>1</td><td>台</td></tr><tr><td>8</td><td>内窥镜专用台车</td><td>JY-18-18XS</td><td>1</td><td>套</td></tr><tr><td>9</td><td>图文工作站</td><td>/</td><td>1</td><td>套</td></tr></table>	序号	名称	型号	数量	单位	1	超声内镜处理器	SU-9000-H-	1	台	2	超声电子支气管镜	EB-530US	1	条	3	全数字化内窥镜图像处理	EP-6000	1	台	4	高清电子支气管镜(治疗型)	EB-580T	1	条	5	高清电子支气管镜(检查型)	EB-580S	1	条	6	高清监视器	LMD-2710MC	1	台	7	测漏器	LT-7F	1	台	8	内窥镜专用台车	JY-18-18XS	1	套	9	图文工作站	/	1	套
	序号	名称	型号	数量	单位																																																			
	1	超声内镜处理器	SU-9000-H-	1	台																																																			
	2	超声电子支气管镜	EB-530US	1	条																																																			
	3	全数字化内窥镜图像处理	EP-6000	1	台																																																			
	4	高清电子支气管镜(治疗型)	EB-580T	1	条																																																			
	5	高清电子支气管镜(检查型)	EB-580S	1	条																																																			
	6	高清监视器	LMD-2710MC	1	台																																																			
7	测漏器	LT-7F	1	台																																																				
8	内窥镜专用台车	JY-18-18XS	1	套																																																				
9	图文工作站	/	1	套																																																				

备注:

以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，投标文件作无效处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“货物需求一览表”一致，否则投标文件作无效处理。

投标人名称(电子签章): 江西润派医疗器械有限公司

日期: 2026 年 04 月 05 日



6、售后服务承诺

三、售后服务承诺

1、合同签订期：自中标通知书发出之日起 25 日内。

2、交货期：自合同签订之日起 90 日历天内完成供货、安装及验收并交付使用。

3、交货地点：采购人指定地点。

4、交货方式：现场交货。

5、售后服务要求：

1. 质量保证期：3 年（自交货安装及验收并交付使用之日起计）。

2. 售后技术服务：

1) 故障响应时间：我公司接到故障通知后在 30 分钟内做出响应（电话：15360689820），在 24 小时内派维修工程师到现场进行故障解除，如 48 小时内无法排除故障的，提供不低于故障产品规格型号和档次的备用产品供用户使用，直至故障产品修复，保证系统恢复正常运行。

2) 在保修期内由我公司负责保修，排除故障，无偿提供非操作不当造成的部件、配件的更换，我公司从在其指定地点收到故障产品之日起 7 天内将修理后的产品或替换产品运至最终用户现场。因操作不当或外部原因损坏，造成部件的更换，由采购人承担有关费用。保修期内，所有维修服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。

3) 我公司向采购人承诺终身优惠提供配件和维修。

4) 我公司免费培训采购人维护人员，保证维护人员能进行日常运行维护工作，提供用户操作手册和维修手册；并能熟练地排除故障、管理设备、分析故障等。

5) 如需升级软件，免费升级软件。

6、其他：

1. 投标报价包括但不限于：

1) 货物的价格；

2) 货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

3) 运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；

4) 必要的保险费用和各项税费；

5) 包括安装费用；

6) 检测部门产品检测费用；

7) 审核部门费用；

8) 如果设备数据需要采集到医院业务系统，并出具报告单，则设备与医院业务系统对接产生

的软硬件接口费用由我公司承担。

2. 设备在验收过程中出现无法满足招标文件规定的参数及要求的，采购人不予验收并终止合同，一切后果由我公司承担。

3. 付款方式：签订合同后 7 个工作日内预付合同总额的 30%，验收合格后 60 个工作日内支付合同总额的 40%，验收合格后 120 个工作日内支付剩余合同总额的 30%。（付款前我公司提供真实、有效、合法的正式发票，如提供假发票的我公司除向采购人重开合法发票外，还按发票票面金额一倍的赔偿违约金给采购人，与此相关的行政处罚、刑事责任亦由我公司承担）

4. 本项目的“超声电子气管镜系统”已经过进口设备论证，采购进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不得对其加以限制，当按照公平竞争原则实施采购；采购的进口产品医疗器械部分必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时我公司负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。

投标人名称(电子签章)：江西润派医疗器械有限公司

日期：2026 年 01 月 05 日





售后服务承诺书

我公司针对超声电子气管镜系统（YLZC2025-G1-990483-GX12）提供以下售后服务方案，
确保设备的正常运行、及时响应和解决问题，以及提供维护保养和应急保障措施：

一、设备质量承诺

我方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量与招标文件、投标文件和承诺相一致。

2、我方所提供设备是全新、完整、未使用过的原装进口产品，是符合我国有关规范、环保要求及相关检测标准，并达到采购方招标要求的设备技术参数及性能。交货时提供投标货物整机商检证明材料、报关单等。

二、交货承诺

我方确保所带给用户的产品按照采购方要求按时将货物送到指定地点，在采购合同签订并接采购人供货通知后 60 个日历日内交货并完成安装调试。交货现场免费安装调试、培训、全部货物及随附配件、软件全部清点无误且正常使用，达到用户使用功能要求。

三、质保期

1、免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，**免费保修期 3 年**（免费保修期为自设备验收合格签字之日起计算）。质保期内非人为损坏免费更换所有故障零配件，
并免费提供硬件的安全性改版升级和技术支持，确保设备正常运行。

2、免费保修范围：涵盖设备的硬件及软件故障，免费更换故障部件，维修和更换配件所需的劳动成本也包括在内，合同金额包含质保期内所产生的一切费用。

3、质保期所更换的零配件是原厂全新的零配件，满足设备运行要求。

4、在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，免费修理和无条件更换，并按售后服务承诺书，延长保修期。

四、售后服务

我公司对所售货物提供终身维护、维修，负责产品的技术咨询、安装、培训、维修、定期维护保养、产品升级和客户投诉、建议，提供中文操作、保养、维修维护手册、软件备份、故障代码表、备件清单等相关技术支持文件及其它相关的服务。具体内容如下：

1、免费培训：在为用户安装、调试产品或软件的同时，对相关操作人员免费进行技术培训，使其按提供的操作规程使用产品，并熟悉例行维护的程序。

2、为用户提供三种售后服务形式：

（1）电话咨询，通过电话沟通，提供解决方案；

（2）网络咨询，通过网络远程指导用户的相关技术人员处理；

（3）现场响应，由工程师自带配件上门服务。

3、**7*24 小时服务电话**：0771-3859086、15994347518、18172385569，享受全面、迅速、优质的在线服务。

4、**故障响应**：保修期内免费提供售后服务，设备出现故障，在接到采购方通知后 30 分钟内响应，24 小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过 24 小时修复；重大故障处理时限不超过 48 小时修复，48 小时无法修复的提供同档次备用设备供采购方使用。

故障解决方案：接到用户设备故障报告电话时，首先询问故障现象，根据故障情况判断是否需要赶赴现场，对于一般性技术故障，可以利用电话或远程指导用户自行解决；在用户无法解决或请求现场服务的情况下，按照技术支持与售后服务小组的责任分工，统一指挥，协调行动，及时赶赴现场，解决问题；





派往现场的技术服务人员，均是具有 5 年以上经验的技术全面的工程师，保证故障发生时技术人员能迅速解决现场故障。

5、定期维护：我公司将定期（每月一次）对所供设备系统运行情况进行巡检、回访，消除故障隐患，以保证设备的正常运行。保养完毕，将提供《现场服务记录单》。

6、技术升级：在质保期内，如果用户购买的产品技术升级，我公司将及时通知用户，如用户有相应要求，我公司将对用户购买的产品进行升级服务。

五、质保期外售后服务

1、提供 7*24 小时电话咨询服务热线：0771-3859086、15994347518、18172385569，根据故障情况提供有偿的维修服务。

2、保证一般故障 12 小时内处理完毕恢复正常。

3、配件供应：在全国各大中型城市设有配件库，备有一般常用零配件，可保证及时快捷的将备品配件提供到采购方的手中，解决使用问题。

4、提供终身维护服务，只收取成本费。如果同型号的产品技术升级，我公司将通知采购方，如采购方有相应要求，我公司将提供配置优惠价格和软件进行升级服务。

六、维护保养服务：

1、日常维护、保养：提供设备的日常维护指南，包括设备的清洁、消毒、定期检查和维护注意事项等，并提供相应的维护工具；制定设备的保养计划，包括更换易损件、校准仪器、软件升级等，以确保设备的长期稳定运行。


我公司将制定详细的维保计划，并在每次维护保养时间前一周通知采购人，协调确定具体保养时间。维护保养在不影响采购人正常工作的时间内进行。

2、巡检：每月至少 1 次派遣专业技术人员对设备进行巡检，确保设备的正常运行并及时发现潜在问题。

3、定期质量审查：定期进行设备质量审查和性能评估，以确保设备符合相关标准和要求，并给予采购方反馈和改进建议。



七、服务流程

1、安装培训流程

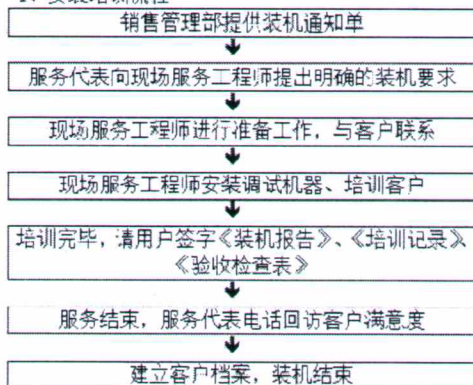


2、定期保养流程



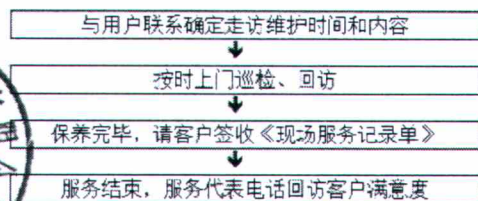

3、维修服务流程

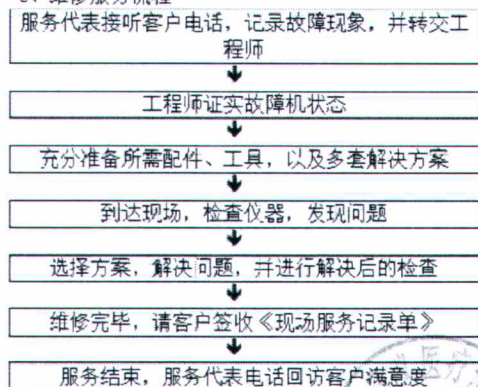

八、售后培训计划：

1、装机培训

- (1) 培训方式：装机现场集中培训。
- (2) 培训地点：用户指定地点。
- (3) 接受培训人员类型：(1) 相关临床科室使用人员；(2) 相关职能科室服务人员；(3) 采购人和用户指派的其他相关人员。
- (4) 接受培训人员人数至少2人。
- (5) 培训目标：经培训，使每个接受培训人员能够达到对所购设备熟练地规范操作、对一般故障处理和对机器的日常维护及保养。
- (6) 培训时间：在收到采购人通知后1天内安排，3天内落实培训。
- (7) 培训费用：受训人员的资料费、教师费用等费用一律免费。

九、本地化售后服务情况

售后服务地址：南宁市星光大道223号荣宝华商城A3栋207号房
电话：0771-3859086、19195977447、13202044213

