

柳州市工人医院医疗设备采购合同

采购单位(甲方)：柳州市工人医院

合同编号：LGY-YS-2025-218

供应商(乙方)：广西尚合嘉科技有限公司

签订地点：柳州市柳南区和平路 156 号

签订时间：2025 年 12 月 22 日

根据《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招投标文件(或竞争性磋商)规定条款和中标(或成交)供应商承诺，就甲方委托乙方提供柳州市工人医院项目之相关事宜，达成以下协议，并承诺共同遵守。

第一条 合同标的

1. 供货一览表

物品名称	规格型号	品牌	数量	配置	单价	总额
肿瘤专科实验室设备 (具体详见附件 1)	详见附件 1	详见附件 1	1 批	详见附件 2	2295.164 万元	2295.164 万元

2. 合同合计金额：(大写) 贰仟贰佰玖拾伍万壹仟陆佰肆拾元整，合同金额包括为了实施和完成项目所需货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输材料费、人工费、车辆费、税费等所有费用及合同包含的所有风险等各项应有的费用等。招投标(或竞争性磋商)文件对其另有规定的，从其规定。

3. 质保 三 年(详见附件 2)，自设备验收合格之日起算(以甲方出具的验收报告单为准)。

第二条 质量保证

1. 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件(或竞争性磋商)和承诺相一致。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

不符合要求的，根据实际情况，甲方有权选择以下权利：

(1) 自验收之日起 7 日内，出现性能故障，甲方可以选择退货或换货，由乙方承担所发生的全部费用；

(2) 自验收之日起 15 日内，出现性能故障，甲方可以选择换货或修理，由乙方承担所发生的全部费用；

(3) 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按招标文件(或竞争性磋商)规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 没有甲方事先书面同意,乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供,也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装,以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方,以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点,同时需通知甲方货物已送达,甲方确认接收后视为交付。

6. 货物的运输方式: 乙方自行选择。

7. 乙方负责货物运输,货物运输合理损耗及计算方法: 运输费用、损耗等相关风险全部由乙方承担。

第五条 交付和调试验收

1. 交货、安装时间: 自合同签订之日起,国产设备 23 天(进口设备 83 天)内,交货并安装调试完毕交付使用。地点: 甲方指定地点。

2. 甲方应配合乙方运输安装设备,乙方在运输安装设备过程中不得损坏甲方设施(如地面、墙面、电梯、绿化带等),如有损坏,合理补偿。

3. 乙方提供的货物应包含生产厂家出具的装箱清单、使用说明书、合格证(境内)、保修卡(境内)、中华人民共和国海关进口货物报关单(境外)、中华人民共和国出入境检验检疫证明(境外)等验收材料。如有缺失应及时补齐,否则视为材料不齐,验收不合格。

4. 乙方需负责办理供货设备中特种设备相应特种设备相关事项,包括设备在生产所在地的检验部门监检合格并签发质量合格证书;以及在甲方所在地申请特种设备监检验收、办理使用登记证、压力表校验、安全阀校验等,此项工作由乙方组织并承担监检验收费用,保证整体设备合法合规使用,并将全套特种设备相应材料移交验收,如需甲方配合部分,甲方需提供相应支持。

5. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时,乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员,并协助甲方一起调试,直到符合技术要求,甲方才做最终验收。

6. 对技术复杂的货物,甲方可以请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收,并由其出具质量检测报告。

7. 甲方应当在到货安装、调试完毕后 10 个工作日内完成验收,并作出验收报告单,甲乙双方各执一份。验收时乙方必须到场,如需第三方参与验收,所发生的费用由乙方负责。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2. 乙方负责甲方有关操作人员的培训。

第七条 售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标（或竞争性磋商）文件为甲方提供售后服务。
2. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项详见招投标（或竞争性磋商）文件。

第八条 付款方式和税费

1. 乙方在甲方指定银行开设共管账户，由甲方和乙方双方共同管理。
2. 合同签署后，甲方将合同总金额 100% 转入共管账户。乙方全额开具发票给采购人。
3. 设备到货后，按所到批次设备对应金额的 70%，支付货款，经共管账户向乙方指定账户转账支付相应货款。（不计利息）
4. 所有设备安装调试完成并正常运行后，乙方验收合格（以采购人出具验收报告为准），经共管账户向乙方发票指定账户支付合同总金额的 25% 货款。（不计利息）
5. 自验收合格之日起，设备正常使用一年期满，经共管账户向乙方支付合同总金额的 5% 货款。（不计利息）
6. 以下为共管银行账号收款信息：
开户名：广西尚合嘉科技有限公司
开户银行：交通银行柳州三中支行
账号：452060201015003050524

第九条 违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5% 违约金并赔偿甲方经济损失。
2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。
4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3% 违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过十天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。
5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5% 向甲方支付违约金。
6. 其它违约行为按违约货款额 5% 收取违约金并赔偿经济损失。
7. 违约方应向守约方支付因主张权利所产生的诉讼费、公证费、保全费、律师代理费等一系列维权费用。

第十条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后, 应立即通知对方, 并寄送有关权威机构出具的证明。
3. 不可抗力事件延续 30 天以上, 双方应通过友好协商, 确定是否继续履行合同。

第十一条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的, 应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的, 鉴定费由甲方承担; 货物不符合标准的, 鉴定费由乙方承担。
2. 甲、乙双方在执行合同中所发生的一切争议, 应通过协商解决。如果协商不能解决, 向甲方所在地管辖的人民法院起诉。

第十二条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
2. 本合同未尽事宜, 遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十三条 合同的变更、终止与转让

1. 除非中华人民共和国法律另有规定外, 本合同一经签订, 甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。因故需要变更或解除合同, 应双方协商一致, 另立协议。
2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的, 须签书面补充协议, 补充协议作为主合同不可分割的一部分。
3. 合同生效后, 乙方不得将业务授权给其他公司, 否则甲方有权拒绝付款。

第十四条 签订本合同依据

1. 招标文件/竞争性磋商文件;
2. 乙方提供的采购响应(或应答)文件;
3. 磋商/谈价记录、投标承诺书;
4. 中标或成交通知书。

第十五条 廉洁条款

乙方承诺不从事商业贿赂行为, 遵守廉洁协议或相关规定。甲方发现乙方有违反廉洁协议或相关规定采用不正当手段进行不正当竞争行为的, 或被有关部门生效文书认定有贿赂或者受贿行为的, 甲方有权终止该业务合同, 由此给甲方造成的损失以及发生的一切费用均由乙方承担, 甲方有权对乙方实施商业贿赂不良记录, 列入“黑名单”, 并三年内取消其业务往来资格。

第十六条 本合同一式 肆 份, 具有同等法律效力, 甲方 叁 份, 乙方 壹 份。

第十七条 仪器设备接口要求(附件 3: 柳州市工人医院信息工程部的数据), 乙方应按照附件中仪器设备接口要求进行供货。

甲方：柳州市工人医院

法定代表人：

联系电话：0772-3813315



乙方：

法定代表人：

联系电话：18178716809




合同编号：LGY-YS-2025-218

公司地址：桂林市灵川县定江镇八里四路37号

(5#401)

签订日期：2025年12月22日

院办存档

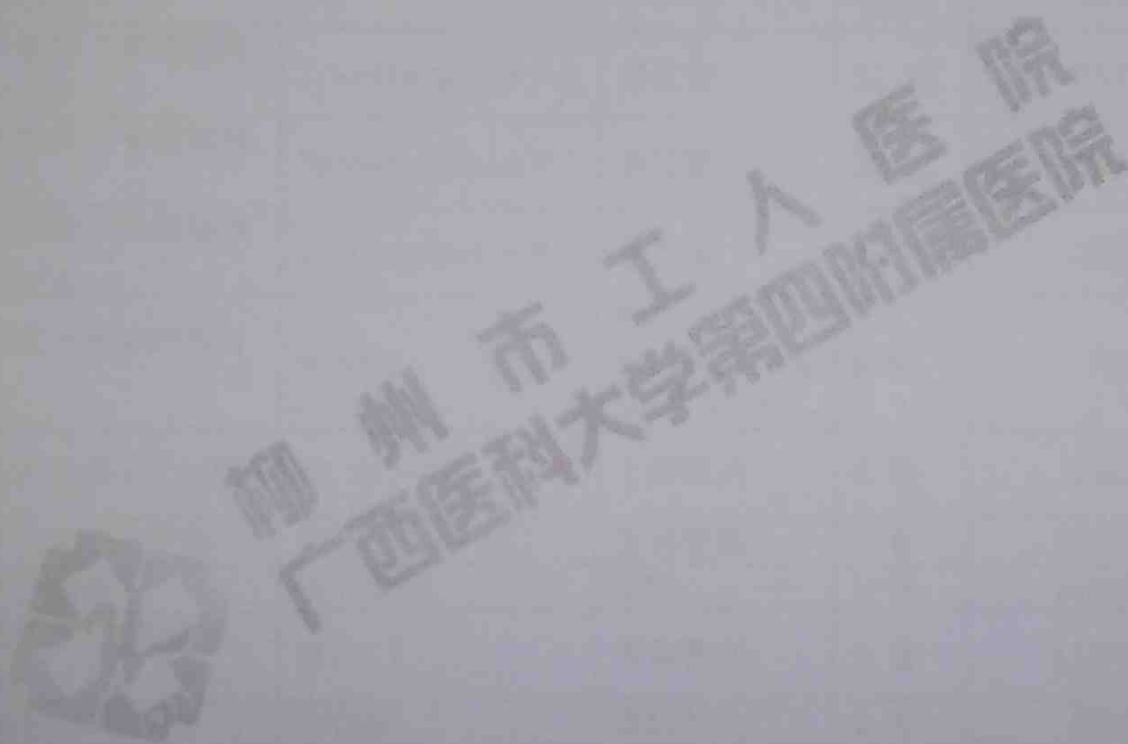

附件 1: 肿瘤专科实验室设备详细表

序号	标的名称	规格型号	品牌	数量	分项单价 (元)	分项总价 (元)
1	生物安全柜	EAC2-4S1	ESCO	9 台	48000	432000
2	二氧化碳培养箱	CLM-170B-8-TC	ESCO	16 台	51000	816000
2	二氧化碳培养箱	CLM-170T-8-TC	ESCO	8 台	90000	720000
3	高速冷冻离心机(离心机)	Sorvall ST1R Plus MD	赛默飞	7 台	98000	686000
4	高速冷冻离心机(离心机)	Sorvall ST1R Plus MD	赛默飞	2 台	98000	196000
5	低速台式离心机(低速离心机)	TM100K	湖南可成	3 台	29000	87000
6	生物显微镜(倒置显微镜)	CKX53	OLYMPUS	6 台	70000	420000
7	电动大容量助吸器(电动助吸器)	EP101	四亿	13 把	1000	13000
8	单通道移液器(单道移液器 100-1000ul)	Transferpette® S	普兰德	21 把	3200	67200
9	单通道移液器(单道移液器 20-200ul)	Transferpette® S	普兰德	21 把	3200	67200
10	单通道移液器(单道移液器 2-20ul)	Transferpette® S	普兰德	22 把	3200	70400
11	单通道移液器(单道移液器 0.5-10ul)	Transferpette® S	普兰德	22 把	3200	70400
12	血球计算盘(血球细胞计数板)	650030	Paul MarienfeldGm bH & Co. KG	6 块	200	1200
13	电热恒温水浴锅(水浴锅)	HH. S11-1	上海博迅	6 台	2500	15000
14	电子天平(电子天平秤)	ES225SM-DR (E)	普利赛斯	1 台	22000	22000
15	尘埃粒子计数器	CLJ-B550	宏瑞	1 台	33000	33000
16	浮游菌采样器(空气浮游菌采样器)	FKC- I	青岛聚创	1 台	13500	13500
17	紫外辐照计	LS126C	深圳林上	1 台	2500	2500
18	二氧化碳测定仪	G100	geotech	1 台	18000	18000
19	医用冷藏箱(医用冷藏冰箱)	YC-1000L	中科美菱	3 台	23600	70800
20	医用冷藏冷冻箱(医用冷藏冷冻冰箱)	YCD-EL300	中科美菱	11 台	10000	110000
21	超低温冷冻储存箱(超低温冰箱)	DW-HL340	中科美菱	3 台	50000	150000
22	流式细胞仪(增强型细胞分析系统)	DxFLEX	贝克曼	1 台	1350000	1350000
23	细胞内毒素测定仪(动态试管检测仪)	BET-48G	天津天大天发	1 台	150000	150000
24	混合仪(旋涡混合仪/标准混合仪)	CubicB	四亿	1 台	1500	1500
25	微滴式数字 PCR 系统(数字 PCR 系统)	QX700 E	上海上牧	1 台	985000	985000
26	梯度 PCR 仪(PCR 基因扩增仪)	T100	伯乐	1 台	55000	55000

序号	标的名称	规格型号	品牌	数量	分项单价 (元)	分项总价 (元)
27	迷你离心机(掌上离心机)	ETmini	四亿	1 台	2000	2000
28	小型垂直电泳槽(电泳仪)	Mini-PROTEAN® Tetra Cell	伯乐	2 台	30000	60000
29	智能图像工作站(全自动 多功能成像系统)	GelView 6000 PLUS	博鹭腾	1 台	220000	220000
30	智能生化培养箱(生化培 养箱)	SPX-160H	宁波扬辉	3 台	12000	36000
31	智能霉菌培养箱(霉菌培 养箱)	MJX-160HS	宁波扬辉	3 台	12000	36000
32	小型台式全温振荡培养箱 (恒温培养摇床/小型全 温震荡培养箱)	ZQTY-30	上海知楚	3 台	15400	46200
33	电动吸引器(负压吸引器)	7A-23D	江苏鱼跃	2 台	1250	2500
34	立式灭菌器(高压蒸汽灭 菌锅)	LMQ. C-80YF-01	新华	2 台	36000	72000
35	电热干燥箱(鼓风干燥箱)	DHG-9243BS	宁波扬辉	1 台	7500	7500
36	纯水/超纯 水一体化系统	Classic EU10	普洛斯	1 台	150000	150000
37	高通量程序降温细胞冻存 盒(程序降温盒)	EC30	easy inno	6 个	800	4800
38	防爆柜	HLY0400	华风科技	2 个	2250	4500
39	便携式转运罐	MYDS-20B-S	中科美菱	2 个	3000	6000
40	液氮生物容器(气相液氮 罐)	LBC-19K	ESCO	2 个	200000	400000
41	生物显微镜(倒置荧光显 微镜)	IX73	OLYMPUS	1 台	560000	560000
42	多模态成像分析系统	FV4000	OLYMPUS	1 台	3530000	3530000
43	全自动雪花制冰机(制冰 机)	IMS-50	雪科	1 台	7500	7500
44	冷冻切片机(冰冻切片机)	HM525 NX UV	Epredia	1 台	295000	295000
45	电穿孔仪	Gene PulserXcell Total System	伯乐	1 台	300000	300000
46	全视野荧光扫描分析仪 (实时智能活细胞成像分 析系统)	CellAnalyzer Pro	联华智造	1 台	490000	490000
47	小型台式全温振荡培养箱 (全温振荡培养箱/台式 全温震荡培养箱)	ZQTY-50	上海知楚	1 台	29500	29500
48	高低温循环水浴锅(水浴 箱)	HRB40	勒普拓	1 台	35000	35000
49	系统工作站	HP3215-fr	广西圣家堂	16 台	7000	112000
50	基础电源	PowerPacBasic	伯乐	4 台	10000	40000
51	小型垂直电泳槽(垂直电 泳槽)	Mini-PROTEAN Tetra Cell	伯乐	6 台	10000	60000
52	小型转印槽(转印模块)	Mini Trans-Blot Electrophoretic Transfer Cell	伯乐	6 台	6000	36000

序号	标的名称	规格型号	品牌	数量	分项单价 (元)	分项总价 (元)
53	多用途水平电泳槽	WIX-midiDNA	北京韦克斯	2 台	4000	8000
54	全自动活细胞荧光显微成像系统	APX100	OLYMPUS	1 台	1024000	1024000
55	超速离心机	SorvallWX100+	赛默飞	1 台	740000	740000
56	电穿孔仪 (电转染系统)	Gene PulserXcell Total System	伯乐	1 台	212000	212000
57	多模式动物活体成像系统 (双能 x 光成像模块)	AniView100 DXA	博鹭腾	1 台	1650000	1650000
58	玻片扫描影像系统 (病理 切片扫描仪)	SQS-40P	生强	1 台	350000	350000
59	高速成像增强型细胞分析 系统 (图像增强型流式细 胞仪)	Attune CytPix	赛默飞	1 台	2285000	2285000
60	生物显微镜 (倒置荧光显 微镜)	CKX53	OLYMPUS	1 台	480000	480000
61	多功能酶标仪	Varioskan ALF	赛默飞	1 台	320000	320000
62	多功能成像系统 (凝胶+化 学发光+荧光)	iBright FL1500	赛默飞	1 台	543000	543000
63	小型台式真空冷冻干燥机	HXLG-10-50D	上海沪析	1 台	25000	25000
64	高通量组织研磨器 (低温 冷冻研磨仪)	SCIENTZ-48L	宁波新芝	1 台	64800	64800
65	超声波细胞粉碎仪 (超声 破碎仪)	ZCPS-900	宁波知楚	1 台	24000	24000
66	电子天平 (万分位电子天 平)	LS220A SCS	普利赛斯	1 台	20000	20000
67	小型台式全温振荡培养箱 (恒温摇床/台式全温震 荡培养箱)	ZQTY-50	上海知楚	1 台	18000	18000
68	水浴锅	WB401	四亿	2 台	7000	14000
69	干浴器 (金属浴/一位干浴 器)	BlockS	四亿	1 台	9500	9500
70	包埋机	KD-BMIV、BLIV	金华科迪	1 台	30000	30000
71	轮转式切片机 (切片机)	MT1	达科为	1 台	10000	10000
72	组织脱水机 (自动脱水机)	KD-TS3D1	金华科迪	1 台	48000	48000
73	全波长超微量分光光度计 (紫外可见分光光度计 (全波长))	SPT-Nano	四亿	1 台	40000	40000
74	台式 PH 计 (PH 计)	SD50	梅特勒	1 台	20000	20000
75	全自动高通量细胞计数仪 (细胞计数仪)	Venus	牛顿光学	1 台	55000	55000
76	全能型半干蛋白转印仪	Trans-Blot Turbo	伯乐	1 台	35000	35000
77	蛋白电泳和转膜设备全套	Mini-PROTEAN® Tetra Cell	伯乐	1 套	62000	62000
78	多通道移液器 (12 道 300ul 可调量程移液器)	Transferpett e® pro-12	普兰德	2 把	10000	20000
79	多通道移液器 (12 道 100ul 可调量程移液器)	Transferpett e® pro-12	普兰德	2 把	10000	20000

序号	标的名称	规格型号	品牌	数量	分项单价 (元)	分项总价 (元)
80	单通道移液器 (2.5ul 单道可调移液器)	Transferpett e® pro	普兰德	2 把	2400	4800
81	单通道移液器 (10ul 单道可调移液器)	Transferpett e® pro	普兰德	2 把	2400	4800
82	手动移液器 (50ul 单道可调移液器)	Proline@Plus	赛多利斯莱珀思	2 把	2400	4800
83	单通道移液器 (100ul 单道可调移液器)	Transferpett e® pro	普兰德	2 把	2400	4800
84	单通道移液器 (200ul 单道可调移液器)	Transferpett e® pro	普兰德	2 把	2400	4800
85	单通道移液器 (1000ul 单道可调移液器)	Transferpett e® pro	普兰德	2 把	2400	4800
86	菌落计数及抑菌圈测量仪	Czone 8	杭州迅数	1 台	102000	102000
87	台式恒温摇床 (恒温振荡培养箱)	THZ-82-A	上海赫田	2 台	7000	14000
88	低温恒温培养箱 (恒温培养箱)	IL612C	雅马拓	2 台	31000	62000
89	自动部分收集器 (电子钟控自动部分收集器)	BSZ-100	上海嘉鹏	1 台	5500	5500
90	多功能微生物分析系统 (全自动生长曲线分析)	Micro-GCM	北京伯睿智合	1 台	770000	770000
91	厌氧培养箱	YQX-II	青岛精诚	1 台	55000	55000
92	超声治疗仪 (低强度聚焦超声辐照仪)	TY-M200C	泰猷	1 台	62000	62000
93	旋转蒸发仪	R-1030	巩义科瑞	1 台	21000	21000
94	手持测温热像仪	H26	海康微影	1 台	10000	10000
95	小动物超声成像仪 (小动物超声仪)	V5	三星	1 台	420000	420000
96	超声波治疗仪 (低强度脉冲超声仪)	Sonopuls 190	西贝	1 台	85000	85000
97	超声波细胞粉碎仪 (超声波细胞破碎仪)	ZCPS-600	宁波知楚	1 台	23840	23840
合计: 22951640 元 (贰仟贰佰玖拾伍万壹仟陆佰肆拾元整)						

附件 2

配置清单 (以下为每套/台设备所包含的配置)

一、设备名称: 生物安全柜注册证编号: /					备注
序号	配置名称	规格型号	数量	质保期	
1	主机	EAC2-4E1	1 台	三年	
2	紫外灯	30W	1 根	三年	
3	照明灯	30W	1 根	三年	
4	搁手架	/	1 个	三年	
5	支架	/	1 个	三年	
6	电源插座	/	1 个	三年	
二、设备名称: 二氧化碳培养箱 注册证编号: /					备注
序号	配置名称	规格型号	数量	质保期	
1	主机箱体	CLM-170B-8-TC	1 台	三年	
2	ULPA 高效过滤器	/	1 套	三年	
3	CO ₂ 进气在线过滤器	0.2 微米	1 件	三年	
4	不锈钢隔板	/	4 件	三年	
5	出厂检验报告	/	1 份	三年	
6	合格证	/	1 份	三年	
二、设备名称: 二氧化碳培养箱 注册证编号: /					备注
序号	配置名称	规格型号	数量	质保期	
1	主机	CLM-170T-8-TC	1 台	三年	
2	搁板	/	4 块	三年	
3	电源线	/	1 根	三年	
4	说明书	/	1 份	三年	
三、设备名称: 高速冷冻离心机 (离心机) 注册证编号: 苏苏械备 20252071					备注
序号	配置名称	规格型号	数量	质保期	
1	冷冻离心机主机	Sorvall ST1R Plus MD	1 台		
2	水平转头	4×250ml	1 个	三年	
3	吊篮	250ml	4 个	三年	
4	尖底管适配器 (4 个/套)	50ml	1 套	三年	
5	尖底管适配器 (4 个/套)	15ml	1 套	三年	
四、设备名称: 高速冷冻离心机 (离心机) 注册证编号: 苏苏械备 20252071					备注
序号	配置名称	规格型号	数量	质保期	
1	主机	Sorvall ST1R Plus MD	1 台	三年	
2	角转头	48×2ml	1 个	三年	
3	电源线	/	1 根	三年	
五、设备名称: 低速台式离心机 (低速离心机) 注册证编号: 湘长械备 20200371 号					备注
序号	配置名称	规格型号	数量	质保期	
1	主机	TM100K	1 台	三年	
2	电源线	/	1 根	三年	
3	内六角扳手	/	1 个	三年	

4	自动脱帽转子	104*2ml/7ml(采血管)	1套	三年	
5	使用说明书	/	1份	三年	
6	合格证	/	1份	三年	
7	售后服务保障卡	/	1份	三年	
8	装箱单	/	1份	三年	
六、设备名称: 生物显微镜(倒置显微镜) 注册证编号: 粤穗械备 20220492					备注
序号	配置名称	规格型号	数量	质保期	
1	主机	CKX53	1台	三年	
2	目镜	/	2个	三年	
3	LED光源	/	1个	三年	
4	4倍物镜	/	1个	三年	
5	10倍物镜	/	1个	三年	
6	20倍物镜	/	1个	三年	
7	聚光镜	/	1个	三年	
七、设备名称: 电动大容量助吸器(电动助吸器) 注册证编号: /					备注
序号	配置名称	规格型号	数量	质保期	
1	主机	EP101	1个	三年	
八、设备名称: 单通道移液器(单道移液器 100-1000ul) 注册证编号: /					
序号	配置名称	规格型号	数量	质保期	
1	微量移液器主机	Transferpette® S	1支	三年	
2	校准证书	/	1份	三年	
3	小挂架	/	1个	三年	
4	硅脂	/	1瓶	三年	
九、设备名称: 单通道移液器(单道移液器 20-200ul) 注册证编号: /					备注
序号	配置名称	规格型号	数量	质保期	
1	微量移液器主机	Transferpette® S	1支	三年	
2	校准证书	/	1份	三年	
3	小挂架	/	1个	三年	
4	硅脂	/	1瓶	三年	
十、设备名称: 单通道移液器(单道移液器 2-20ul) 注册证编号: /					备注
序号	配置名称	规格型号	数量	质保期	
1	微量移液器主机	Transferpette® S	1支	三年	
2	校准证书	/	1份	三年	
3	小挂架	/	1个	三年	
4	硅脂	/	1瓶	三年	
十一、设备名称: 单通道移液器(单道移液器 0.5-10ul) 注册证编号: /					备注
序号	配置名称	规格型号	数量	质保期	
1	微量移液器主机	Transferpette® S	1支	三年	
2	校准证书	/	1份	三年	
3	小挂架	/	1个	三年	
4	硅脂	/	1瓶	三年	

十二、设备名称: 血球计算盘 (血球细胞计数板)					注册证编号: /	备注
序号	配置名称	规格型号	数量	质保期		
1	计数板块	650030	1	三年		
十三、设备名称: 电热恒温水浴锅 (水浴锅)					注册证编号: /	
序号	配置名称	规格型号	数量	质保期		
1	主机	HH. S11-1	1 台	三年		
2	保修卡	/	1 份	三年		
3	合格证	/	1 份	三年		
4	使用说明书	/	1 份	三年		
十四、设备名称: 电子天平 (电子天平秤)					注册证编号: /	备注
序号	配置名称	规格型号	数量	质保期		
1	主机	ES225SM-DR (E)	1 台	三年		
2	防风罩	/	1 个	三年		
3	挡风圈	/	1 个	三年		
4	秤盘	/	1 个	三年		
5	电源适配器	/	1 个	三年		
6	合格证	/	1 份	三年		
7	使用说明书	/	1 份	三年		
十五、设备名称: 尘埃粒子计数器					注册证编号: /	备注
序号	配置名称	规格型号	数量	质保期		
1	主机	CLJ-B550	1 个	三年		
2	铝合金箱	/	1 个	三年		
3	操作手册	/	1 份	三年		
4	出厂校准报告	/	1 份	三年		
5	零计数过滤器	/	1 个	三年		
6	电源线	/	1 根	三年		
7	采样架	/	1 个	三年		
8	打印纸	/	1 份	三年		
9	保险丝	/	1 根	三年		
十六、设备名称: 浮游菌采样器 (空气浮游菌采样器)					注册证编号: /	备注
序号	配置名称	规格型号	数量	质保期		
1	主机	FKC- I	1 个	三年		
2	电源变换器	AC220V50Hz/DC8 . 4V 2A	1 个	三年		
3	培养皿	Φ90*15	2 套	三年		
4	说明书	/	1 本	三年		
5	合格证	/	1 份	三年		
十七、设备名称: 紫外辐照计					注册证编号: /	备注
序号	配置名称	规格型号	数量	质保期		
1	紫外辐照计	/	1 台	三年		
2	USB 数据线	/	1 条	三年		
3	紫外标尺挂钩	/	1 套	三年		
4	说明书	/	1 份	三年		
5	出厂校准报告	/	1 份	三年		
6	塑料工程箱	/	1 只	三年		
十八、设备名称: 二氧化碳测定仪					注册证编号: /	备注

序号	配置名称	规格型号	数量	质保期	
1	主机	G100	1 台	三年	
2	采用红外线原理分析二氧化碳 (CO2)	0-20%vol	1 套	三年	
3	采用内电化学传感器分析氧气 (O2)	0-100%vol	1 套	三年	
4	充电器	/	1 个	三年	
5	采样管(带过滤芯)	/	1 根	三年	
6	出厂报告	/	1 份	三年	

十九、设备名称: 医用冷藏箱 (医用冷藏冰箱)

注册证编号: 皖械注准 20172220100

备注

序号	配置名称	规格型号	数量	质保期	
1	主机	压缩机	/	1 台	三年
2		控制板	/	1 个	三年
3		显示屏	/	1 个	三年
4		蒸发器风机	/	2 个	三年
5		冷凝器风机	/	1 个	三年
6		制冷剂	/	R290: 90g	三年
7		冷凝器	/	1 个	三年
8		传感器	/	3 个	三年

二十、设备名称: 医用冷藏冷冻箱 (医用冷藏冷冻冰箱)

注册证编号: 械注准 20192220085

备注

序号	配置名称	规格型号	数量	质保期	
1	主机	压缩机	/	上室: 1 下室: 1	三年
2		控制板	/	1 个	三年
3		显示屏	/	1 个	三年
4		蒸发器风机	/	1 个	三年
5		制冷剂	/	R600a: 上室 20g R600a: 下室 60g	三年
6		冷凝器	/	2 个	三年
7		传感器	/	2 个	三年

二十一、设备名称: 超低温冷冻储存箱 (超低温冰箱)

注册证编号: 皖械注准 20172220099

备注

序号	配置名称	规格型号	数量	质保期	
1	主机	压缩机	/	1 台	三年
2		控制板	/	1 个	三年
3		显示屏	/	1 个	三年
4		蒸发器风机	/	1 个	三年
5		制冷剂	/	混合工质: 420g	三年
6		冷凝器	/	1 个	三年
7		传感器	/	3 个	三年

二十二、设备名称: 流式细胞仪 (增强型细胞分析系统)

备注

注册证编号: 苏械注准 20182220262					
序号	配置名称	规格型号	数量	质保期	
1	Main Unit 主机	/	1 台	三年	
2	电脑工作站和显示器组件	/	1 套	三年	
3	DxFLEX 自动进样器	/	1 个	三年	
4	DxFLEX 鞘液	/	1 瓶	三年	
5	Contrad 70 清洗液	/	1 瓶	三年	
6	清洗液	/	1 瓶	三年	
二十三、设备名称: 细胞内毒素测定仪 (动态试管检测仪) 注册证编号: /					备注
序号	配置名称	规格型号	数量	质保期	
1	主 机	BET-48G	1 个	三年	
2	通讯电缆	/	1 条	三年	
3	电 源 线	/	1 条	三年	
4	试管架	孔径 11mm	1 个	三年	
5	安 瓿 架	孔径 12mm	1 个	三年	
6	微量移液器	200-1000ul	1 个	三年	
7	微量移液器	20-200ul	1 个	三年	
8	无热原吸头	250ul	100 个	三年	
9	无热原吸头	1000ul	50 个	三年	
10	专用检测试管	专用检测 8mmx45mm	100 个	三年	
11	稀释用大试管	大试管	20 个	三年	
12	试管适配器	8mm	48 个	三年	
13	反应孔罩	/	1 个	三年	
14	加密狗	/	1 个	三年	
15	封 口 膜	/	1 个	三年	
16	合 格 证	/	1 张	三年	
17	保 修 单	/	1 张	三年	
18	使用说明书	/	1 张	三年	
19	电源插座	/	1 个	三年	
20	装箱单	/	1 份	三年	
二十四、设备名称: 混合仪 (旋涡混合仪/标准混合仪) 注册证编号: /					备注
序号	配置名称	规格型号	数量	质保期	
1	标准混匀仪	CubicB	1 台	三年	
2	电源适配器	/	1 个	三年	
3	使用说明书	/	1 份	三年	
二十五、设备名称: 微滴式数字 PCR 系统 (数字 PCR 系统) 注册证编号: /					备注
序号	配置名称	规格型号	数量	质保期	
1	主 机	QX700 E	1 个	三年	
二十六、设备名称: 梯度 PCR 仪 (PCR 基因扩增仪) 注册证编号: /					备注
序号	配置名称	规格型号	数量	质保期	
1	PCR 主机	T100	1 台	三年	
2	单管支持架	/	1 个	三年	
3	电源线	/	1 根	三年	
二十七、设备名称: 迷你离心机 (掌上离心机) 注册证编号: /					备注
序号	配置名称	规格型号	数量	质保期	

1	迷你离心机	ETmini	1 台	三年	
2	电源适配器	/	1 个	三年	
3	使用说明书	/	1 个	三年	
4	合格证	/	1 本	三年	
5	转子	1.5/2.0ml	1 个	三年	
6	双排管转子	0.2ml8PCR	1 个	三年	
二十八、设备名称: 小型垂直电泳槽 (电泳仪) 注册证编号: /					备注
序号	配置名称	规格型号	数量	质保期	
1	基础电源	/	1 台	三年	
2	电源线	/	1 根	三年	
3	电泳槽和盖	/	1 套	三年	
4	长玻板和短玻板	/	1 套	三年	
5	梳子	/	1 包	三年	
6	制胶架	/	2 个	三年	
7	制胶框	/	4 个	三年	
8	上样引导装置	/	1 包	三年	
9	制胶盒	/	2 个	三年	
10	纤维垫	/	4 个	三年	
11	预切滤片	/	1 盒	三年	
12	电极模块组合	/	1 套	三年	
13	冷却模块	/	1 个	三年	
14	缓冲液槽	/	1 套	三年	
二十九、设备名称: 智能图像工作站 (全自动多功能成像系统) 注册证编号: /					备注
序号	配置名称	规格型号	数量	质保期	
1	600 万像素制冷 CCD 相机	/	1 个	三年	
2	GV Plus 系列多功能暗箱	/	1 个	三年	
3	顶部落射白光灯	/	1 套	三年	
4	蓝光托盘	/	1 套	三年	
5	紫外托盘	/	1 套	三年	
6	白光托盘	/	1 套	三年	
7	黑色背景板	/	1 块	三年	
8	切胶防护板	/	1 块	三年	
9	透射白光板	/	1 块	三年	
10	五色 LED 荧光光源 (蓝 465nm, 绿 535nm, 红 605nm, 近红外 675nm, 近红外 745nm)	/	1 套	三年	
11	BioLight 多功能图像软件	/	1 套	三年	
三十、设备名称: 智能生化培养箱 (生化培养箱) 注册证编号: /					备注
序号	配置名称	规格型号	数量	质保期	
1	主机	SPX-160H	1 台	三年	
2	说明书	/	1 份	三年	
3	保修卡	/	1 份	三年	
4	合格证	/	1 份	三年	
三十一、设备名称: 智能霉菌培养箱 (霉菌培养箱) 注册证编号: /					备注
序号	配置名称	规格型号	数量	质保期	
1	主机	MJX-160HS	1 台	三年	

2	说明书	/	1 份	三年	
3	保修卡	/	1 份	三年	
4	合格证	/	1 份	三年	

三十二、设备名称: 小型台式全温振荡培养箱 (恒温培养摇床/小型全温震荡培养箱)
注册证编号: /

备注

序号	配置名称	规格型号	数量	质保期	
1	主机 ZQTY-30	摇板	240*240mm	1 块	三年
2		转轴	/	1 套	三年
3		LCD 液晶显示屏	/	1 个	三年
4		温控探头	/	1 个	三年
5		万能弹簧(固定 夹具可选)	/	1 个	三年
6	使用说明书	/	/	1 份	三年
7	合格证书	/	/	1 份	三年
8	保修单	/	/	1 份	三年
9	保险丝 8A	/	/	2 个	三年
10	3M 电源线	/	/	1 根	三年

三十三、设备名称: 电动吸引器 (负压吸引器)

注册证编号: 苏械注准 20152140771

备注

序号	配置名称	规格型号	数量	质保期	
1	主机	7A-23D	1 台	三年	
2	腹腔吸引管	/	1 支	三年	
3	熔丝管	F2AL250V, ϕ 5x20	1 根	三年	
4	吸引软导管	长度 2m, ϕ p7x 12	1 根	三年	
5	空气过滤器	/	2 只	三年	
6	电源线	/	1 根	三年	
7	脚踏开关	/	1 个	三年	
8	说明书	/	1 份	三年	
9	保修卡	/	1 份	三年	
10	合格证	/	1 份	三年	

三十四、设备名称: 立式灭菌器 (高压蒸汽灭菌锅)

注册证编号: 鲁械注准 20162110227

备注

序号	配置名称	规格型号	数量	质保期	
1	主机	LMQ.C	1 台	三年	
2	不锈钢提篮	/	2 个	三年	
3	合格证	/	1 份	三年	
4	说明书	/	1 份	三年	
5	压力容器质量证明书	/	1 份	三年	

三十五、设备名称: 电热干燥箱 (鼓风干燥箱)

注册证编号: /

备注

序号	配置名称	规格型号	数量	质保期	
1	主机	DHG-9243BS	1 台	三年	
2	控制器	/	1 套	三年	
3	液晶屏	/	1 台	三年	

4	温度传感器	/	1 根	三年	
5	层板	/	2 片	三年	
6	说明书	/	1 份	三年	
7	保修卡	/	1 份	三年	
8	合格证	/	1 份	三年	

三十六、设备名称: 纯水/超纯水一体化系统

注册证编号: /

备注

序号	配置名称	规格型号	数量	质保期	
1	主机	Classic EU10	1 台	三年	
2	取水手臂	/	1 个	三年	
3	预处理系统	/	1 套	三年	
4	漏水检测器	/	1 个	三年	
5	水箱	/	1 个	三年	
6	预保护柱	/	2 根	三年	
7	双级 RO 反渗透	/	1 个	三年	
8	EDI	/	1 个	三年	
9	精纯化柱	/	1 个	三年	
10	TOC 检测	/	1 个	三年	
11	智能控制系统	/	1 套	三年	
12	云端控制系统	/	1 套	三年	

三十七、设备名称: 高通量程序降温细胞冻存盒 (程序降温盒) 注册证编号: /

备注

序号	配置名称	规格型号	数量	质保期	
1	降温盒	EC30	1 个	三年	

三十八、设备名称: 防爆柜 注册证编号: /

备注

序号	配置名称	规格型号	数量	质保期	
1	主机	HLY0400	1 台	三年	
2	合格证	/	1 份	三年	

三十九、设备名称: 便携式转运罐 注册证编号: /

备注

序号	配置名称	规格型号	数量	质保期	
1	主机	MYDS-20B-S	1 台	三年	
2	说明书	/	1 份	三年	
3	合格证	/	1 份	三年	

四十、设备名称: 液氮生物容器 (气相液氮罐) 注册证编号: /

备注

序号	配置名称	规格型号	数量	质保期	
1	气相液氮罐主机	LBC-19K	1 台	三年	
2	监控系统	已安装在容器上	1 套	三年	
3	进液系统	已安装在容器上	1 套	三年	
4	液氮连接管	螺口型号: 美标 CGA295	1 根	三年	

四十一、设备名称: 生物显微镜 (倒置荧光显微镜)

注册证编号: 国械备 20210293 号

备注

序号	配置名称	规格型号	数量	质保期	
1	荧光倒置显微镜主机	IX73	1 台	三年	
2	照明立柱	/	1 套	三年	
3	长寿命 LED 透射光照明	/	1 套	三年	
4	荧光照明系统	/	1 套	三年	
5	4X、10X、20X、40X 高级荧光	/	1 套	三年	

	平场半复消色差相差物镜				
6	蓝、绿、紫外荧光滤块	/	1 套	三年	
7	目镜筒	/	1 个	三年	
8	10X/22mm 可调屈光度目镜	/	2 个	三年	
9	相差附件	/	1 套	三年	
10	高灵敏制冷型数码摄像头	/	1 个	三年	
11	数码摄像头接口	/	1 个	三年	
12	分析软件	/	1 套	三年	

四十二、设备名称: 多模态成像分析系统 注册证编号: /

备注

序号	配置名称	规格型号	数量	质保期	
1	全电动倒置荧光显微镜	FV4000	1 套	三年	
2	激光强度自动监控系统	/	1 套	三年	
3	激光光源系统	/	1 套	三年	
4	扫描单元组件	/	1 套	三年	
5	制冷型硅光电探测器	/	1 套	三年	
6	电动载物台	/	1 套	三年	
7	数据处理系统及软件	/	1 套	三年	
8	气压专用防震台	/	1 台	三年	
9	UPS 电源	/	1 套	三年	
10	激光器架	/	1 套	三年	

四十三、设备名称: 全自动雪花制冰机 (制冰机)

注册证编号: /

备注

序号	配置名称	规格型号	数量	质保期	
1	制冰机	IMS-50	1 台	三年	
2	进水管	/	1 根	三年	
3	排水管	/	1 根	三年	
4	冰勺	/	1 个	三年	
5	说明书	/	1 份	三年	
6	合格证	/	1 份	三年	
7	保修卡	/	1 份	三年	

四十四、设备名称: 冷冻切片机 (冰冻切片机)

注册证编号: 沪浦械备 20220095

备注

序号	配置名称	规格型号	数量	质保期	
1	HM525 NX UV 主机	/	1 台	三年	
2	冷锤	/	1 个	三年	
3	包埋剂	6 瓶/箱	1 箱	三年	
4	试用刀片 1 盒	/	1 个	三年	
5	刀架 1 个	/	1 个	三年	
6	玻片 1 盒	/	1 个	三年	

四十五、设备名称: 电穿孔仪 注册证编号: /

备注

序号	配置名称	规格型号	数量	质保期	
1	主机单元	Gene PulserXcell Total System	1 套	三年	
2	CE 模块	/	1 套	三年	
3	PC 模块	/	1 套	三年	
4	电击槽	/	1 个	三年	

5	电击杯	(5 个/包)	50 包	三年	
6	说明书	/	1 份	三年	
7	电源线	/	1 根	三年	

四十六、设备名称: 全视野荧光扫描分析仪 (实时智能活细胞成像分析系统)
注册证编号: /

备注

序号	配置名称	规格型号	数量	质保期	
1	主机	CellAnalyzer Pro	1 台	三年	
2	分析软件工作站	/	1 套	三年	
3	主机适配器	/	1 个	三年	
4	电源线	/	1 根	三年	
5	数据连接线	/	1 根	三年	

四十七、设备名称: 小型台式全温振荡培养箱 (全温振荡培养箱/台式全温震荡培养箱)
注册证编号: /

备注

序号	配置名称	分项名称	规格型号型号	数量	质保期	
1	主机 ZQTY-50	摇板	420*348mm	1 块	三年	
2		伺服电机	/	1 个	三年	
3		进口压缩机	/	1 个	三年	
4		转轴	/	1 套	三年	
5		LCD 液晶显示屏	/	1 个	三年	
6		紫外灯	/	1 个	三年	
7		照明灯	/	1 个	三年	
8		温控探头	/	1 个	三年	
9		万能弹簧(固定夹具可选)	/	1 个	三年	
10	使用说明 书	/	/	1 份	三年	
11	合格证书	/	/	1 份	三年	
12	保修单	/	/	1 份	三年	
13	保险丝	/	8A	2 个	三年	
14	保险丝	/	15A	2 个	三年	
15	3M 电源线	/	/	1 个	三年	

四十八、设备名称: 高低温循环水浴锅 (水浴箱)

注册证编号: /

备注

序号	配置名称	规格型号	数量	质保期	
1	主机	HRB40	1 个	三年	
2	平盖	/	1 个	三年	
3	硅胶保温管	(规格型号 8*12mm, 1.8 米长 /根)	2 根	三年	
4	生料带	/	1 卷	三年	
5	说明书	/	1 份	三年	
6	合格证	/	1 份	三年	
7	售后服务卡	/	1 份	三年	

四十九、设备名称: 系统工作站 注册证编号: /

备注

序号	配置名称	规格型号	数量	质保期	
1	Ssd 储存器	HP3215-fr	1 个	三年	

2	电源线	/	1 根	三年	
五十、设备名称: 基础电源 注册证编号: /					备注
序号	配置名称	规格型号	数量	质保期	
1	基础电源	PowerPacBasic	1 个	三年	
2	电源线	/	1 根	三年	
五十一、设备名称: 小型垂直电泳槽 (垂直电泳槽) 注册证编号: /					备注
序号	配置名称	规格型号	数量	质保期	
1	电泳槽和盖	/	1 套	三年	
2	长玻板和短玻板	/	1 套	三年	
3	梳子	/	1 个	三年	
4	制胶架	/	1 个	三年	
5	制胶框	/	1 个	三年	
6	上样引导装置	/	1 个	三年	
五十二、设备名称: 小型转印槽 (转印模块) 注册证编号: /					备注
序号	配置名称	规格型号	数量	质保期	
1	制胶盒	/	2 个	三年	
2	纤维垫	/	4 个	三年	
3	预切滤片	/	1 盒	三年	
4	电极模块组合	/	1 个	三年	
5	冷却模块	/	1 个	三年	
6	使用说明书	/	1 份	三年	
五十三、设备名称: 多用途水平电泳槽 注册证编号: /					备注
序号	配置名称	规格型号	数量	质保期	
1	电极架	阳极红色	1 个	三年	
2	电极架	阴极黑色	1 个	三年	
3	梳子	0.75mm, 7+7 齿 /14 齿	1 把	三年	
4	梳子	0.75mm, 9+9 齿 /19 齿	1 把	三年	
5	梳子	1.0mm, 12+12 齿 /27 齿	4 把	三年	
6	梳子	1.5mm, 7+7 齿/14 齿	1 把	三年	
7	梳子	1.5mm, 9+9 齿/19 齿	1 把	三年	
8	梳子	2.0mm, 2+3 齿 /3+3 齿	1 把	三年	
9	托盘	130x130mm	1 个	三年	
10	托盘	130 x65mm	1 个	三年	
11	托盘	65x130mm	1 个	三年	
12	托盘	65 x 65mm	2 个	三年	
13	制胶器	制胶面积: 130x130mm, 130x65mm, 65x130mm, 65x65mm	1 个	三年	

14	上壳 (带线)				
15	下壳	带电源线的上盖	1 个	三年	
16	合格证	电泳仪底槽, 不含正负电极	1 个	三年	
17	电子版说明书	/	1 个	三年	
18	装箱单	/	1 份	三年	
五十四、设备名称: 全自动活细胞荧光显微成像系统			1 份	三年	

序号	配置名称	规格型号	数量	质保期	备注
1	主机	APX100, 含 GFP、RFP 和 DAPI 检测模块	1 台	三年	
2	自动 X/Y 载物台	/	1 台	三年	
3	高灵敏度单色 CMOS 相机传感器和高灵敏度彩色 CMS 相机传感器	/	1 套	三年	
4	外部 PC 图像工作站	/	1 台	三年	
5	内置微处理器和采集分析软件	/	1 套	三年	
6	物镜 (含 4×、10×、20×和 40×)	/	1 套	三年	

五十五、设备名称: 超速离心机 注册证编号: /

序号	配置名称	规格型号	数量	质保期	备注
1	超速离心机主机	Sorvall WX100+	1 台	三年	
2	角转子	最大容量 8 支, 离心管容量 100ml, 最高转速 37000rpm, 最大离心力 182460xg	1 个	三年	
3	配套角转子的 PC 材质离心管	/	48 支	三年	
4	水平转子	最大容量 6 支, 离心管容量 38.5ml	1 个	三年	
5	配套水平转子的离心管	/	100 支	三年	

五十六、设备名称: 电穿孔仪 (电转染系统) 注册证编号: /

序号	配置名称	规格型号	数量	质保期	备注
1	主机单元	Gene PulserXcell Total System	1 台	三年	
2	CE 模块	/	1 套	三年	
3	PC 模块	/	1 套	三年	
4	电击槽	/	1 个	三年	
5	电源线	/	1 根	三年	

五十七、设备名称: 多模式动物活体成像系统 (双能 x 光成像模块) 注册证编号: /

序号	配置名称	分项名称	规格型号型号	数量	质保期	备注
1	主机	背部薄化、背部感应型冷 CCD (含 F0.95 广角	/	1 个	三年	

	镜头)				
2	多功能成像暗箱	/	1 个	三年	
3	高强度可见光成像 LED 激发光源系统	/	1 套	三年	
4	可见光成像窄带宽激发光滤光片	/	20 个	三年	
5	可见光成像窄带宽发射光滤光片	/	18 个	三年	
6	自动升降温控载物台	/	1 个	三年	
7	双能 X 光成像模块	/	1 套	三年	
8	多功能气体麻醉系统	/	1 套	三年	
9	高性能台式电脑	/	1 台	三年	
10	专业拍照和分析软件	/	1 套	三年	

五十八、设备名称: 玻片扫描影像系统 (病理切片扫描仪)

注册证编号: 粤械注准 20202220365

备注

序号	配置名称	规格型号	数量	质保期	
1	玻片扫描影像系统	SQS-40P	1 套	三年	
2	电脑主机	/	1 台	三年	
3	电脑显示器	/	1 台	三年	
4	玻片扫描影像系统软件	/	1 套	三年	
5	数字病理阅片软件	/	1 套	三年	
6	片仓	/	2 个	三年	

五十九、设备名称: 高速成像增强型细胞分析系统 (图像增强型流式细胞仪)

注册证编号: /

备注

序号	配置名称	规格型号	数量	质保期	
1	成像型流式细胞仪主机	Attune CytPix	1 台	三年	
2	鞘液桶	1.8L	1 个	三年	
3	废液桶	1.8L	1 个	三年	
4	清洗液桶	175mL	1 个	三年	
5	关机液桶	175mL	1 个	三年	
6	开机试剂	/	1 套	三年	
7	分析软件 (含 AI 智能成像采集分析软件)	/	1 套	三年	
8	电脑工作站	/	1 套	三年	

六十、设备名称: 生物显微镜 (倒置荧光显微镜)

注册证编号: 粤穗械备 20220492

备注

序号	配置名称	规格型号	数量	质保期	
1	倒置显微镜主机	CKX53	1 台	三年	

2	LED 透射光照明				
3	荧光照明系统	/	1 套	三年	
4	物镜 4X、10X、20X、40X	/	1 套	三年	
5	蓝、绿、紫外荧光滤块	/	1 套	三年	
6	目镜筒	/	1 套	三年	
7	目镜	/	1 个	三年	
8	相差附件	/	2 个	三年	
9	高灵敏制冷型数码摄像头	/	1 套	三年	
10	数码摄像头接口	/	1 个	三年	
11	分析软件	/	1 个	三年	
12	电脑	/	1 套	三年	

六十一、设备名称: 多功能酶标仪 注册证编号: /

序号	配置名称	规格型号	数量	质保期	备注
1	多功能酶标仪主机	Varioskan ALF	1 台	三年	
2	光吸收模块	/	1 套	三年	
3	荧光检测模块	/	1 套	三年	
4	化学发光检测模块	/	1 套	三年	
5	采集分析软件	/	1 套	三年	
6	检测报告	/	1 份	三年	
7	产品说明书	/	1 份	三年	

六十二、设备名称: 多功能成像系统(凝胶+化学发光+荧光) 注册证编号: /

序号	配置名称	规格型号	数量	质保期	备注
1	成像系统主机	iBright FL1500	1 套	三年	
2	电源线	/	1 个	三年	
3	可旋转样品台	/	1 个	三年	
4	白色样品台	/	1 个	三年	
5	切胶防护眼镜	/	1 副	三年	

六十三、设备名称: 小型台式真空冷冻干燥机 注册证编号: /

序号	配置名称	规格型号	数量	质保期	备注
1	主机	HXLG-10-50D	1 台	三年	
2	真空泵	/	1 台	三年	
3	电源线	/	1 根	三年	
4	真空管卡箍及垫圈	/	2 个	三年	
5	T 型垫圈	/	1 个	三年	
6	物料盘	(Φ200mm)	4 个	三年	
7	干燥架	(标准型)	1 个	三年	
8	多歧管有机玻璃罩	/	1 个	三年	
9	预冻架	/	1 个	三年	
10	茄型瓶	250ml	8 个	三年	
11	真空脂	/	1 个	三年	
12	橡胶阀	/	1 份	三年	
13	使用说明书	/	1 份	三年	
14	产品保修卡	/	1 份	三年	

六十四、设备名称: 高通量组织研磨器(低温冷冻研磨仪) 注册证编号: /

序号	配置名称	规格型号	数量	质保期	备注
1	主机	SCIENTZ-48L	1 台	三年	

2	铝合金适配器				
3	铝合金适配器	2ML 48 孔			
4	适配器盖板	5ML 12 孔	1 个	三年	
		/	1 个	三年	
5	钢珠		2 个	三年	
		直径: $\Phi 3$ (材料 316L)	1000 颗	三年	
6	钢珠				
		直径: $\Phi 6$ (材料: 304)	1000 颗	三年	
7	保险丝				
8	电源线	8A	2 个	三年	
9	使用说明书	/	1 根	三年	
10	保修卡	/	1 本	三年	
11	合格证	/	1 份	三年	
		/	1 份	三年	

合同编号: LGY-YS-2025-218

六十五、设备名称: 超声波细胞粉碎仪(超声破碎仪)

序号	配置名称	规格型号	数量	质保期	注册证编号: /	备注
1	一体式超声破碎机主机	ZCPS-900	1 台	三年		
2	密闭换能器及钛合金探头	/	1 套	三年		
3	铝合金升降台	/	1 个	三年		
4	变幅杆	$\Phi 6$	1 根	三年		
5	隔音箱	/	1 台	三年		

六十六、设备名称: 电子天平 (万分位电子天平)

序号	配置名称	规格型号	数量	质保期	注册证编号: /	备注
1	主机	LS220A SCS	1 台	三年		
2	防风罩	/	1 个	三年		
3	挡风圈	/	1 个	三年		
4	秤盘	/	1 个	三年		
5	电源适配器	/	1 个	三年		
6	检测报告	/	1 份	三年		
7	使用说明书	/	1 份	三年		

六十七、设备名称: 小型台式全温振荡培养箱 (恒温摇床/台式全温震荡培养箱)

注册证编号: /

序号	配置名称	分项名称	规格型号型号	数量	质保期	备注
1	主机	摇板	420*348mm	1 块	三年	
2		伺服电机	/	1 个	三年	
3		进口压缩机	/	1 个	三年	
4		转轴	/	1 套	三年	
5		LCD 液晶显示屏	/	1 个	三年	
6		紫外灯	/	1 个	三年	
7		照明灯	/	1 个	三年	
8		温控探头	/	1 个	三年	
9		万能弹簧 (固定夹具可选)	/	1 个	三年	
10	使用说明书	/		1 份	三年	
11	合格证书	/		1 份	三年	
12	保修单	/		1 份	三年	
13	保险丝	8A		2 个	三年	
14	保险丝	15A		2 个	三年	

15	3M 电源线				合同编号: LGY-YS-2025-218
六十八、设备名称: 水浴锅					
序号	配置名称	规格型号	数量	质保期	备注
1	水浴锅	24L	1 台	三年	
2	电源线	/	1 条	三年	
3	托盘	/	1 个	三年	
4	透明盖	/	2 个	三年	
5	USB 数据线	/	1 条	三年	
6	使用说明书	/	1 份	三年	
六十九、设备名称: 干浴器 (金属浴/一位干浴器)					
序号	配置名称	规格型号	数量	质保期	备注
1	一位干浴器主机	BlockS	1 台	三年	
2	PT1000 温度传感器	/	1 个	三年	
3	电源适配器	/	1 条	三年	
4	适配器	20*1.5ml、 30*0.5ml、 20*2.0ml	各 1 个	三年	
5	微型离心管	6/10/5*0.5/1.5 /2ml	一组	三年	
6	说明书	/	1 份	三年	
七十、设备名称: 包埋机					
注册证编号: 浙金械备 20150004 号					
序号	配置名称	规格型号	数量	质保期	备注
1	BMIV 包埋机	/	1 台	三年	
2	BLIV 冷冻台	/	1 台	三年	
3	电源线	/	2 根	三年	
4	脚踏开关	/	1 个	三年	
5	保险丝	10A	4 只	三年	
6	保险丝	6A	2 只	三年	
7	保险丝	3A	4 只	三年	
8	产品合格证	/	1 份	三年	
9	产品保修卡	/	1 份	三年	
10	使用说明书	/	1 份	三年	
11	产品装箱单	/	1 份	三年	
七十一、设备名称: 轮转式切片机 (切片机)					
注册证编号: 粤深械备 20220150					
号	配置名称	规格型号	数量	质保期	备注
	轮转式切片机 MT1 主机	MT1	1 台	三年	
	废蜡盘	/	1 个	三年	
	MT1 刀架组件	/	1 套	三年	
	国际电源线	/	1 根	三年	
	毛刷	/	1 个	三年	
七十二、设备名称: 组织脱水机 (自动脱水机)					
注册证编号: 浙金械备 20150006 号					
	配置名称	规格型号	数量	质保期	备注
	脱水机	KD-TS3D1	1 台	三年	
	脱水筐	/	1 个	三年	

3	电源线	合同编号: LGY-YS-2025-218			
4	排风管	/	1 根	三年	
5	产品合格证	/	1 套	三年	
6	产品保修卡	/	1 份	三年	
7	使用说明书	/	1 份	三年	
8	产品装箱单	/	1 份	三年	
七十三、设备名称: 全波长超微量分光光度计 (紫外可见分光光度计 (全波长))					
注册证编号: /					
序号	配置名称	规格型号	数量	质保期	备注
1	主机	SPT-Nano	1 台	三年	
2	电源适配器	/	1 个	三年	
3	使用说明书	/	1 份	三年	
4	热敏打印纸	/	1 份	三年	
5	荧光检测支架 (仅 SPT-NanoF)	/	1 个	三年	
七十四、设备名称: 台式 PH 计 (PH 计)					
注册证编号: /					
序号	配置名称	规格型号	数量	质保期	备注
1	主机	SD50	1 台	三年	
2	电极支架	/	1 个	三年	
3	缓冲液	4.01	1 瓶	三年	
4	缓冲液	7.00	1 瓶	三年	
5	缓冲液	9.21	1 瓶	三年	
6	保护罩	/	1 个	三年	
七十五、设备名称: 全自动高通量细胞计数仪 (细胞计数仪)					
注册证编号: /					
序号	配置名称	规格型号	数量	质保期	备注
1	主机	Venus	1 台	三年	
2	电源适配器	/	1 个	三年	
3	快速操作指南	/	1 份	三年	
4	保修卡	/	1 份	三年	
5	GPC200 细胞计数板	/	1 盒	三年	
6	0.2%台盼蓝染色液	/	1 瓶	三年	
七十六、设备名称: 全能型半干蛋白转印仪					
注册证编号: /					
序号	配置名称	规格型号	数量	质保期	备注
1	仪器主机 (内含电源)	Trans-Blot Turbo	1 台	三年	
2	转印盒	/	2 个	三年	
3	滚筒	/	1 个	三年	
4	电源线	/	1 条	三年	
5	说明书	/	1 份	三年	
七十七、设备名称: 蛋白电泳和转膜设备全套					
注册证编号: /					
序号	配置名称	分项名称	规格型号	数量	质保期
1	基础电源	基础电源	/	1 个	三年
2		电源线	/	1 条	三年
3	垂直电泳槽	电泳槽和盖	/	1 套	三年
4		长玻板和短玻板	/	1 套	三年
5		梳子	/	1 个	三年
6		制胶架	/	1 个	三年

7	转印模块	制胶框	/	1 个	三年	
8		上样引导装置	/	1 个	三年	
9		制胶盒	/	2 个	三年	
10		纤维垫	/	4 个	三年	
11		预切滤片	/	1 盒	三年	
12		电极模块组合	/	1 套	三年	
13		Bio-ice 冷却模块	/	1 套	三年	
14		使用说明书	/	1 份	三年	

七十八、设备名称: 多通道移液器 (12 道 300ul 可调量程移液器)
编号: /

注册证

备注

序号	配置名称	规格型号	数量	质保期	
1	主机	Transferpette® pro-12	1 支	三年	
2	校准证书	/	1 份	三年	
3	吸头盒	/	1 个	三年	
4	小挂架	/	1 个	三年	
5	安装工具	/	1 个	三年	
6	加样槽	/	1 个	三年	
7	硅脂	/	1 瓶	三年	
8	吸头锥密封圈	/	1 套	三年	

七十九、设备名称: 多通道移液器 (12 道 100ul 可调量程移液器)
编号: /

注册证

备注

序号	配置名称	规格型号	数量	质保期	
1	主机	Transferpette® pro-12	1 支	三年	
2	校准证书	/	1 份	三年	
3	吸头盒	/	1 个	三年	
4	小挂架	/	1 个	三年	
5	安装工具	/	1 个	三年	
6	加样槽	/	1 个	三年	
7	硅脂	/	1 瓶	三年	
8	吸头锥密封圈	/	1 套	三年	

八十、设备名称: 单通道移液器 (2.5ul 单道可调移液器)

注册证编号: /

备注

序号	配置名称	规格型号	数量	质保期	
1	微量移液器主机	Transferpette® pro	1 支	三年	
2	校准证书	/	1 份	三年	
3	小挂架	/	1 个	三年	
4	硅脂	/	1 瓶	三年	

八十一、设备名称: 单通道移液器 (10ul 单道可调移液器)

注册证编号: /

备注

序号	配置名称	规格型号	数量	质保期	
1	微量移液器主机	Transferpette® pro	1 支	三年	
2	校准证书	/	1 份	三年	
3	小挂架	/	1 个	三年	

4	硅脂				合同编号: LGY-YS-2025-218
八十二、设备名称: 手动移液器 (50ul 单道可调移液器) 注册证编号: /					
1 瓶	三年				
序号	配置名称	规格型号	数量	质保期	备注
1	微量移液器主机	Proline@Plus	1 支	三年	
2	校准证书	/	1 份	三年	
3	小挂架	/	1 个	三年	
4	硅脂	/	1 瓶	三年	
八十三、设备名称: 单通道移液器 (100ul 单道可调移液器) 注册证编号: /					
序号	配置名称	规格型号	数量	质保期	备注
1	微量移液器主机	Transferpette® pro	1 支	三年	
2	校准证书	/	1 份	三年	
3	小挂架	/	1 个	三年	
4	硅脂	/	1 瓶	三年	
八十四、设备名称: 单通道移液器 (200ul 单道可调移液器) 注册证编号: /					
序号	配置名称	规格型号	数量	质保期	备注
1	微量移液器主机	Transferpette® pro	1 支	三年	
2	校准证书	/	1 份	三年	
3	小挂架	/	1 个	三年	
4	硅脂	/	1 瓶	三年	
八十五、设备名称: 单通道移液器 (1000ul 单道可调移液器) 注册证编号: /					
序号	配置名称	规格型号	数量	质保期	备注
1	微量移液器主机	Transferpette® pro	1 支	三年	
2	校准证书	/	1 份	三年	
3	小挂架	/	1 个	三年	
4	硅脂	/	1 瓶	三年	
八十六、设备名称: 菌落计数及抑菌圈测量仪 注册证编号: /					
序号	配置名称	规格型号	数量	质保期	备注
1	抑菌圈测量及菌落计数仪主机	Czone 8	1 台	三年	
2	菌落分析软件、自动抑菌圈测量软件、抗生素效价测定软件、舒巴坦敏感 β -内酰胺酶检验软件	/	1 套	三年	
3	品牌商务台式电脑	双核 CPU、4G 内存、1T 硬盘、21.5 寸高清屏、Windows 7 系统以上	1 套	三年	
八十七、设备名称: 台式恒温摇床 (恒温振荡培养箱) 注册证编号: /					
序号	配置名称	规格型号	数量	质保期	备注
1	主机	THZ-82-A	1 台	三年	
2	说明书	/	1 份	三年	
3	保修卡	/			

序号	配置名称	规格型号	数量	质保期	备注
1	低温恒温培养箱	IL612C	1 台	三年	
2	棚板	不锈钢冲压网板	3 件	三年	
3	棚受	/	6 件	三年	
4	门用钥匙	/	2 个	三年	
5	使用说明书	/	1 份	三年	
6	保证书	/	1 份	三年	

八十九、设备名称：自动部分收集器（电子钟控自动部分收集器）
注册证编号：/

序号	配置名称	规格型号	数量	质保期	备注
1	主机	BSZ-100	1 台	三年	
2	试管架	/	1 个	三年	
3	玻璃试管	/	100 根	三年	
4	金属杆	/	1 根	三年	
5	电子阀	/	1 个	三年	
6	说明书	/	1 本	三年	

九十、设备名称：多功能微生物分析系统（全自动生长曲线分析）
注册证编号：/

序号	配置名称	规格型号	数量	质保期	备注
1	主机（光吸收）	Micro-GCM	1 台	三年	
2	软件	/	1 套	三年	
3	空气控制模块	/	1 台	三年	
4	电脑	/	1 台	三年	

九十一、设备名称：厌氧培养箱 注册证编号：/

序号	配置名称	规格型号	数量	质保期	备注
1	主机	YQX-II	1 台	三年	
2	电源线	/	1 根	三年	
3	除氧催化器	/	1 台	三年	
4	乳胶手套	/	2 个	三年	
5	喉扣	/	6 只	三年	
6	用户手册	/	1 份	三年	
7	合格证	/	1 份	三年	
8	装箱单	/	1 份	三年	

九十二、设备名称：超声治疗仪（低强度聚焦超声辐照仪） 注册证编号：/

序号	配置名称	规格型号	数量	质保期	备注
1	超声治疗仪主机	TY-M200C	1 台	三年	
2	2 号治疗头	/	1 套	三年	
3	电源线	/	1 套	三年	
4	超声耦合剂	250ML/瓶	1 瓶	三年	
5	5x20 保险管 F1AL250V	/	2 个	三年	
6	产品说明书	/	1 份	三年	
7	用户配置清单	/	1 份	三年	
8	产品合格证	/	1 份	三年	
9	标准服务承诺书	/	1 份	三年	
10	保修卡	/	1 份	三年	

12	安装验收报告	/	3份	三年	合同编号: LGY-YS-2025-218
九十三、设备名称: 旋转蒸发仪 注册证编号: /					
序号	配置名称	规格型号	数量	质保期	备注
1	主机	R-1030	1台	三年	
2	旋转瓶	/	1个	三年	
3	收集瓶	/	1个	三年	
4	导气瓶	/	1个	三年	
5	内六角扳手	/	1只	三年	
6	四氟加料管	/	1根	三年	
7	真空管 2m	/	1根	三年	
8	说明书	/	1份	三年	
九十四、设备名称: 手持测温热像仪 注册证编号: /					
序号	配置名称	规格型号	数量	质保期	备注
1	主机	HM-TPH26-7QF/W	1台	三年	
2	电池	/	2个	三年	
3	挂绳	/	1个	三年	
4	充电器	/	1个	三年	
5	SD卡	/	1个	三年	
6	USB线	/	1个	三年	
7	座充适配器	/	1个	三年	
8	高强度抗冲击便携箱	/	1个	三年	
九十五、设备名称: 小动物超声成像仪 (小动物超声仪) 注册证编号: /					
序号	配置名称	规格型号	数量	质保期	备注
1	彩色多普勒高分辨率超声仪主机	V5	1台	三年	
2	常规成像模块	/	1套	三年	
3	心脏成像模块	/	1套	三年	
4	生殖成像模块	/	1套	三年	
5	Dicom (包括超声波 Q/R) 模块	/	1套	三年	
6	工具包 (中文)	/	1套	三年	
7	电源线	/	1套	三年	
8	心电线	/	1套	三年	
9	超高频线阵探头	/	1把	三年	
九十六、设备名称: 超声波治疗仪 (低强度脉冲超声仪) 注册证编号: 苏械注准 20222091485					
序号	配置名称	规格型号	数量	质保期	备注
1	超声波治疗仪 (主机)	Sonopuls 190	1台	三年	
2	电源线	/	1根	三年	
3	十字螺丝刀	/	1把	三年	
4	说明书	/	1本	三年	
5	简易操作卡	/	1张	三年	
6	保修卡	/	1份	三年	
7	合格证	/	1份	三年	
8	配置清单	/	1份	三年	
9	三证 (营业执照、注册证、生产许可证)	/	1份	三年	

10	吸附超声治疗头(5cm ²) (含凝胶片固定环3个, 治疗头支架及固定螺栓1套, 塑料固定扣四个, 凝胶片240片)	/	1箱	三年	
九十七、设备名称: 超声波细胞粉碎仪 (超声波细胞破碎仪) 注册证编号: /					
序号	配置名称	规格型号	数量	质保期	备注
1	一体式超声破碎机主机	ZCPS-600	1台	三年	
2	密闭换能器及钛合金探头	/	1套	三年	
3	铝合金升降台	/	1个	三年	
4	变幅杆	Φ6	1根	三年	
5	隔音箱	/	1台	三年	

备注: 设备生产日期为合同签订之日前6个月内 (或合同签订日期后) 生产的最新日期!

附件 3:

柳州市工人医院信息工程部要求的数据

因甲方信息化建设需要,需对新购进医用仪器设备的通讯接口有一定要求,主要涉及以下类型的仪器:

1. 检验类仪器,如检验使用的仪器等。
2. 检查类仪器,如超声设备、放射设备、心电图设备等。
3. 监护仪、麻醉机、呼吸机、血透机等。

对以上类型的新进仪器接口要求:

1. 必须要求有仪器数据输出接口,且不需要单独再进行购买仪器接口模块,提供仪器接口与计算机通讯的数据线。
2. 提供以下方式的接口:RJ45(网口)、RS232(串口)、管理软件接口、中间件、DLL、OCX、SDK 开发包、视频输出接口等。
3. 提供的接口信息必须符合 HL7 国际通用标准。
4. 免费提供接口的详细技术文档,如通信协议类型、通讯格式、加密解密方式、公式、字段含义、参数含义、函数说明、调用方式等详细接口开发技术文档。
5. 使用 DLL、OCX、SDK 开发包的需免费提供详细的接口开发技术文档。
6. 直接与管理程序做接口的,需提供详细的接口开发技术文档,如字段含义、参数含义、函数说明,调用方式等详细信息。
7. 以上均需永久提供免费的技术支持。
8. 甲方利用乙方提供的接口技术文档开发出的相应软件不涉及技术泄密和侵权。