

政府采购合同

合同名称：医疗设备维保服务
(分标 1：全身 X 射线计算机断层扫描系统维保服务(全保))

项目编号：WZZC2025-G3-990354-JDZB

签订合同地点：梧州市

签订合同时间：2026 年 2 月 13 日

法权利，也未对服务交付成果（产品）设置任何权利负担。若因违反前款约定引起的第三方权利纠纷的由乙方负责解决，包括甲方使用服务交付成果（产品）所需的授权费以及解决争议发生的一切费用均由乙方承担。如果不能取得使用许可需要另行购买服务交付成果（产品）的，所需费用由乙方承担，并赔偿甲方因此受到的损失。

2、乙方应按公告规定、采购文件或投标/响应文件承诺的时间向甲方提供服务交付成果（产品）的有关技术资料。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方的保密义务持续有效，不因为本合同履行终止、解除或者无效而解除。

4、乙方保证服务交付成果（产品）的所有权完全属于乙方，且无任何抵押、质押、查封、留置等产权瑕疵。

5、乙方应对履行本协议过程中所接触到的甲方的保密信息，包括但不限于患者个人信息（参照《信息安全技术健康医疗数据安全指南》（GB/T 39725-2020）的相关规定范围）、医院内部资料及相关技术资料等负有保密义务，不得进行任何形式的使用或者透露给任何第三方或作为其他商业用途。未经甲方书面同意，乙方不得以任何形式向第三方透露，否则应承担由此给甲方造成的所有损失。乙方对于保密信息的义务应延续至该等信息因合法的原因而成为公开信息。

6、乙方以及乙方安排完成合同项目的工作人员，应当确保具备与本合同约定所要求相符合的资质与条件，具备相应的工作经验，乙方须完全符合并遵守本合同所涉及的相关法律、法规、规范性文件的规定，确保可以依法开展合同约定的事项。

7、甲乙双方确认，乙方为本合同项目投入的维保相关人员，均与甲方之间不存在任何劳动、劳务等法律关系，相应的劳动保障等法律义务，均由乙方负责承担。

8. 在维保过程中乙方应保证采取必要安全措施，保障人身安全和设备安全；因乙方操作不当造成设备二次损害或人身伤害，由乙方承担全部责任。

第四条 服务期限和验收

1、服务期限：自签订合同之日起贰年，即自____年____月____日至____年____月____日；服务地点：梧州市人民医院。

2、乙方应按投标文件的承诺向甲方提供相应的服务及伴随的货物（含设备零配件及系统升级、维保等），并提供所服务及伴随的货物（含设备零配件及系统升级、维保等）的相关技术资料。

3、乙方提供不符合投标文件和本合同规定的服务成果，甲方人有权拒绝接受。

4、乙方完成服务后应及时书面通知甲方进行验收，甲方应在收到通知后七个工作日内进行验收，逾期不开始验收的，乙方人可视同验收合格。验收合格后由双方签署验收单甲乙双方各执一份。

5、甲乙双方应按照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》、双方

合同、投标文件验收。

6、甲方在初步验收或者最终验收过程中如发现乙方提供的服务成果不满足投标文件及本合同规定的，可暂缓向乙方付款，直到乙方及时完善并提交相应的服务成果且经甲方验收合格后，方可办理付款。

7、甲方验收时以书面形式提出异议的，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内及时予以解决，否则甲方有权拒绝在采购项目合同验收书上签字。

8、每次维修、保养或检测服务结束后乙方应当主动向甲方提供服务工单或书面检测报告，服务工单及书面检测报告需经甲方相关科室工作人员和设备科工程师共同签字确认。

9、甲方每季度对乙方进行考核，考核内容详见设备维保考核表。

第五条 售后服务及培训

1、乙方应按照国家有关法律法规和本合同所附的《售后服务承诺》要求为甲方提供相应的售后服务。

2、甲方应提供必要测试条件（如场地、电源、水源等）。

3、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：甲方另行指定。

第六条 付款方式

甲乙双方同意本合同金额的支付按以下约定执行：

先服务后支付费用方式，每一季度结算及付款一次，每季度应支付总合同款的12.5%。即从本合同执行日起，每季度根据乙方为甲方提供的服务内容，进行季度考核，考核结果与维保款挂钩，如考核结果产生扣罚的，则在当季约定支付款项中扣减，当季实际应支付合同款按扣减后支付；每年年度期满对全年开机率指标进行考核，如考核结果产生扣罚的，则在第四季度约定支付款项中扣减，第四季度应付款项按扣减后支付。由乙方开具上季度的相对应的维保款发票后，甲方在十个工作日内付给乙方上季度维保款（无息）。

第七条 履约保证金

履约保证金金额：无。

第八条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第九条 违约责任

1、除不可抗力原因外，乙方收到甲方维修通知后，没有按照合同和投标文件中约定的响应时间提供服务的，甲方可要求乙方支付违约金。每推迟一天按合同金额的万分之三支付违约金。乙方逾期达到3日及以上的，甲方有权聘请第三方提供相应服务及伴随的货物（含设备零配件及系统升级、维保等），发生的费用全部由乙方承担。逾期达到10日或3次，甲方有权单方解除合同，并要求乙方支付合同年度金额15%违约金，若违约金不足以弥补甲方全部损失（甲方全部损失包括但不限于甲方聘请第三方提供相应服务及伴随的货物的费用、支付给第三方的赔偿金或补偿金、行政处罚、诉讼费/仲裁费、律师费、保全费、保单保函费等直接和间接损失，下同），超出部分乙方还应予以赔偿。

2、乙方提供的服务（提供的相应零配件、产品）如侵犯了第三方合法权益而引

发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部法律责任并赔偿全部损失。因此影响甲方设备正常运转的，甲方要求单方解除合同，并要求乙方支付合同总金额 15%违约金，违约金不足以弥补甲方全部损失的，超出部分乙方还应进行赔偿。

3、甲方延期付款的，每天向乙方偿付延期款额万分之三违约金，但违约金累计不得超过延期款额 5%。

4、因乙方备件库存不充足，导致无法及时按甲方要求更换备件的，甲方可要求乙方支付违约金。每推迟一天按合同金额的万分之三支付违约金。乙方单次逾期更换达到 5 日的，甲方有权聘请第三方提供相应服务及伴随的货物（含设备零配件及系统升级、维保等），发生的费用全部由乙方承担。逾期达到 15 日或 3 次，甲方有权单方解除合同，并要求乙方支付合同年度金额 15%违约金，违约金不足以弥补甲方全部损失的，超出部分乙方还应进行赔偿。

5、乙方提供的服务（提供的相应零配件、产品）不符合相关标准或规定，导致甲方设备毁损或因使用存在前述问题的设备导致人员人身伤亡的，均由乙方承担全部责任，视乙方违约具体情节要求乙方支付合同总金额 10%-30%的违约金，违约金不足以弥补甲方全部损失的，超出部分乙方还应进行赔偿。

6、乙方在合同期内能够保证 100%配件供应，保证设备开机率不低于 98%，如每低于 1 个百分点，合同期限将相应延长 7 个日历日，并按超出天数支付 3000 元/天罚款。

7、服务期内乙方 15 日内无法修复设备故障，或 3 个月内重复发生 3 次同一故障的，甲方有权单方解除合同并拒绝支付服务费用。如造成甲方损失的，则按由乙方承担损失费用（包含但不限于甲方聘请第三方维修的费用）。

8、服务期内设备发生的一切故障，均应由乙方负责维修；如服务期结束后，乙方应负责维修服务期结束前未处理完成的设备故障，直至修复完成并保持 1 个月内同一处维修点无重复故障发生（如故障需更换配件的，由乙方提供配件并安装，配件质保期不少于 6 个月），否则乙方应继续负责维保义务。如发生前述情况，乙方拒绝履行维保义务的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方支付合同总金额 15%违约金，违约金不足以弥补甲方全部损失的，超出部分乙方还应进行赔偿。

9、乙方年度考核评分低于 85 分以下的，甲方可单方面解除合同，并要求乙方支付合同年度金额 10%违约金。

第十条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条 合同争议解决

1、因服务及伴随的货物（含设备零配件及系统升级、维保等）质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。服务及伴随的货物（含设备零配

件及系统升级、维保等)符合标准的,鉴定费由甲方承担;服务及伴随的货物(含设备零配件及系统升级、维保等)不符合标准的,鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决,如果协商不能解决,可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间,本合同继续履行。

第十二条 合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签章并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的,须经财政部门审批,并签书面补充协议报财政部门备案,方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜,遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十三条 合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外,本合同一经签订,甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十四条 签订本合同依据

1、招标文件;

2、乙方提供的投标(或澄清)文件;

3、承诺书;

4、中标或成交通知书。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处,以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十五条 合同份数与附件

1、本合同一式伍份,具有同等法律效力,甲乙双方各执两份(可根据需要另增加),代理机构一份。

2、本合同附件:(1)设备维保考核制度;(2)售后服务方案;(3)技术要求响应表。

甲方名称及公章:梧州市人民医院

乙方名称及公章:广西九州通医疗器械有限公司

法定代表人(负责人)

或授权委托代理人:

邮政编码:543000

地址:梧州市长洲区三龙大道139号

联系电话:0774-2826109

经办人:

合同签订时间:2026年2月13日

法定代表人(负责人)

或授权委托代理人:

邮政编码:

地址:南宁市永林路88号综合大楼310、312室

联系电话:0771-3391586

开户名称:广西九州通医疗器械有限公司

开户银行:交通银行南宁科园支行

银行账号:451060607018010101821

合同签订地点:梧州市



附件 1：设备维保考核表

评价项目	评价标准	基础分值 (合计 100分)	评价方法	评分
响应时间	是否 30 分钟内线上响应	20 分	以 20 分为基础，不能按时响应的，每次扣 1 分。	
紧急维修	是否在约定时间内响应或到达现场	20 分	以 20 分为基础，不能按时响应或到达的，每次扣 1 分。	
常规保养	每季度内是否不少于 1 次保养	20 分	当季度未提供保养服务的直接扣 20 分。	
安全检查	安全检查将按照厂家标准及当地规定执行	20 分	每拒执行一次扣 1 分，全执行 20 分。	
质量保证	必须达到厂家标准和用户临床诊断要求	20 分	每一次不达标扣 1 分，全达标准 20 分。	
<p>总评分标准：</p> <p>1、评分达 95 分及以上为合格；</p> <p>2、评分为 85-94 分按服务项合同金额的百分一扣除；</p> <p>3、在合同期内能够保证 100%配件供应。</p> <p>4、每年年度期满对全年开机率指标进行考核，低于 98%的每一个百分点，维修合同期限将相应延长 7 个日历日。</p> <p>5、评分低于 85 分以下的，采购人可单方面解除合同，并要求服务商支付合同金额 10% 违约金。</p>				

供应商名称（盖公章）： 广西九州通医疗器械有限公司

日期： 2026 年 2 月 13 日



我司提供的维保服务完全满足采购方要求的维保内容及要求，满足采购方要求的故障响应时间、付款方式。

日常维护保养按合同约定内容，按时、按量完成检测、维护工作。保证维护内容真实、可靠，各项记录完整、准确、有案可查并由院方签字确认。每3个月巡查1次。

一、常规维保场次安排

1、提供专业保养：**每年6场**，具体安排为（可根据医院临床需求提前7天调整，避开医院检查高峰期（如体检季、节假日前后））：

月份	时间
3月份	3月份第2周(1天)
5月份	5月份第3周(1天)
7月份	7月份第2周(1天)
9月份	9月份第3周(1天)
11月份	11月份2周(1天)
1月份	1月份第3周(1天)

2、应急维保场次

维保服务期内我公司提供不限次数，根据设备故障情况及时安排，确保故障得到快速处理。

(1) 故障维修场次：当设备出现故障（非医院原因）时，我公司在规定时间内到场维修，每场故障维修视为 1 次应急维保，具体响应时效：

(2) 紧急故障：工程师 4 小时内到场

(3) 一般故障：6 小时内到场。

(4) 每场应急维保需记录故障原因、维修内容、更换部件等信息，形成《应急维修报告》。专项部件更换场次：当核心部件（如球管、探测器、高压发生器）达到更换阈值时，单独安排更换场次，每年根据设备损耗情况确定（通常 1-2 场），更换后需进行全面性能校准，确保符合临床标准。

二、技术支持与培训

1、技术团队：我公司组建专业的维修技术支持团队，成员包括经验丰富的工程师和技术专家，具备CT设备的维修、调试、保养等专业技能。技术团队 24 小时待命，随时为医院提供技术支持和现场服务。

2、培训服务：定期为医院的设备操作人员和维护人员提供球管相关的培训，包括球管的工作原理、操作注意事项、日常维护方法、故障诊断与处理等内容，提高医院人员对球管的认识和管理能力。培训方式包括集中授课、现场演示、在线学习等，每年至少组织 2 次集中培训。

三、维修服务流程


1、客户报修及派工：客户联系 4008004488 报修，客户服务中心在系统中开派工需求单。客户服务中心检查报修的设备是否在保修期之内或者是否在服务合同的范围之内。如果符合这两种情况中的一种，客户服务中心将此报修转给在线技术支持工程师，由在线技术支持工程师按照《在线维修工程师作业指导书》，通过电话

或其他远程手段, 指导客户进行故障排除。如果报修问题解决, 在线技术支持工程师。如问题仍然不能解决, 由客户服务中心根据产品和机型选择责任制派工或智能派工。

2、现场维修: 现场服务工程师在派工系统中可以查看客户电话信息, 与客户打电话沟通故障及派工需求, 现场服务工程师到客户场地上进行维修。在维修过程中, 按照《现场作业防范静电放电措施》实施有效防护。

3、满意度调查: 维修结束后, 工程师向客户沟通汇报本次维修的情况, 客户体验团队按照《客户满意反馈控制程序》, 抽样给报修的客户打电话, 调查客户对此次维修的满意度。

客户对售后服务的要求

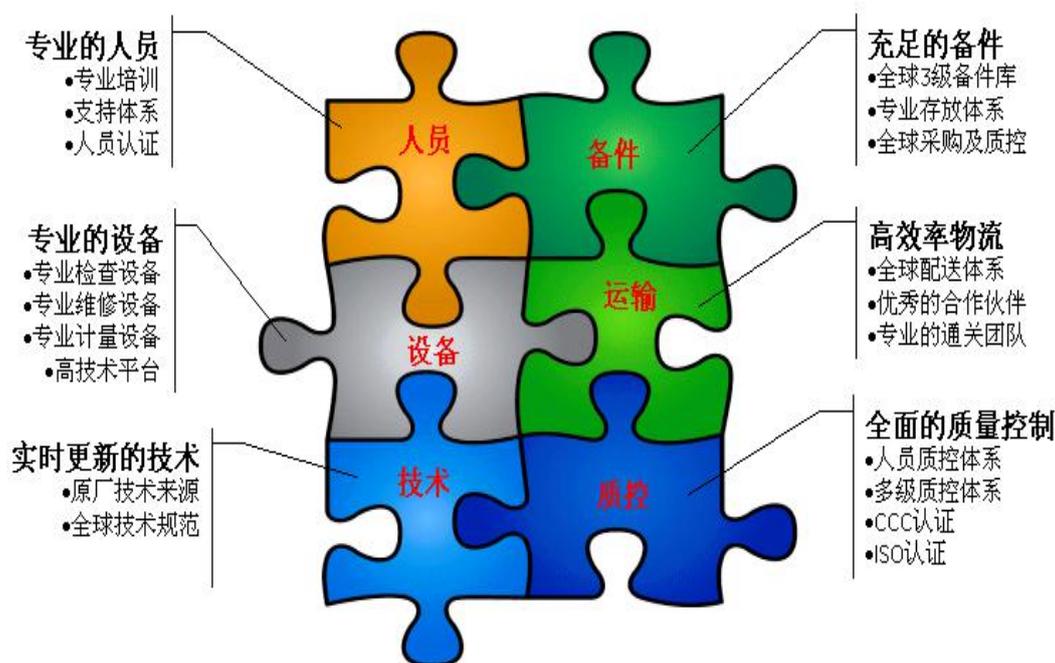

四、服务质量监督

在保修期间, 我方有义务向医院提供优质的服务。如果院方对工作有任何不满意, 可以随时向公司400免费电话投诉、建议。另外, 公司内部对工程师的服务质量有相关考核。考核内容包含维修时间是否在合理范围内, 维修流程是否符合公司安全规定等。

另外，售后服务部会向医院提供每年服务总结报告。其中包含每次派工的时间
工作内容、更换备件情况以及每年预防性保养内容。向客户明确地反映出实际服务
情况。

供应商名称（盖公章）：广西九州通医疗器械有限公司

日 期：2026 年 2 月 13 日



附件 3：技术要求响应表



第二部分 技术文件

1. 对本项目第二章《采购需求》技术要求的响应表

序号	招标文件要求（注明章节及条款号）	投标文件响应内容	偏离说明
	技术要求	技术要求	无偏离
1	1. 需实现的功能、目标及应用场景满足招标文件要求，验收达到合格标准。	1. 我司承诺实现的功能、目标及应用场景满足招标文件要求，验收达到合格标准。	无偏离
2	2. 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 本项目应执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为：详见技术指标要求。	2. 我司承诺执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 本项目应执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为：详见技术指标要求。	无偏离
3	3. 标的所属行业：其他未列明行业	3. 标的所属行业：其他未列明行业	无偏离
4	4. 核心产品 本项目为服务项目，不适用核心产品规定。	4. 核心产品 本项目为服务项目，不适用核心产品规定。	无偏离
5	5. 服务内容和标准	5. 服务内容和标准	无偏离

			离
	<p>5.1. 维保设备：对全身 X 射线计算机断层扫描系统（64 排 CT）（品牌型号为 Discovery CT750HD，生产厂家为 GE，启用时间为 2018 年 6 月，数量一台，提供维保服务，全保，服务期为签订合同之日起 2 年。设备状态：本次招标涉及的 64 排 CT 设备当前存在球管故障，导致其无法正常运行。本次招标旨在为采购人采购一套完整的修复与维保服务。中标人须首先将设备修复至完好状态，随后提供为期 2 年的全面维保服务。上述两项工作的费用均包含在本次招标的总价中。</p>	<p>5.1. 维保设备：对全身 X 射线计算机断层扫描系统（64 排 CT）（品牌型号为 Discovery CT750HD，生产厂家为 GE，启用时间为 2018 年 6 月，数量一台，提供维保服务，全保，服务期为签订合同之日起 2 年。设备状态：本次招标涉及的 64 排 CT 设备当前存在球管故障，导致其无法正常运行。本次招标旨在为采购人采购一套完整的修复与维保服务。我司先将设备修复至完好状态，随后提供为期 2 年的全面维保服务。上述两项工作的费用均包含在本次招标的总价中。</p>	无偏离
2.2	2.2. 服务内容和标准：	2.2. 服务内容和标准：	
1	<p>1、提供 365 天 24 小时咨询和响应，由专业工程师提供每年不少于 4 次对系统专业保养，包括设备安全检查，性能测试，影像质量检查，设备除尘保养，运行状态检查，确保服务质量。并提供定期维护保养报告交采购人。无限次数</p>	<p>1、提供 365 天 24 小时咨询和响应，由我司专业工程师提供每年 6 次对系统专业保养，包括设备安全检查，性能测试，影像质量检查，设备除尘保养，运行状态检查，确保服务质量。并提供定期维护保养报</p>	正偏离

	的远程故障诊断，无限次数的现场技术故障诊断及维修。维修响应时间≤30分钟，到达现场时间≤6小时；（不可抗力除外）	告交采购人。无限次数的远程故障诊断，无限次数的现场技术故障诊断及维修。维修响应时间 30 分钟，到达现场时间 6 小时；（不可抗力除外）	
2	2、提供不限次数的紧急维修，承诺 30 分钟内响应，工程师必须 6 小时内赶到现场处理故障。	2、我司提供不限次数的紧急维修，承诺 30 分钟内响应，工程师 6 小时内赶到现场处理故障。	无偏离
3	3、提供设备损坏后的所有配件并安装，确保更换的配件原装配件且渠道合法，须保证设备正常运行。	3、我司提供设备损坏后的所有配件并安装，承诺更换的配件为原装配件且渠道合法，保证设备正常运行。	无偏离
4	4、无限次数的远程故障诊断，无限次数的现场技术故障诊断及维修	4、我司提供无限次数的远程故障诊断，无限次数的现场技术故障诊断及维修	无偏离
5	5、服务期间提供远程诊断工具，自行负责安装调试完成交付科室使用，满足科室远程紧急维修要求。	5、服务期间我司提供远程诊断工具，并自行负责安装调试完成交付科室使用，满足科室远程紧急维修要求。	无偏离
6	6、常规性保养：每年度内提供不少于 4 次的设备保养，以保证设备处于最佳运行状态，包括：	6、常规性保养：每年度内提供6次的设备保养，以保证设备处于最佳运行状态，包括：	正偏离

	<p>(1) 记录并安排保养时间</p> <p>(2) 保养计划更换损耗部件</p> <p>(3) 做常规检测</p> <p>(4) 按照厂家标准进行调校</p> <p>(5) 确认各项技术指标及性能</p> <p>(6) 记录设备状况</p> <p>(7) 提供设备保养内容清单</p>	<p>(1) 记录并安排保养时间</p> <p>(2) 保养计划更换损耗部件</p> <p>(3) 做常规检测</p> <p>(4) 按照厂家标准进行调校</p> <p>(5) 确认各项技术指标及性能</p> <p>(6) 记录设备状况</p> <p>(7) 提供设备保养内容清单</p>	
7	<p>7、安全检查：安全检查将按照原设备制造商标准及当地规定执行，在每次设备保养时，具体包括：</p> <p>(1) 制定检查计划；</p> <p>(2) 机械安全检查；</p> <p>(3) 电气安全检查；</p> <p>(4) 记录检查结果；</p> <p>(5) 出具安全检测报告。</p>	<p>7、安全检查：安全检查将按照原设备制造商标准及当地规定执行，在每次设备保养时，具体包括：</p> <p>(1) 制定检查计划；</p> <p>(2) 机械安全检查；</p> <p>(3) 电气安全检查；</p> <p>(4) 记录检查结果；</p> <p>(5) 出具安全检测报告。</p>	无偏离
8	<p>8、维保质量：必须达到原设备制造商标准和临床诊断要求。</p>	<p>8、维保质量：我司承诺维保设备达到原设备制造商标准和临床诊断要求。</p>	无偏离
9	<p>9、质量保证：</p> <p>(1) 制定检查计划；</p>	<p>9、质量保证：</p> <p>(1) 制定检查计划；</p>	无偏离

	<p>(2) 图象质量（效果）检查；</p> <p>(3) 评判参数结果；</p> <p>(4) 调整/校准；</p> <p>(5) 记录检查结果。</p>	<p>(2) 图象质量（效果）检查；</p> <p>(3) 评判参数结果；</p> <p>(4) 调整/校准；</p> <p>(5) 记录检查结果。</p>	
10	10、图像质量控制：具有检验与校正图像质量的工具和能力，保证图像达到出厂标准。	10、图像质量控制：我司具有检验与校正图像质量的工具和能力，保证图像达到出厂标准。	无偏离
11	11、设备使用安全保证：具备关键部件更换之后的接地和漏电安全检查需要的设备和能力。	11、设备使用安全保证：我司具备关键部件更换之后的接地和漏电安全检查需要的设备和能力。	无偏离
12	12、投标人在国内设有备品备件库或承诺中标后建立备品备件库（已有的：需提供详细地址及仓库租赁合同或不动产证明权属等证明文件；承诺的：需提供建立备品备件库承诺书），要求备品备件能在 6 小时内到达医院。	12、我司在国内设有备品备件库（地址：南宁市永林路88号综合大楼110、312室；我司在商务技术文件提供仓库租赁合同证明文件），保证备品备件能在 6 小时内到达医院。	无偏离
13	13、投标人在国内设有维修中心或承诺中标后建立维修中心（已有的：需提供详细地址及租赁合同或不动产证明权属等证明文件；承诺的：需提供建立维修中心承诺书），要求工程师能在 6 小	13、我司在国内设有维修中心（（地址：南宁市永林路88号综合大楼310、312室；我司在商务技术文件提供仓库租赁合同证明文件），保证工程师能在 6 小时内到达医院。	无偏离

	<p>小时内到达医院。</p>		
14	<p>14、配件保证： 在合同期内能够保证 100%配件供应，保证设备开机率不低于 98%，如每低于 1 个百分点，合同期限将相应延长 7 个日历日，并按超出天数支付 3000 元/天作为违约金。</p>	<p>14、配件保证： 我司在合同期内能够保证100%配件供应，保证设备开机率98.5%，如每低于1个百分点，合同期限将相应延长7个日历日，并按超出天数支付3000 元/天作为违约金。</p>	正偏离
15	<p>15、服务期内设备发生的一切故障，均由中标人负责维修；如服务期结束后，中标人应负责维修服务期结束前未处理完成的设备故障，直至修复完成并保持 1 个月内同一处维修点无重复故障发生（如故障需更换配件的，由中标人提供配件安装，配件质保期不少于 6 个月），否则投标人应继续负责维保义务。</p>	<p>15、服务期内设备发生的一切故障，均由我司负责维修；如服务期结束后，我司负责维修服务期结束前未处理完成的设备故障，直至修复完成并保持1个月内同一处维修点无重复故障发生（如故障需更换配件的，由我司提供配件安装，配件质保期6 个月），否则我司继续负责维保义务。</p>	无偏离
16	<p>16、服务期内中标人 15 日内无法修复设备故障，或 3 个月内重复发生3 次同一故障的，采购人有权单方解除合同并拒绝支付服务费用。如造成采购人损失的，则按由中标人承担损失费用（包</p>	<p>16、我司服务期内若在15日内无法修复设备故障，或3个月内重复发生3 次同一故障的，采购人有权单方解除合同并拒绝支付服务费用。如造成采购人损失的，我司承担损失</p>	无偏离

	含但不限于采购人聘请第三方维修的费用)。	费用(包含但不限于采购人聘请第三方维修的费用)。	
17	17、中标人不能以任何形式转包,不接受联合体投标。不得整体或部份将维修工作转包给其它公司或个人,一经查实,采购人有权单方解除合同并拒绝支付服务费用,中标人要赔偿由此引起的一切经济损失。	17、我司承诺不以任何形式转包,不参与不组织联合体投标。不整体或部份将维修工作转包给其它公司或个人,一经查实,采购人有权单方解除合同并拒绝支付服务费用,我司赔偿由此引起的一切经济损失。	无偏离
18	18、拟投入人员要求 投标人须至少配备 1 名项目经理和 1 名工程师负责本项目。	18、拟投入人员要求 我司配备 1 名项目经理和 4 名工程师负责本项目。	正偏离

注: (1) 本表应对招标文件第二章《采购需求》中所列技术要求进行响应,并根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因,完全符合的填写“无偏离”。

(2) 第二章《采购需求》中的总体要求无需响应。

(3) 偏离认定说明详见评审方法及标准。

(4) 本表可扩展。

供应商名称(电子签章): 广西九州通医疗器械有限公司

日期: 2026年01月27日

供应商名称(盖公章): 广西九州通医疗器械有限公司

日期: 2026年2月13日

项目采购（货物、服务类）廉洁协议

项目名称：医疗设备维保服务

（分标1：全身 X 射线计算机断层扫描系统维保服务（全保））

项目编号：WZZC2025-G3-990354-JDZB

甲方（采购单位）：梧州市人民医院

乙方（成交/中标供应商）：广西九州通医疗器械有限公司

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范甲乙双方的购销行为，有效防范商业贿赂，营造公平交易、诚实守信的购销环境，维护医院正常医疗秩序，经甲、乙双方协商，同意签订本协议，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及政府采购合同约定履行合同内容。

二、甲方应当严格执行货物、服务类采购合同的验收、入库等制度，对采购内容及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的宴请、旅游和营业性娱乐活动等，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。

四、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员的采购工作，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

五、乙方不得以围标、相互串通投标，或者排挤其他供应商的公平竞争，损害采购人或者其他供应商的合法权益，严禁以他人名义投标或允许他人以自己的名义投标，不得提供虚假资料参与投标或以其他方式弄虚作假、骗取中标。甲方发现乙方违反规定者，按甲方有关管理规定，列入医院招投标不良行为黑名单。

六、乙方指定秦松作为授权代表对接业务。授权代表必须在工作时间到甲方指定地点联系对接。不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费，甲方发现乙方违反规定者，列入医院招投标不良行为黑名单。

七、乙方如违反本协议，一经发现，甲方有权终止采购合同。如乙方被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，则严格按照《中华人民共和国政府采购法》相关规定处理。

八、本协议作为采购合同的重要组成部分，与采购合同一并执行，具有同等的法

律效力，从签订之日起生效。

甲方（盖章）：梧州市人民医院

乙方（盖章）：广西九州通医疗器械有限公司



地址：梧州市长洲区三龙大道139号

地址：南宁市永林路88号综合大楼310、312
室

法定代表人：

法定代表人：

经办人签名：

经办人签名：

日期：2026年2月13日

日期：2026年2月13日