

质疑函

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商： 江西迈越贸易有限公司

地址： 江西省吉安市万安县工业园二期迎宾大道实训大楼 105 室

邮编： 343800

联系人： 姚逸聪 联系电话： 13690369343

授权代表： 姚逸聪

联系电话： 13690369343

地址： 江西省吉安市万安县工业园二期迎宾大道实训大楼 105 室

邮编： 343800

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称： 采购动态平板 X 线机（胃肠透视机）

质疑项目的编号： BHZC2026-J1-210051-YXGC

采购人名称： 合浦县人民医院

质疑事项：招标文件参数具有独家倾向性，存在不公平对待行为，影响公平竞争。

谈判文件 谈判文件获取日期： 2026 年 6 月 4 日

采购过程

成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项一：招标文件参数、评分标准独家倾向普利德品牌产品，不公平对待，严重违反政府采购公平竞争原则。

事实依据 1：多条参数为普利德厂家产品量身定做，同档次产品其它

厂家无法参与此项目，严重违反了招投标法对于招标项目公平公正的要求，具体参数如下所示：

参数：▲2.4.2 最大透视电流： $\leq 20\text{mA}$


最大透视电流： $\leq 20\text{mA}$ ，表述存在明显逻辑错误。“最大”代表参数上限，不应搭配“小于等于”符号进行限定。技术上讲，最大电流越大，其选择灵活性越强，面对复杂体位会有更好的效果。同时经查实， 20mA 这一指标为普利德品牌产品专属参数，▲为实质性要求，该条款刻意设置定向指标，变相排斥其他潜在投标人，违背招投标公平竞争原则，恳请招标人对本条参数表述及指标内容进行修改调整。

建议修改为：▲2.4.2 最大透视电流： $\geq 20\text{mA}$

参数：▲7.1 控制台操作手柄采用高灵敏度操纵杆，操作杆个数 ≥ 4 个，分别或同时对诊断床床身转动，立柱纵向移动，床面横向移动，SID拉升，限束器视野范围调节，压迫器进行操控。

实际市场中，各主流厂商对于操作手柄的设计存在多样性。有的采用多个操作杆分工控制，有的则采用更集成化的 1-2 个多功能操作杆，均能高效完成各项预设功能。将操作杆数量作为实质性要求，可能会无意中限制了部分采用不同设计理念但同样优秀的产品参与竞争。且“操作杆个数 ≥ 4 个”这一特点与“普利德”品牌的产品设计较为一致，限制其它品牌产品参与。

证明：普利德产品照片

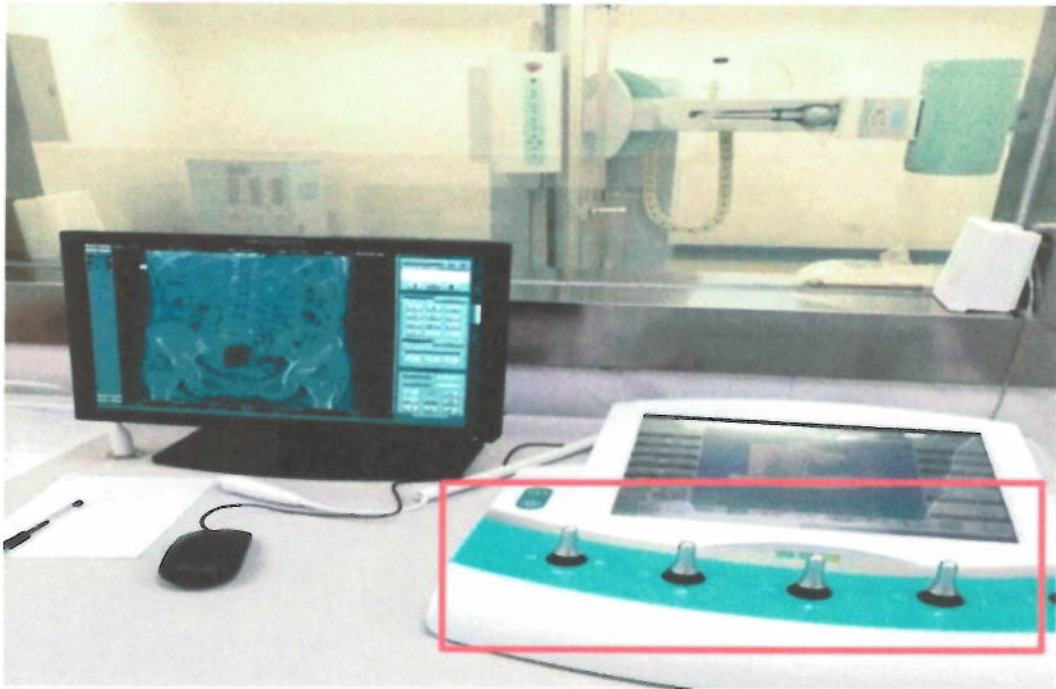

建议修改为：▲7.1 控制台操作手柄采用高灵敏度操纵杆，具备对所有关键功能的操控能力”，可对诊断床床身转动，立柱纵向移动，床面横向移动，SID 拉升，限束器视野范围调节，压迫器进行操控。


法律依据：《中华人民共和国政府采购法》第三条：政府采购应当遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则。第二十二条第二款：采购人不得以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条：采购人设定的技术、商务条件与项目实际需要无关、指向特定供应商 / 产品、以不合理条件限制排斥潜在投标人的，属于差别待遇或歧视待遇。

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：认真审查参数的设定，重新制定公平公正的招标需求参数，让除普利德外其它厂家也能够公平公正的参与此项目。

为维护国家利益、保护政府采购当事人和所有参与此项目投标商的合法权益，希望贵单位能依据法律法规对以上问题给予公平公正处理，修改以上不合理参数。如若不彻底修改锁定普利德品牌设备参数，但是开标结果还是普利德产品中标，我们将向上级纪检部门和财政局进行投述。

签字(签章)： 

公章：江西迈越贸易有限公司

日期： 2026年6月8日



质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

授权委托书

致：合浦县人民医院：

我 李柳峰（姓名）系 江西迈越贸易有限公司（投标人名称）的法定代表人，现授权委托 姚逸聪 以我方的名义参加 采购动态平板 X 线机(胃肠透视机) 项目的投标、质疑、投诉等相关活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

委托代理人：姚逸聪 法定代表人（签字或者盖章）：李柳峰

委托代理人身份证号码：440421200108078013

质疑单位名称（电子签章）：江西迈越贸易有限公司

2026年6月8日

附：委托代理人有效身份证正反面电子扫描件



法定代表人身份证明

投 标 人： 江西迈越贸易有限公司

地 址： 江西省吉安市万安县工业园二期迎宾大道实训大楼 105 室

姓 名： 李柳峰 性 别： 男

年 龄： 46 岁 职 务： 总经理

身份证号码： 440811197907100613

系 江西迈越贸易有限公司 的法定代表人。

特此证明。

意见单位名称（公章）： 江西迈越贸易有限公司

2026 年 6 月 8 日

附件：法定代表人有效身份证正反面电子扫描件

