

## 质疑函

### 一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商： 广西银聚海贸易有限公司

地址： 南宁市金凯路 8 号龙光玖誉城悦城组团 59 号楼十三层 1332 号办公

邮编： 530000

联系人： 覃海鹏

联系电话： 15078823825

授权代表： 覃海鹏

联系电话： 15078823825

地址： 南宁市金凯路 8 号龙光玖誉城悦城组团 59 号楼十三层 1332 号办公

邮编： 530000

### 二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称： 罗城仫佬族自治县人民医院智慧医院建设

质疑项目的编号： HCZC2026-G3-250019-TQGC

采购人名称： 罗城仫佬族自治县人民医院

质疑事项：

招标文件      招标文件获取日期：

采购过程

中标结果

### 三、质疑事项具体内容




质疑事项 1：第二章 采购需求-采购需求/配置说明涉嫌指定特定供应商。


事实依据：招标文件第二章采购需求中的技术参数，与东华医为科技有限公司已中标项目的采购需求内容完全一致，绝非巧合，而是采购人与该公司恶意串通、量身定制的直接证据如下：

(1) 南宁市中西医结合医院智慧医院建设（一期）项目（中标厂商：东华医为科技有限公司）其招标文件中的医院管理信息系统（HIS）、电子病历 EMR、医学影像存储传输与信息管理系统 PACS/RIS 等模块的技术参数，与本项目对应采购需求一字不差。

南宁市中西医结合医院智慧医院建设（一期）项目结果公告  
(网址：<http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/site/detail?parentId=66485&articleId=PAi1Jig6Ufi+I8G97z72fA==>)

对比证明：

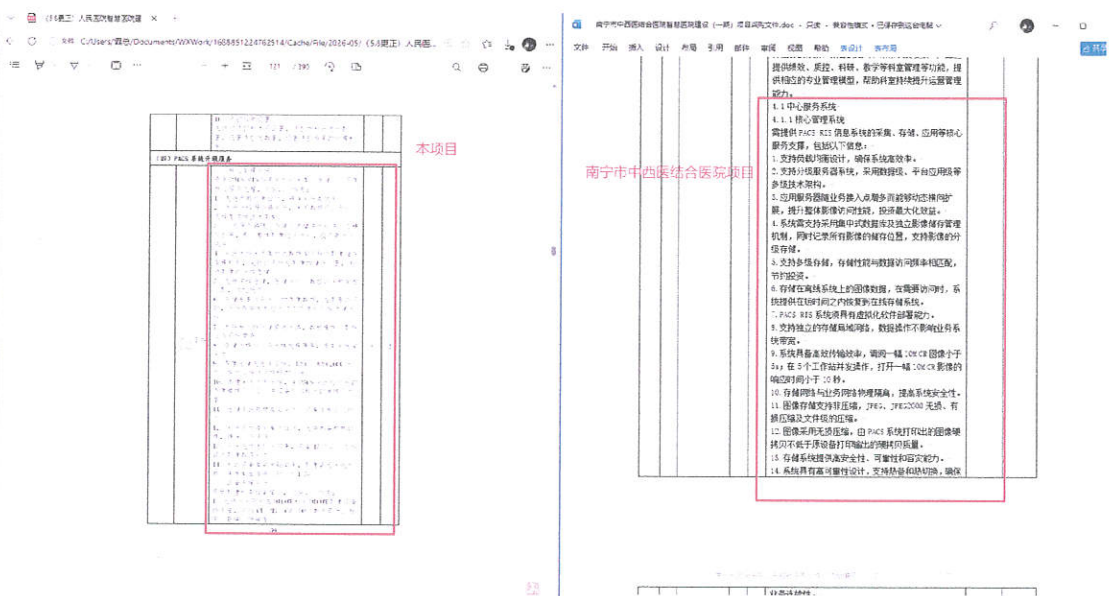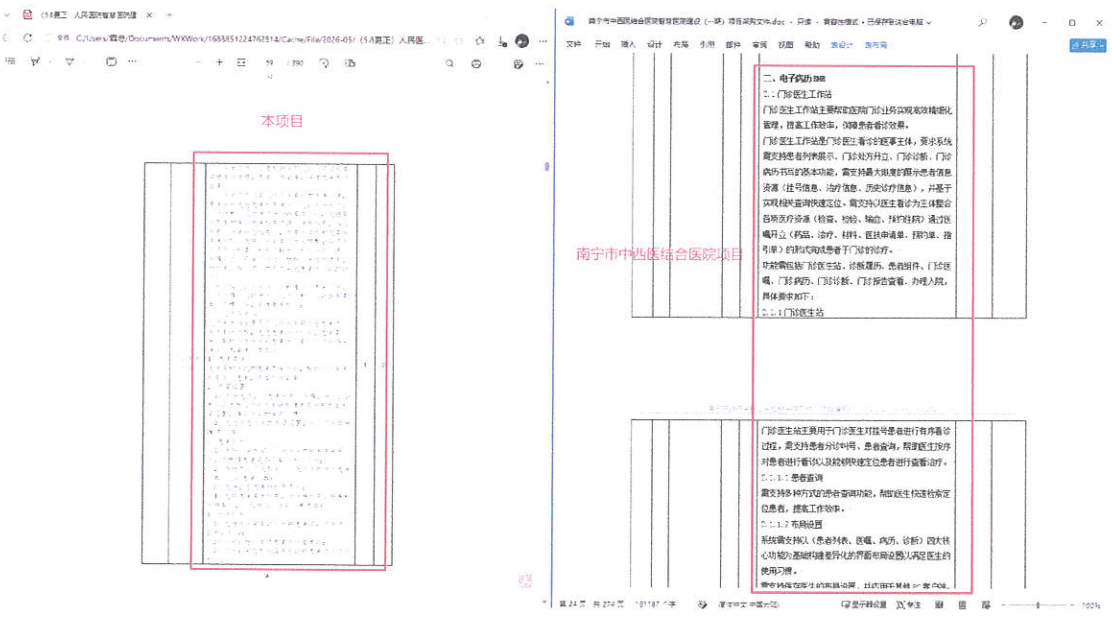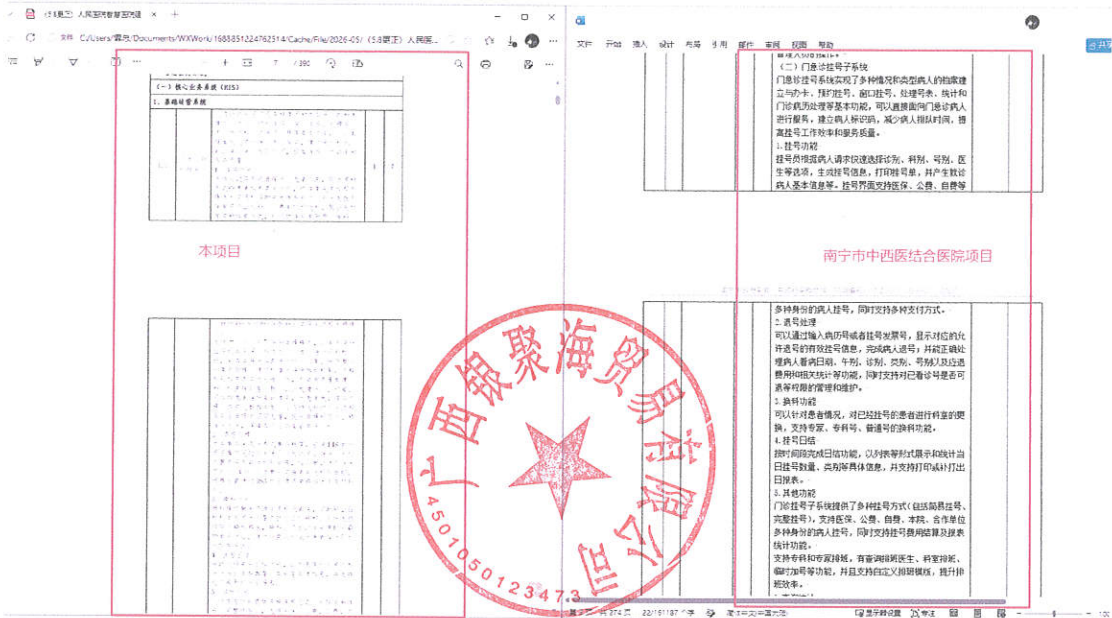


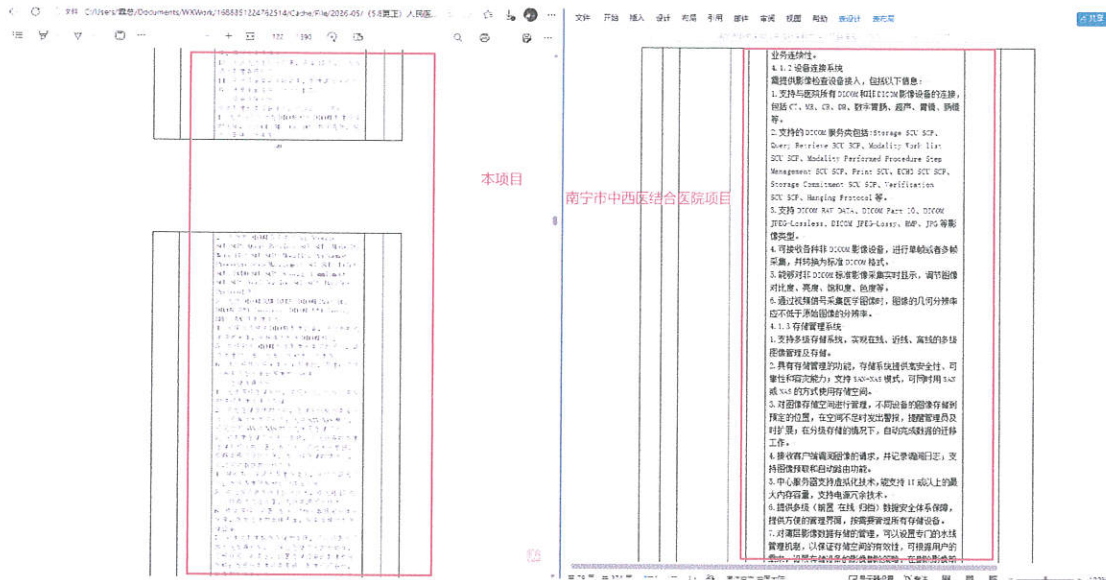


(2) 辽宁省人民医院数智化医院建设项目（中标厂商：东华医为科技有限公司）其招标文件中的医院管理信息系统(HIS)、实验室信息管理系统（LIS）、智慧病案管理等模块的技术参数，与本项目对应采购需求一字不差。

辽宁省人民医院数智化医院建设项目（第三次）结果公告（网  
址：\_\_\_\_\_

[https://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202605/t20260519\\_26589567.htm](https://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202605/t20260519_26589567.htm)

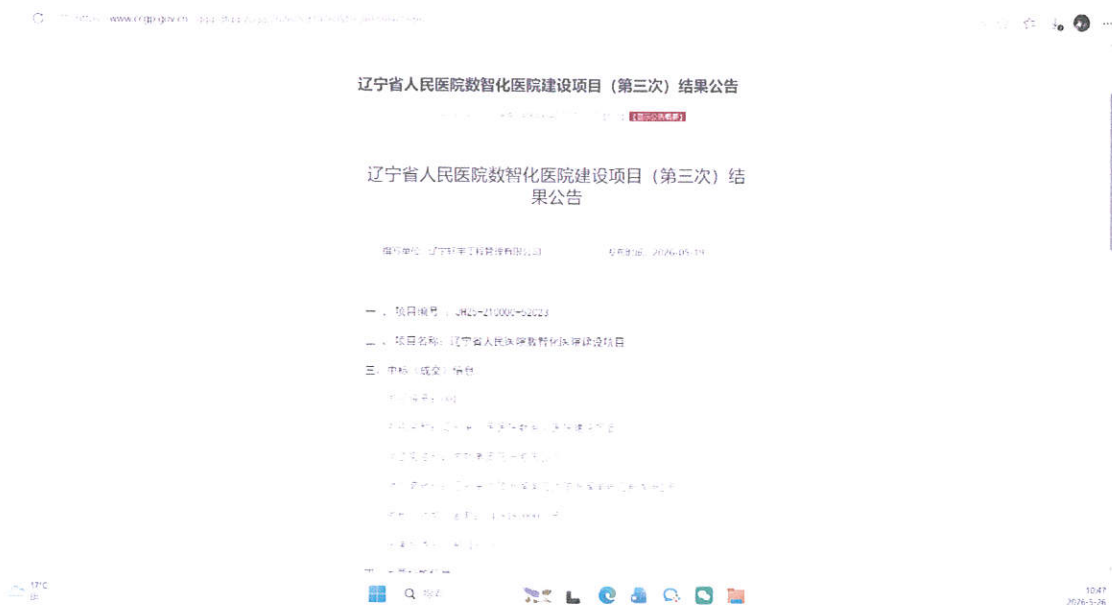



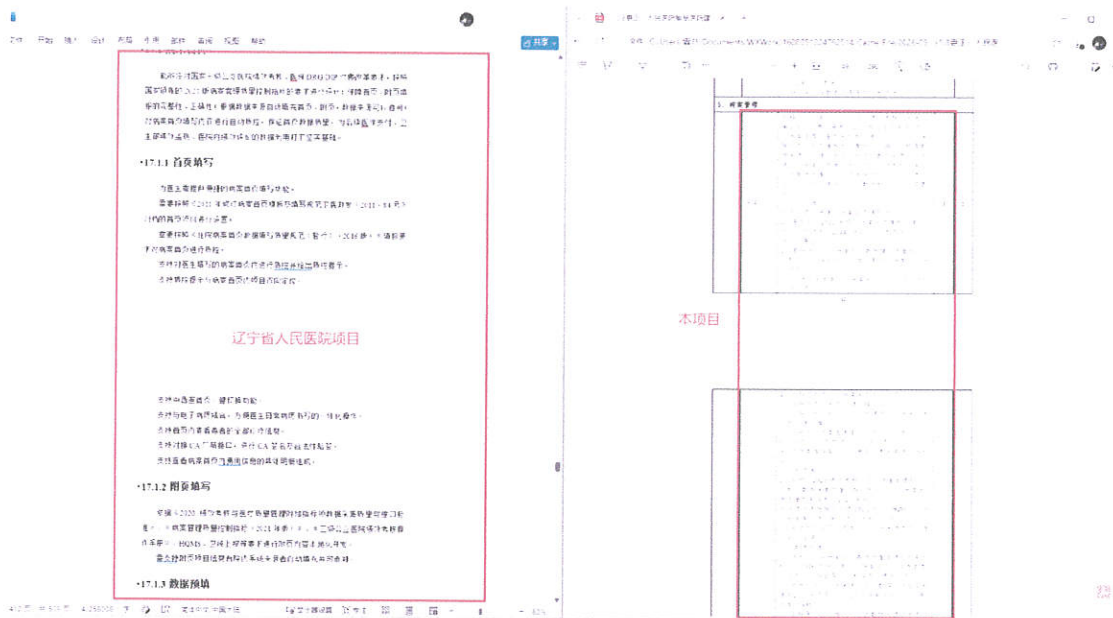

(3) 中山大学孙逸仙纪念医院集团化多院区信息系统建设(二期)项目之南北院区信息化改造升级(中标厂商:东华医为科技有限公司)其招标文件中的医院管理信息系统(HIS)、智慧病案管理等模块的技术参数,与本项目对应采购需求一字不差。

中山大学孙逸仙纪念医院集团化多院区信息系统建设(二期)项目之南北院区信息化改造升级结果公告(网址:

[https://www.ccgp.gov.cn/cggg/zygg/zbgg/202510/t20251013\\_25492020.htm](https://www.ccgp.gov.cn/cggg/zygg/zbgg/202510/t20251013_25492020.htm))



中山大学孙逸仙纪念医院集团化多院区信息系统建设(二期)项目之南北院区信息化改造升级 (0809-25411GJG303012501) 中标公告


- 一、项目编号: 0809-25411GJG303012501
  - 二、项目名称: 中山大学孙逸仙纪念医院集团化多院区信息系统建设(二期)项目之南北院区信息化改造升级
  - 三、中标(成交)名称: 中山大学孙逸仙纪念医院集团化多院区信息系统建设(二期)项目之南北院区信息化改造升级
  - 四、主要标的情况:
- | 标的名称                                      | 品牌  | 数量 | 单价          | 总价          | 品牌  | 数量 | 单价          | 总价          |
|---|---|----|-------------|-------------|---|----|-------------|-------------|
| 中山大学孙逸仙纪念医院集团化多院区信息系统建设(二期)项目之南北院区信息化改造升级 | 中山大学孙逸仙纪念医院集团化多院区信息系统建设(二期)项目之南北院区信息化改造升级 | 1  | 10000000.00 | 10000000.00 | 中山大学孙逸仙纪念医院集团化多院区信息系统建设(二期)项目之南北院区信息化改造升级 | 1  | 10000000.00 | 10000000.00 |



对比证明:

本项目

中山大学项目

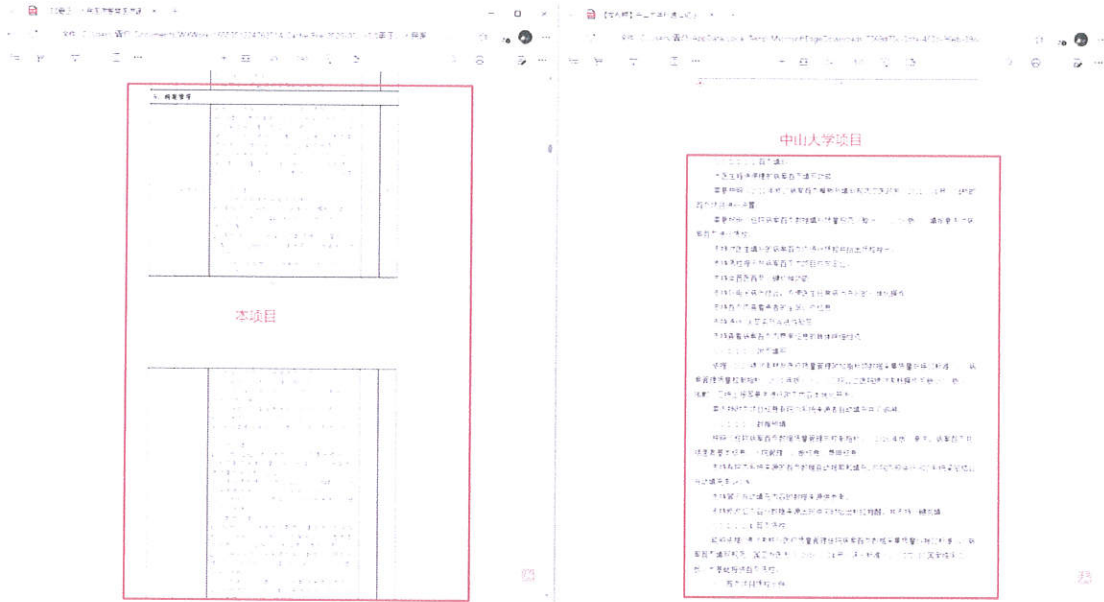

综上所述，明显属于“东华医为科技有限公司”专属定制采购需求及评分内容以不合理条件限制或者排斥潜在供应商，属于赤裸裸的暗箱操作，完全背离政府采购“公开、公平、公正”的基本原则。

法律依据：1、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条 采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：（一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；（二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；（三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；（四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；（五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；（六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；（七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；（八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

2、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第 87 号)第二十五条：“招标文件、资格预审文件的内容不得违反法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策，或者违反公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则。有前款规定情形，影响潜在投标人投标或者资格预审结果的，采购人或者采购代理机构应当修改招标文件或者资格预审文件后重新招标”。

质疑事项 2：本项目招标文件采购 PACS 系统，未设置投标产品须具备《医疗器械注册证》及对应经营、生产资质的实质性要求，招标文件存在违法违规瑕疵，违反国家强制性法律法规及政府采购相关规定。


事实依据：PACS 系统、心电系统均属于法定第二类医疗器械，依法必须取得医疗器械注册证方可销售、采购、使用。根据国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》及相关注册审查指导原则规定：医学图像存储与传输软件（PACS 系统）属于第二类医疗器械（分类编码 21-02-01）；心电系统（心电采集、分析、存储系统软件）属于医用诊疗辅助软件，归类为第二类医疗器械，纳入严格监管范畴。依据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第 739 号）第十三条、第四十五条、第五十五条强制性规定，第二类医疗器械必须依法取得医疗器械注册证，严禁采购、使用、经营未取得注册证的医疗器械，医疗机构采购的医疗器械必须为具备合法注册资质的合规产品，该要求为国家效力性强制性规定，任何采购活动必须严格遵守。

招标文件缺失医疗器械注册证及相关资质要求，属于违法采购文







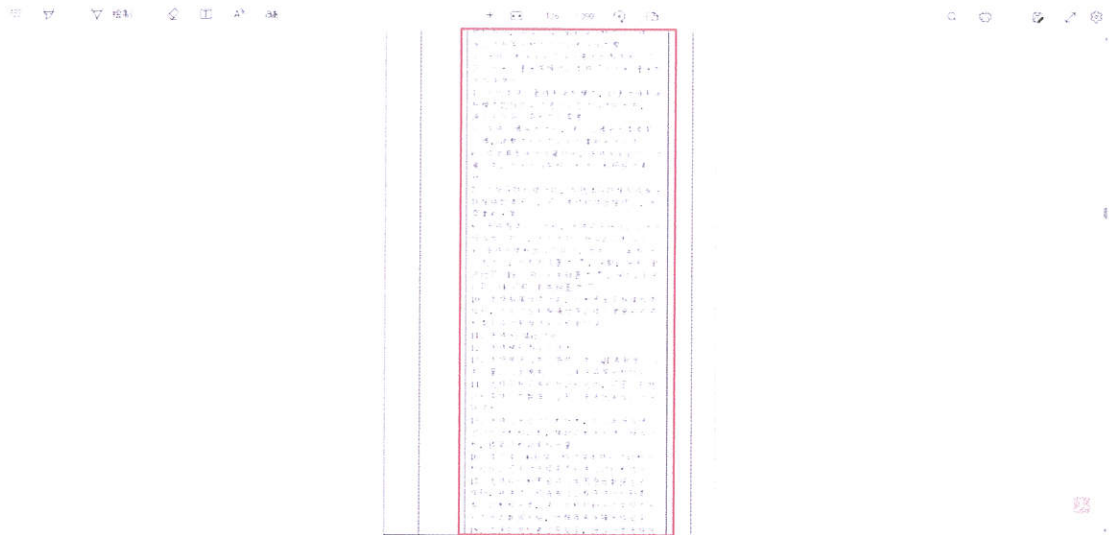


法律依据：1、《政府采购需求管理办法》第七条 采购需求应当符合法律法规、政府采购政策和国家有关规定，符合国家强制性标准，遵循预算、资产和财务等相关管理制度规定，符合采购项目特点和实际需要。

#### 四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：重新设定评审因素及评分标准，修改招标文件不合理条款，暂停采购活动，依法对采购意向予以公示。如若贵单位不能给予正面答复，我公司有权向主管部门投诉。

签字（签章）：



日期：2026年06月05日

# 关于罗城仫佬族自治县人民医院智慧医院建设 限期补齐补正质疑函的告知函

质疑供应商：广西银聚海贸易有限公司

地址：南宁市金凯路8号龙光玖誉城组团59号楼十三层1332号办公

法定代表人：苏红

授权代表：覃海鹏

贵公司关于罗城仫佬族自治县人民医院智慧医院建设（项目编号：HCZC2026-G3-250019-TQGC）的质疑函已于2026年6月6日由顺丰速运送达我公司，质疑函为原件15页，落款日期为2026年6月5日。因送达日期不在工作日，根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）的规定，经我公司相关工作人员在2026年6月8日审查：

你单位的质疑函存在下列问题：

1、根据《办法》第八条第二款“代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。”，招标文件中提供的质疑函格式同样要求“质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。”贵公司的质疑函中授权代表覃海鹏未附授权委托书；

2、贵公司未按招标文件质疑函格式要求填写招标文件获取日期。

请贵公司补充修改后于质疑期内重新提起质疑，逾期不予受理。

天勤工程咨询有限公司

2026年6月8日



## 质疑函

### 一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：广西银聚海贸易有限公司

地址：南宁市金凯路 8 号龙光玖誉城悦城组团 59 号楼十三层  
1332 号办公

邮编：530000

联系人：覃海鹏

联系电话：15078823825

授权代表：覃海鹏

联系电话：15078823825

地址：南宁市金凯路 8 号龙光玖誉城悦城组团 59 号楼十三层  
1332 号办公

邮编：530000

### 二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：罗城仫佬族自治县人民医院智慧医院建设

质疑项目的编号：HCZC2026-G3-250019-TQGC

采购人名称：罗城仫佬族自治县人民医院

质疑事项：

招标文件      招标文件获取日期：2026 年 06 月 08 日

采购过程

中标结果

### 三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：第二章 采购需求-采购需求/配置说明涉嫌指定特定供应商。

事实依据：招标文件第二章采购需求中的技术参数，与东华医为科技有限公司已中标项目的采购需求内容完全一致，绝非巧合，而是采购人与该公司恶意串通、量身定制的直接证据如下：





(1) 南宁市中西医结合医院智慧医院建设（一期）项目（中标厂商：东华医为科技有限公司）其招标文件中的医院管理信息系统（HIS）、电子病历 EMR、医学影像存储传输与信息管理系统 PACS/RIS 等模块的技术参数，与本项目对应采购需求一字不差。

南宁市中西医结合医院智慧医院建设（一期）项目结果公告

（网址：<http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/site/detail?parentId=66485&articleId=PAi1Jig6UFi+I8G97z72fA==>）

对比证明：




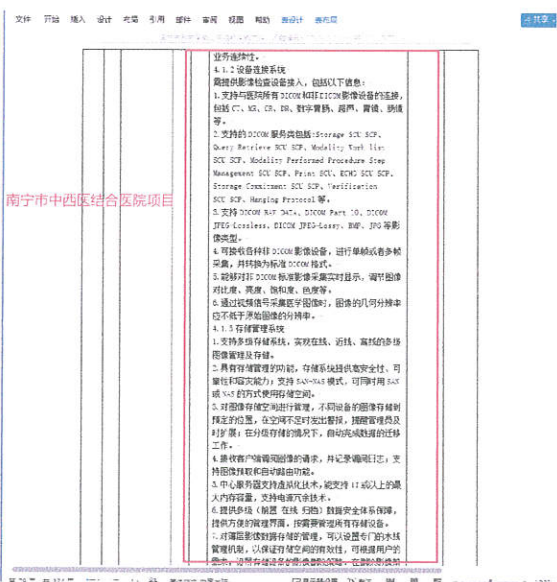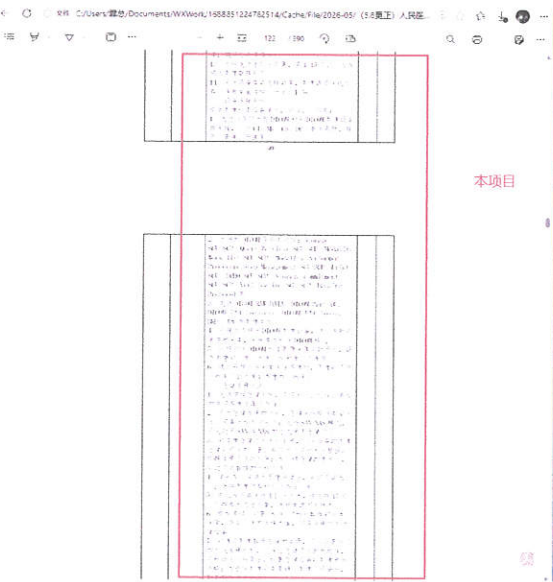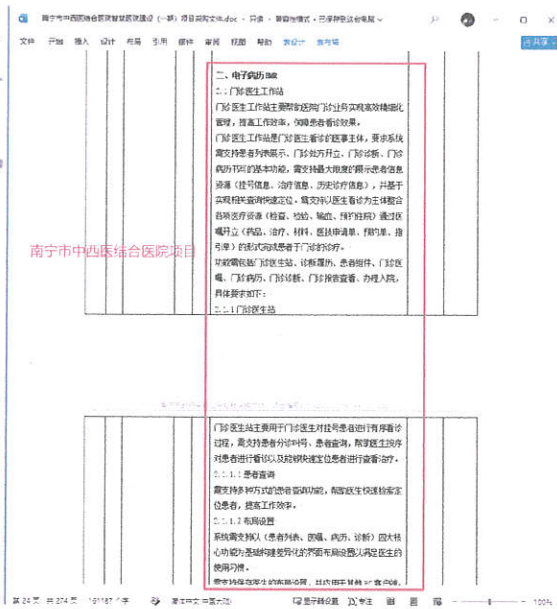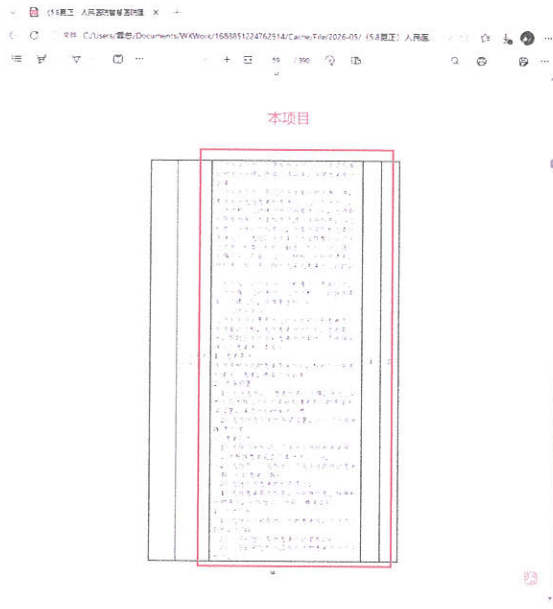

(2) 辽宁省人民医院数智化医院建设项目（中标厂商：东华医为科技有限公司）其招标文件中的医院管理信息系统(HIS)、实验室信息管理系统（LIS）、智慧病案管理等模块的技术参数，与本项目对应采购需求一字不差。

辽宁省人民医院数智化医院建设项目（第三次）结果公告（网址：

[https://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbfgg/202605/20260519\\_26589567.htm](https://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbfgg/202605/20260519_26589567.htm)）

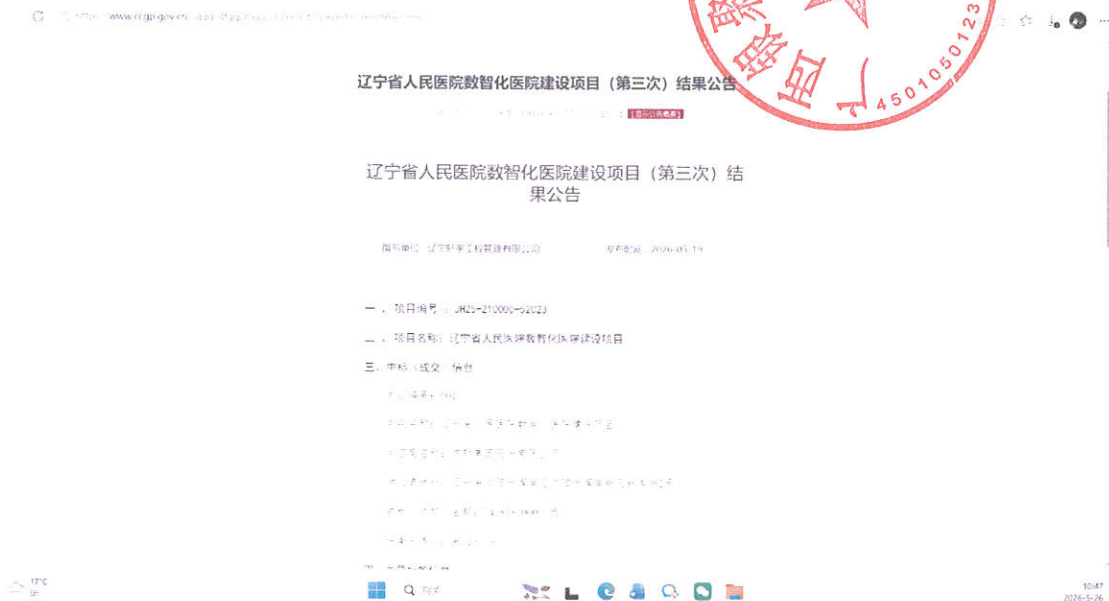

对比证明：

辽宁省人民医院信息化建设采购项目 2020年8月 第二册 采购内容二

文件 开始 插入 设计 布局 视图 窗口 帮助 云服务 云服务 云服务

**3.1 标本采集**

**3.1.1 门诊标本采集**

**3.1.1.1 挂的取数表数据**

需支持通过条码唯一标识（条码、数字、字母、数字字母）。

**辽宁省人民医院**

请参照：附件清单中以下标头数据，以表格形式，加盖公章。

**3.1.1.2 获取医嘱数据**

需支持通过医嘱系统接口，获取医嘱数据，并支持与检验设备连接。

支持通过医嘱系统接口，获取医嘱数据，并支持与检验设备连接。

支持通过医嘱系统接口，获取医嘱数据，并支持与检验设备连接。

支持通过医嘱系统接口，获取医嘱数据，并支持与检验设备连接。

**3.1.1.3 根据组合规则打印条码**

支持根据组合规则生成条码，并支持与检验设备连接。

支持根据组合规则生成条码，并支持与检验设备连接。

支持根据组合规则生成条码，并支持与检验设备连接。

支持根据组合规则生成条码，并支持与检验设备连接。


**3.1.1.4 打印医嘱项目**

辽宁省人民医院信息化建设采购项目 2020年8月 第二册 采购内容二

文件 开始 插入 设计 布局 视图 窗口 帮助 云服务 云服务 云服务

本项目

1.1.1.1 挂的取数表数据 (1/2)
1.1.1.2 获取医嘱数据
1.1.1.3 根据组合规则打印条码
1.1.1.4 打印医嘱项目

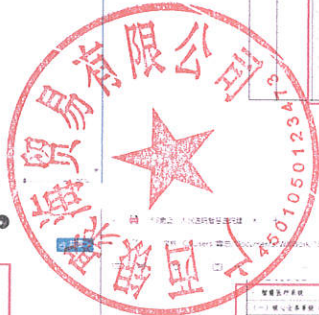

辽宁省人民医院信息化建设采购项目 2020年8月 第二册 采购内容二

文件 开始 插入 设计 布局 视图 窗口 帮助 云服务 云服务 云服务

**9. 医院管理信息系统(HIS)**

**9.1 门诊挂号系统 辽宁省人民医院项目**

需支持通过门诊挂号系统接口，获取门诊挂号数据，并支持与检验设备连接。

**9.1.1 挂号功能**

支持通过门诊挂号系统接口，获取门诊挂号数据，并支持与检验设备连接。

支持通过门诊挂号系统接口，获取门诊挂号数据，并支持与检验设备连接。

支持通过门诊挂号系统接口，获取门诊挂号数据，并支持与检验设备连接。

**9.1.2 退号处理**

支持通过门诊挂号系统接口，获取门诊挂号数据，并支持与检验设备连接。

支持通过门诊挂号系统接口，获取门诊挂号数据，并支持与检验设备连接。

支持通过门诊挂号系统接口，获取门诊挂号数据，并支持与检验设备连接。

**9.1.3 挂号日期**

支持通过门诊挂号系统接口，获取门诊挂号数据，并支持与检验设备连接。

支持通过门诊挂号系统接口，获取门诊挂号数据，并支持与检验设备连接。

支持通过门诊挂号系统接口，获取门诊挂号数据，并支持与检验设备连接。

**9.1.4 其他功能**

辽宁省人民医院信息化建设采购项目 2020年8月 第二册 采购内容二

文件 开始 插入 设计 布局 视图 窗口 帮助 云服务 云服务 云服务

本项目

1.1.1.1 挂的取数表数据 (1/2)
1.1.1.2 获取医嘱数据
1.1.1.3 根据组合规则打印条码
1.1.1.4 打印医嘱项目



(3) 中山大学孙逸仙纪念医院集团化多院区信息系统建设(二期)项目之南北院区信息化改造升级(中标厂商:东华医为科技有限公司)其招标文件中的医院管理信息系统(HIS)、智慧病案管理等模块的技术参数,与本项目对应采购需求一字不差。

中山大学孙逸仙纪念医院集团化多院区信息系统建设(二期)项目之南北院区信息化改造升级结果公告(网址:

[https://www.ccgp.gov.cn/cggg/zygg/zbgg/202510/t20251013\\_25492020.htm](https://www.ccgp.gov.cn/cggg/zygg/zbgg/202510/t20251013_25492020.htm))

中山大学孙逸仙纪念医院集团化多院区信息系统建设(二期)项目之南北院区信息化改造升级 (0809-25411GJG303012501) 中标公告

- 一、项目编号: 0809-25411GJG303012501
- 二、项目名称: 中山大学孙逸仙纪念医院集团化多院区信息系统建设(二期)项目之南北院区信息化改造升级
- 三、中标(成交)供应商: 广东银基信息技术有限公司
- 四、中标(成交)金额: 14,050,100.00元

五、主要标的情况

序号	标的名称	品牌	规格	数量	单价	总价
1	中山大学孙逸仙纪念医院集团化多院区信息系统建设(二期)项目之南北院区信息化改造升级					


- 六、评审专家(单一来源采购人员)名单: 陈伟强、陈伟强、陈伟强、陈伟强、陈伟强
- 七、代理服务收费标准及金额: 收费标准: 按中标金额的1%收取, 最高不超过10000元
- 八、代理机构名称及地址: 广东银基信息技术有限公司



对比证明:

本项目

中山大学项目

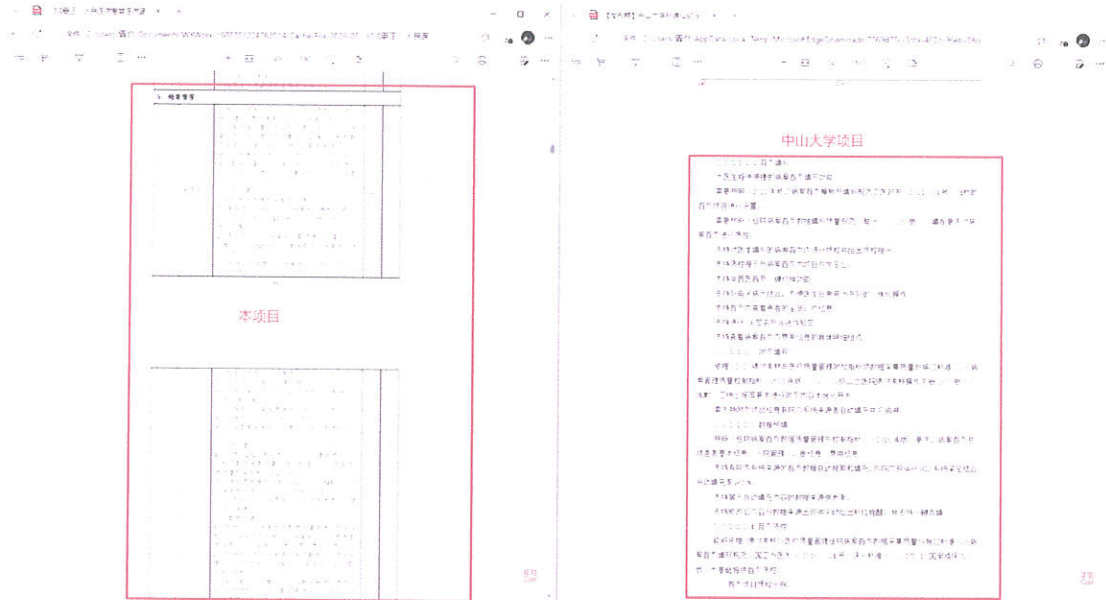

综上所述，明显属于“东华医为科技有限公司”专属定制采购需求及评分内容以不合理条件限制或者排斥潜在供应商，属于赤裸裸的暗箱操作，完全背离政府采购“公开、公平、公正”的基本原则。

法律依据：1、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：（一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；（二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；（三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；（四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；（五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；（六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；（七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；（八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

2、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第 87 号)第二十五条：“招标文件、资格预审文件的内容不得违反法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策，或者违反公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则。有前款规定情形，影响潜在投标人投标或者资格预审结果的，采购人或者采购代理机构应当修改招标文件或者资格预审文件后重新招标”。

质疑事项 2：本项目招标文件采购 PACS 系统，未设置投标产品须具备《医疗器械注册证》及对应经营、生产资质的实质性要求，招标文件存在违法违规瑕疵，违反国家强制性法律法规及政府采购相关规定。

事实依据：PACS 系统、心电系统均属于法定第二类医疗器械，依法必须取得医疗器械注册证方可销售、采购、使用。根据国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》及相关注册审查指导原则规定：医学图像存储与传输软件（PACS 系统）属于第二类医疗器械（分类编码 21-02-01）；心电系统（心电采集、分析、存储系统软件）属于医用诊疗辅助软件，归类为第二类医疗器械，纳入严格监管范畴。依据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第 739 号）第十三条、第四十五条、第五十五条强制性规定，第二类医疗器械必须依法取得医疗器械注册证，严禁采购、使用、经营未取得注册证的医疗器械，医疗机构采购的医疗器械必须为具备合法注册资质的合规产品，该要求为国家效力性强制性规定，任何采购活动必须严格遵守。

招标文件缺失医疗器械注册证及相关资质要求，属于违法采购文

件，违背政府采购法定规则。本项目采购的 PACS 系统、心电系统均属于医用第二类医疗器械，均属于国家严格监管的医用设备软件系统。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条规定，政府采购招标文件不得违反法律、行政法规的强制性规定；同时《政府采购需求管理办法》明确要求，政府采购采购需求必须符合国家法律法规、强制性标准，不得存在违法违规内容。本次招标采购标的物包含医用 PACS 系统、心电系统，均为二类医疗器械，但招标文件全程未将“投标产品具备有效医疗器械注册证、供应商具备对应生产/经营资质”列为投标实质性资格条件，默许无合规医疗器械资质的产品及供应商参与投标，直接违反《医疗器械监督管理条例》强制性规定，同时违反政府采购合规性要求，属于采购文件存在重大违法瑕疵。

证据如下：

(1) 总局关于发布医学图像存储传输软件（PACS）等 6 个医疗器械注册技术审查指导原则的通告（2016 年第 27 号）（网址：[https://www.nmpa.gov.cn/directory/web/nmpa//xxgk/ggtg/ylqxggtg/ylqxqtggtg/20160303180201483.html?f\\_link\\_type=f\\_link\\_inlinenote&flow\\_extra=eyJpbmxbmVfZGlzcGxheV9wb3NpdGlvbil6MCwiZG9jX3Bvc2l0aW9uIjowLCJkb2NfaWQiOiI5ZTg50Tc2N2I5NWRmOGYwLTNkODJhMDgxYWFjNTI1MjMifQ%3D%3D](https://www.nmpa.gov.cn/directory/web/nmpa//xxgk/ggtg/ylqxggtg/ylqxqtggtg/20160303180201483.html?f_link_type=f_link_inlinenote&flow_extra=eyJpbmxbmVfZGlzcGxheV9wb3NpdGlvbil6MCwiZG9jX3Bvc2l0aW9uIjowLCJkb2NfaWQiOiI5ZTg50Tc2N2I5NWRmOGYwLTNkODJhMDgxYWFjNTI1MjMifQ%3D%3D))



索引号 GGTG-2016-11102 主题分类  
标题 总局关于发布医学图像存储传输软件（PACS）等6个医疗器械注册技术审查指导原则的公告（2016年第27号）  
发布日期 2016-03-03

### 总局关于发布医学图像存储传输软件（PACS）等6个医疗器械注册技术审查指导原则的公告（2016年第27号）

为加强医疗器械产品注册工作的监督和引导，进一步提高注册审查质量，国家食品药品监督管理总局组织制定了医学图像存储传输软件（PACS）、正压通气治疗机、大型蒸汽灭菌器、腹腔镜折机、医用内窥镜冷光源、振动冲击治疗机等6个医疗器械注册技术审查指导原则（见附件），现予发布。

- 特此公告。
- 附件：1.医学图像存储传输软件（PACS）注册技术审查指导原则  
2.正压通气治疗机注册技术审查指导原则  
3.大型蒸汽灭菌器注册技术审查指导原则  
4.腹腔镜折机注册技术审查指导原则  
5.医用内窥镜冷光源注册技术审查指导原则  
6.振动冲击治疗机注册技术审查指导原则

- #12016年第27号通告附件1.doc
- #12016年第27号通告附件2.doc
- #12016年第27号通告附件3.doc
- #12016年第27号通告附件4.doc
- #12016年第27号通告附件5.doc
- #12016年第27号通告附件6.doc

食品药品监管总局  
2016年2月26日



#### 附件1

#### 医学图像存储传输软件（PACS）注册技术审查指导原则

本指导原则旨在规范注册申请，对医学图像存储传输软件（PACS）注册申请的相关要求进行指导和规范，供注册申请人参考。

本指导原则所称医学图像存储传输软件（PACS）是指由计算机、网络、数据库、存储设备等组成的，用于医学图像的存储、传输、显示、处理、打印、检索、管理等工作的软件系统。

本指导原则所称医学图像存储传输软件（PACS）是指由计算机、网络、数据库、存储设备等组成的，用于医学图像的存储、传输、显示、处理、打印、检索、管理等工作的软件系统。

本指导原则所称医学图像存储传输软件（PACS）是指由计算机、网络、数据库、存储设备等组成的，用于医学图像的存储、传输、显示、处理、打印、检索、管理等工作的软件系统。

本指导原则所称医学图像存储传输软件（PACS）是指由计算机、网络、数据库、存储设备等组成的，用于医学图像的存储、传输、显示、处理、打印、检索、管理等工作的软件系统。

本指导原则所称医学图像存储传输软件（PACS）是指由计算机、网络、数据库、存储设备等组成的，用于医学图像的存储、传输、显示、处理、打印、检索、管理等工作的软件系统。

本指导原则所称医学图像存储传输软件（PACS）是指由计算机、网络、数据库、存储设备等组成的，用于医学图像的存储、传输、显示、处理、打印、检索、管理等工作的软件系统。

## 《医疗器械分类目录》（网址：

<https://www.nmpa.gov.cn/wwwroot/gyx02302/flm1.htm>)

**医疗器械分类目录**

**6870 软件**

序号	名称	备注	管理类别
1	功能评价软件	1.物理评价的辅助软件系统 超声测时软件系统、 放射治疗计划系统、	Ⅱ
2	诊断图像处理软件	医学图像数据库、 1.射线图像数据库、 2.射线计算机断层扫描设备图像数据库、 3.医学内部参考系统 (crms)、 医学学系统 医学图像检索系统	Ⅱ
		CT/MR 图像分析系统 图像分析系统 红外热像处理 医学影像工作站、 超声三维成像系统、 超声仪	Ⅱ
3	诊断辅助决策软件	24小时连续动态心电图分析系统 24小时连续动态心电图分析系统 超声仪	Ⅱ
		脑电(脑电)分析系统 睡眠监测系统、 脑电波谱处理软件 激光(激光)分析仪、激光光谱检测 及数据管理软件	
4	影像数据存取、处理系统软件	PACS 远程诊断	Ⅱ
5	医学影像学数据库		Ⅱ

**(2) 采购需求要求:**

1. 采购需求要求...

2. 采购需求要求...

3. 采购需求要求...

4. 采购需求要求...

5. 采购需求要求...

6. 采购需求要求...

7. 采购需求要求...

8. 采购需求要求...

9. 采购需求要求...

10. 采购需求要求...

11. 采购需求要求...

12. 采购需求要求...

13. 采购需求要求...

14. 采购需求要求...

15. 采购需求要求...

16. 采购需求要求...

17. 采购需求要求...

18. 采购需求要求...

19. 采购需求要求...

20. 采购需求要求...

21. 采购需求要求...

22. 采购需求要求...

23. 采购需求要求...

24. 采购需求要求...

25. 采购需求要求...

26. 采购需求要求...

27. 采购需求要求...

28. 采购需求要求...

29. 采购需求要求...

30. 采购需求要求...

31. 采购需求要求...

32. 采购需求要求...

33. 采购需求要求...

34. 采购需求要求...

35. 采购需求要求...

36. 采购需求要求...

37. 采购需求要求...

38. 采购需求要求...

39. 采购需求要求...

40. 采购需求要求...

41. 采购需求要求...

42. 采购需求要求...

43. 采购需求要求...

44. 采购需求要求...

45. 采购需求要求...

46. 采购需求要求...

47. 采购需求要求...

48. 采购需求要求...

49. 采购需求要求...

50. 采购需求要求...

51. 采购需求要求...

52. 采购需求要求...

53. 采购需求要求...

54. 采购需求要求...

55. 采购需求要求...

56. 采购需求要求...

57. 采购需求要求...

58. 采购需求要求...

59. 采购需求要求...

60. 采购需求要求...

61. 采购需求要求...

62. 采购需求要求...

63. 采购需求要求...

64. 采购需求要求...

65. 采购需求要求...

66. 采购需求要求...

67. 采购需求要求...

68. 采购需求要求...

69. 采购需求要求...

70. 采购需求要求...

71. 采购需求要求...

72. 采购需求要求...

73. 采购需求要求...

74. 采购需求要求...

75. 采购需求要求...

76. 采购需求要求...

77. 采购需求要求...

78. 采购需求要求...

79. 采购需求要求...

80. 采购需求要求...

81. 采购需求要求...

82. 采购需求要求...

83. 采购需求要求...

84. 采购需求要求...

85. 采购需求要求...

86. 采购需求要求...

87. 采购需求要求...

88. 采购需求要求...

89. 采购需求要求...

90. 采购需求要求...

91. 采购需求要求...

92. 采购需求要求...

93. 采购需求要求...

94. 采购需求要求...

95. 采购需求要求...

96. 采购需求要求...


97. 采购需求要求...

98. 采购需求要求...

99. 采购需求要求...

100. 采购需求要求...



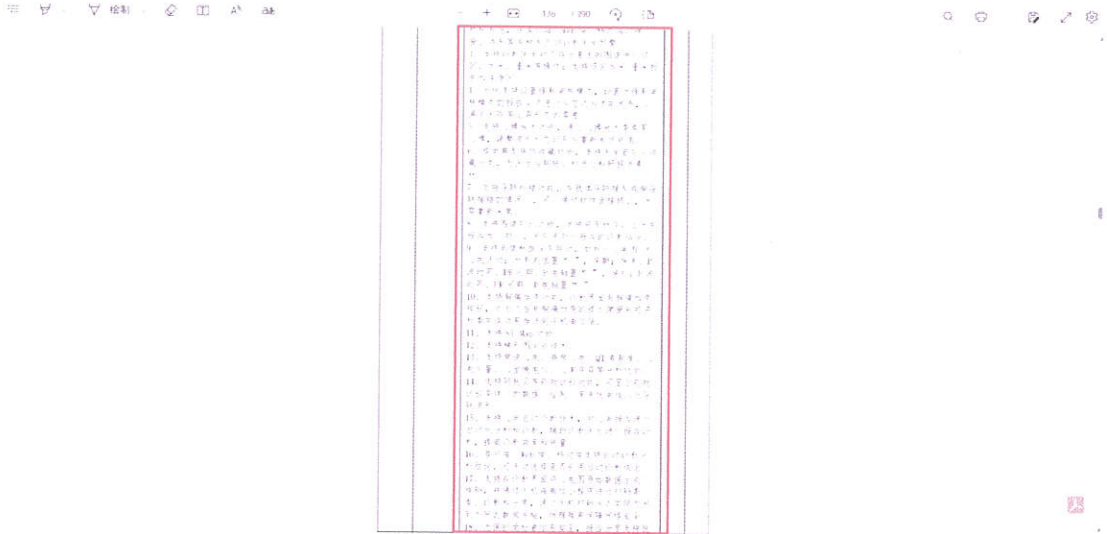


法律依据：1、《政府采购需求管理办法》第七条 采购需求应当符合法律法规、政府采购政策和国家有关规定，符合国家强制性标准，遵循预算、资产和财务等相关管理制度规定，符合采购项目特点和实际需要。

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：重新设定评审因素及评分标准，修改招标文件不合理条款，暂停采购活动，依法对采购意向予以公示。如若贵单位不能给予正面答复，我公司有权向主管部门投诉。

签字（签章）：



公章：

日期：2026年06月08日

# 质疑回复函

## 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：广西银聚海贸易有限公司

地址：南宁市金凯路 8 号龙光玖誉城组团 59 号楼十三层 1332 号办公

法定代表人：苏红

授权代表：覃海鹏

## 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：罗城仫佬族自治县人民医院智慧医院建设

质疑项目的编号：HCZC2026-G3-250019-TQGC

采购人名称：罗城仫佬族自治县人民医院

## 三、质疑答复书内容

我公司于 2026 年 6 月 6 日收到贵公司递交的由顺丰速运送达我公司的罗城仫佬族自治县人民医院智慧医院建设项目(项目编号:HCZC2026-G3-250019-TQGC)质疑函原件一份,质疑函为原件 15 页,落款日期为 2026 年 6 月 5 日。因送达日期不在工作日,根据《政府采购质疑和投诉办法》(中华人民共和国财政部令第 94 号)的规定,经我公司相关工作人员在 2026 年 6 月 8 日审查,贵公司质疑函未按《办法》第八条第二款及招标文件要求提交授权代表的授权委托书,同时未按招标文件质疑函格式要求填写招标文件获取日期。我公司已在 2026 年 6 月 8 日向贵公司发出“限期补齐补正质疑函的告知函”,同时已在第一时间将该质疑函报采购人。补正后的质疑函于 2026 年 6 月 9 日收悉,已补充授权代表的授权委托书,已补充招标文件获取日期为 2026 年 6 月 8 日,6 月 6 日针对招标文件的质疑函中招标文件的获取是否合法存疑,出于审慎原则,根据《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第 94 号)及招标文件的相关规定,对贵公司的质疑事项答复如下:

**质疑事项 1:** 第二章 采购需求-采购需求/配置说明涉嫌指定特定供应商。

事实依据:详见附件

法律依据:详见附件

**质疑事项 1 回复:** 本次招标技术参数结合采购人实际使用场景、功能要求、运维需求、系统兼容性、系统对接、日常管理、行业合规性需求进行编

制，主要参考了国家卫生健康委员会发布的《电子病历应用管理规范》《医院信息系统基本功能规范》等标准规范，同时参考借鉴了其它医院同类项目的成功案例的参数表述，同类项目已顺利落地，得到了监管部门的审计认可，代表了其法律法规的合规性。

据市场调研，目前国内有不少于三家品牌产品能满足以上要求，并非某一特定厂商所独有的技术壁垒，并不具有排他性、倾向性。

综上，以上参数要求不构成对特定供应商或特定产品的指向，不存在对其他投标人实行差别待遇或歧视待遇，质疑事项不成立。

**事实依据：**

据市场调研，目前国内有不少于三家品牌产品能满足以上要求，并非某一特定厂商所独有的技术壁垒，并不具有排他性、倾向性。

**法律依据：**

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十一条及《政府采购需求管理办法》第七条、第九条的规定，科学合理地确定采购需求是采购人的法定权利和职责，采购需求可以依据项目实际需要设置相应的技术指标，满足招标文件要求的厂商有多家，参数要求合理。

**质疑事项 2：**本项目招标文件采购 PACS 系统，未设置投标产品须具备《医疗器械注册证》及对应经营、生产资质的实质性要求，招标文件存在违法违规瑕疵，违反国家强制性法律法规及政府采购相关规定。

事实依据：详见附件。

法律依据：详见附件。

**质疑事项 2 回复：**本项目不涉及医疗器械采购，也不是相关医疗器械的本机系统，不适用《医疗器械分类目录》分类中的“6870 软件”，质疑事项不成立。

**事实依据：**

1、采购人现有 PACS 系统均为合法合规采购并正常投产。本次采购仅针对已上线系统进行技术升级、功能优化或开发、现有问题的整改等服务，不涉及医疗器械生产、经营、注册、备案及首次应用等环节。由于本项目涉及在用系统互联互通及信息化现状，允许潜在投标人踏勘，潜在投标人应充分理解采购需求。本项采购属于系统升级服务，并非全新医疗器械产品采购，完全符合《政府采购



法》及其实施条例相关要求。

2、结合现行《医疗器械分类目录》6870 软件类目规定“24 小时全信息动态心电分析系统”明确属于第二类医疗器械。本项目采购的是医院信息化管理工具，不涉及医疗器械采购，也不是相关医疗器械的本机系统，不适用《医疗器械分类目录》分类中“6870 软件”。经核查，目录中无“心电系统”、“心电采集、分析、存储系统软件”、“诊疗辅助软件”条目。同时目前并无针对心电系统的注册审查指导原则。

法律依据：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条 采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

.....

(二) 设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；

.....

四、综合结论

综上所述，贵公司提出的质疑事项 1、质疑事项 2 均缺乏充分的事实依据和法律依据，质疑事项均不成立。

感谢贵公司对我们工作的关注和监督。如贵公司对本质疑答复不满意，可以根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）的规定，在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门提起投诉。

采购代理机构：天勤工程咨询有限公司

2026 年 6 月 15 日

附件：质疑函

