

关于博白县妇幼保健院医疗设备采购
(项目编号: YLZC2026-G1-230032-GXCL)

质疑函的答复

质疑供应商: 广西骏辰商贸有限公司

地址: 南宁市金凯路 11 号荣港城仓储二期 1 号仓库 2
楼 206 号

联系人: 林振宇 联系电话: 17776650681

邮编: 530031

广西骏辰商贸有限公司:

我公司于 2026 年 4 月 3 日收到贵公司现场递交方式送达的关于博白县妇幼保健院医疗设备采购(项目的编号: YLZC2026-G1-230032-GXCL)的质疑函原件, 对此十分重视, 经与采购人协商并经核实, 现对贵公司质疑事项答复如下:

一、质疑事项(1): “1 分标: 11. 婴儿辐射保暖台参数招标参数: ◆12. 内置气泡水平仪, 用于确定床体是否水平, 事实依据: 此参数对床体倾斜功能进行了描述..... 建议医院及招标公司删除, 让其他国产品牌能够参与”

答复: 关于贵公司对该项内容技术参数问题的异议, 我公司将对相应内容进行修改。根据桂财采[2026]50 号文, 广西政采云平台系统升级期间暂停所有服务。待系统恢复正常后我司将会发布相关内容的更正公告, 请关注后续的相关信息。

二、质疑事项(2): “1 分标: 11 . 婴儿辐射保暖台参数

招标参数：◆13. 内置穿刺灯，光亮强度 4500LUX,方便随时检查婴儿状况，事实依据：此参数对辐射台的照明灯以及强度进行了描述.....建议医院及招标公司修改成‘具有照明灯，方便随时检查婴儿状况’，让其他国产品牌能够参与”

答复：关于贵公司对该项内容技术参数问题的异议，我公司将对相应内容进行修改。根据桂财采[2026]50号文，广西政采云平台系统升级期间暂停所有服务。待系统恢复正常后我司将会发布相关内容的更正公告，请关注后续的相关信息。

三、质疑事项(3)：“1分标：11. 婴儿辐射保暖台参数招标参数：◆15. 婴儿床下内置 X 线托盘，可直接进行 X 线拍片.....中断对婴儿的辐射热。事实依据：此参数对辐射加热器进行了描述.....可直接进行 X 线拍片让其他国产品牌能够参与”

答复：本项参数为保障新生儿拍片时持续保暖、避免低体温风险的必需设计。我司经过市场调研，满足该项要求的国产品牌不少于三家，并不是某个品牌特有的参数，不存在排他性。故质疑不成立。

四、质疑事项(4)：“1分标：12 婴儿转运培养箱参数招标参数：◆4. 内置可充电电池，连续工作时间 ≥ 7 小时，事实依据：此参数对内置电池的工作时间进行了描述.....建议医院及招标公司删除此条参数，或修改成‘内置可充电电池，连续工作时间 ≥ 3 小时’让其他国产品牌能够参与”

答复：本项内置可充电电池续航时间 ≥ 7 小时，是为满足

本院新生儿院内转运、急诊抢救、突发停电应急保障的实际临床需求设置，符合新生儿安全转运规范要求。经市场调研，满足本项要求的国内合格品牌不少于三家，不属于特定品牌独有技术，未指向特定供应商、特定产品，不存在倾向性、排他性及不合理限制情形。根据《政府采购法实施条例》第二十条规定，质疑缺乏事实与法律依据，质疑不成立。

五、质疑事项(5)：“1分标：12 婴儿转运培养箱参数
招标参数：2. 肤温测量范围：0° C~70° C，测量精度：±0.2° C.....此参数对肤温测量范围进行了描述限制.....建议医院及招标公司删除此条参数，或修改成肤温测量范围：20° C~40° C，测量精度：±0.2° C.....”

答复：关于贵公司对该项内容技术参数问题的异议，我公司将对相应内容进行修改。根据桂财采[2026]50号文，广西政采云平台系统升级期间暂停所有服务。待系统恢复正常后我司将会发布相关内容的更正公告，请关注后续的相关信息。

六、质疑事项(6)：“1分标：13 新生儿黄疸治疗箱参数
招标参数：4. 箱温和肤温测量范围：5° C~70° C，事实依据：此参数对肤温测量范围进行了描述.....建议医院及招标公司删除此条参数，或修改成肤温测量范围：20° C~40° C”.....”

答复：关于贵公司对该项内容技术参数问题的异议，我公司将对相应内容进行修改。根据桂财采[2026]50号文，广

西政采云平台系统升级期间暂停所有服务。待系统恢复正常后我司将会发布相关内容的更正公告，请关注后续的相关信息。

七、质疑事项(7)：“1分标：13 新生儿黄疸治疗箱参数招标参数：9.支持腔内体温探头，更接近人体核心体温，准确度更高，事实依据：此参数对体温探头进行了描述.....建议医院及招标公司删除此条参数，让其他国产品牌能够参与”

答复：本项支持腔内体温探头，可更准确监测新生儿核心体温，符合NICU重症救治与安全监测要求，为临床必需配置。经市场调研，满足本项要求的国内合格品牌不少于三家，不属于特定品牌独有技术，未指向特定供应商、特定产品，不存在倾向性、排他性及不合理限制情形。根据《政府采购法实施条例》第二十条规定，质疑缺乏事实与法律依据，质疑不成立。

八、质疑事项(8)：“1分标：13 新生儿黄疸治疗箱参数招标参数：12.具有加湿系统清洁功能，可以实现一键自清洁.....对加湿系统功能进行了描述.....具有明显的倾向性，建议医院及招标公司删除此条参数，让其他国产品牌能够参与”

答复：关于贵公司对该项内容技术参数问题的异议，我公司将对相应内容进行修改。根据桂财采[2026]50号文，广西政采云平台系统升级期间暂停所有服务。待系统恢复正常后我司将会发布相关内容的更正公告，请关注后续的相关信息

息。

九、质疑事项(9):“1分标:13新生儿黄疸治疗箱参数招标参数:15.新生儿呼吸暂停监测与呼吸暂停唤醒功能.....此参数属于监护仪的功能参数.....建议医院及招标公司删除此条参数,让其他国产品牌能够参与”

答复:关于贵公司对该项内容技术参数问题的异议,我公司将对相应内容进行修改。根据桂财采[2026]50号文,广西政采云平台系统升级期间暂停所有服务。待系统恢复正常后我司将会发布相关内容的更正公告,请关注后续的相关信息。

十、质疑事项(10):“:1分标:13新生儿黄疸治疗箱参数 21.床垫倾斜功能:支持婴儿床倾斜角度电动无级调节,床面倾斜无需打开箱门,床面最大倾斜角度不小于12°事实依据:此参数对倾斜功能进行了描述.....建议医院及招标公司删除此条参数,或修改成“床垫倾斜功能:床面倾斜无需打开箱门,床面最大倾斜角度不小于12°让其他国产品牌能够参与”

答复:本项参数为新生儿体位管理、胃食管反流防护、临床护理安全的必要功能设置,符合新生儿诊疗规范。经市场调研,满足本项要求的国内合格品牌不少于三家,不属于特定品牌独有技术,未指向特定供应商、特定产品,不存在倾向性、排他性及不合理限制情形。根据《政府采购法实施条例》第二十条规定,质疑缺乏事实与法律依据,质疑不成立。

十一、质疑事项(11):“1分标:13新生儿黄疸治疗箱参数招标参数:内置白光观察灯:事实依据:此参数上黄疸治疗装置的功能进行了描述,.....具有明显的倾向性,建议医院及招标公司删除此条参数,让其他国产品牌能够参与”

答复:本项内置白光观察灯为新生儿黄疸观察、皮肤状况评估、临床护理操作的通用必需配置,符合临床使用规范。经市场调研,满足本项要求的国内合格品牌不少于三家,不属于特定品牌独有技术,未指向特定供应商、特定产品,不存在倾向性、排他性及不合理限制情形。根据《政府采购法实施条例》第二十条规定,质疑缺乏事实与法律依据,质疑不成立。

十二、质疑事项(12):“1分标:13新生儿黄疸治疗箱参数招标参数:下蓝光治疗装置:1.光源:LED,支持高、中、低三档可调,光源使用寿命 ≥ 50000 小时。事实依据:此参数对下蓝光治疗装置的功能进行了描述.....建议医院及招标公司删除此条参数,或修改成‘下蓝光治疗装置:1.光源:LED,光源使用寿命 ≥ 50000 小时’让其他国产品牌能够参与”

答复:本项蓝光治疗装置采用LED光源且支持高、中、低三档可调,可根据新生儿日龄、胆红素水平精准控制光照强度,保障治疗安全有效,属于临床必需功能。经市场调研,满足本项要求的国内合格品牌不少于三家,不属于特定品牌独有技术,未指向特定供应商、特定产品,不存在倾向性、

排他性及不合理限制情形。根据《政府采购法实施条例》第二十条规定，质疑缺乏事实与法律依据，质疑不成立。

十三、质疑事项(13):“1分标:14 婴儿培养箱招标参数:4.箱温和肤温测量范围:5°C~70°C.....此参数对肤温测量范围进行了描述.....建议医院及招标公司删除此条参数,或修改成‘肤温测量范围:20°C~40°C’让其他国产品牌能够参与”

答复:关于贵公司对该项内容技术参数问题的异议,我公司将对相应内容进行修改。根据桂财采[2026]50号文,广西政采云平台系统升级期间暂停所有服务。待系统恢复正常后我司将会发布相关内容的更正公告,请关注后续的相关信息。

十四、质疑事项(14):“1分标:14 婴儿培养箱参数招标参数:9.支持腔内体温探头,更接近人体核心体温.....此参数对体温探头进行了描述.....建议医院及招标公司删除此条参数,让其他国产品牌能够参与”

答复:本项支持腔内体温探头,可更准确监测新生儿核心体温,符合NICU重症救治与安全监测要求,为临床必需配置。经市场调研,满足本项要求的国内合格品牌不少于三家,不属于特定品牌独有技术,未指向特定供应商、特定产品,不存在倾向性、排他性及不合理限制情形。根据《政府采购法实施条例》第二十条规定,质疑缺乏事实与法律依据,质疑不成立。

十五、质疑事项(15):“1分标:14 婴儿培养箱参

数招标参数：12. 具有加湿系统清洁功能，可以实现一键自清洁.....此参数对加湿系统功能进行了描述.....建议医院及招标公司删除此条参数，让其他国产品牌能够参与”

答复：关于贵公司对该项内容技术参数问题的异议，我公司将对相应内容进行修改。根据桂财采[2026]50号文，广西政采云平台系统升级期间暂停所有服务。待系统恢复正常后我司将会发布相关内容的更正公告，请关注后续的相关信息。

十六、质疑事项(16)：“1分标：14 婴儿培养箱参数招标参数：内置白光观察灯.....此参数对上黄疸治疗装置的功能进行了描述.....建议医院及招标公司删除此条参数，让其他国产品牌能够参与”

答复：本项内置白光观察灯为新生儿黄疸观察、皮肤状况评估、临床护理操作的通用必需配置，符合临床使用规范。经市场调研，满足本项要求的国内合格品牌不少于三家，不属于特定品牌独有技术，未指向特定供应商、特定产品，不存在倾向性、排他性及不合理限制情形。根据《政府采购法实施条例》第二十条规定，质疑缺乏事实与法律依据，质疑不成立。

十七、质疑事项(17)：“1分标：14 婴儿培养箱参数招标参数：下蓝光治疗装置：1. 光源：LED，支持高、中、低三档可调.....此参数对下黄疸治疗装置的功能进行了描述.....建议医院及招标公司删除此条参数，或修改成‘下蓝光治疗装置：◆1. 光源：LED，光源使用寿命≥50000小

时’让其他国产品牌能够参与”


答复：本项蓝光治疗装置采用 LED 光源且支持高、中、低三档可调，可根据新生儿日龄、胆红素水平精准控制光照强度，保障治疗安全有效，属于临床必需功能。经市场调研，满足本项要求的国内合格品牌不少于三家，不属于特定品牌独有技术，未指向特定供应商、特定产品，不存在倾向性、排他性及不合理限制情形。根据《政府采购法实施条例》第二十条规定，质疑缺乏事实与法律依据，质疑不成立。

十八、质疑事项(18)：“1分标：14 婴儿培养箱参数招标参数：下蓝光治疗装置：1.光源：LED，支持高、中、低三档可调，光源使用寿命 ≥ 50000 小时。事实依据：此参数对下黄疸治疗装置的功能进行了描述.....建议医院及招标公司删除此条参数，或修改成‘下蓝光治疗装置：◆1.光源：LED,光源使用寿命 ≥ 50000 小时’让其他国产品牌能够参与”

答复：本项蓝光治疗装置采用 LED 光源且支持高、中、低三档可调，可根据新生儿日龄、胆红素水平精准控制光照强度，保障治疗安全有效，属于临床必需功能。经市场调研，满足本项要求的国内合格品牌不少于三家，不属于特定品牌独有技术，未指向特定供应商、特定产品，不存在倾向性、排他性及不合理限制情形。根据《政府采购法实施条例》第二十条规定，质疑缺乏事实与法律依据，质疑不成立。

十九、质疑事项(19)：“1分标：14 婴儿培养箱箱参数招标参数：15.新生儿呼吸暂停监测与呼吸暂停唤醒功能：

立
印
挂
文

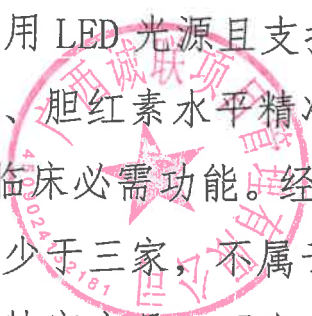

事实依据：此参数属于监护仪的功能参数.....建议医院及招标公司删除此条参数，让其他国产品牌能够参与”

答复：关于贵公司对该项内容技术参数问题的异议，我公司将对相应内容进行修改。根据桂财采[2026]50号文，广西政采云平台系统升级期间暂停所有服务。待系统恢复正常后我司将会发布相关内容的更正公告，请关注后续的相关信息。

二十、质疑事项(20)：“招标文件要求：技术参数中‘◆’参数每负偏一项扣6分，最多扣30分.....具有严重的指向性、排他性，不公平不公正.....以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人”

答复：本项目采购需求严格按照临床实际需求、国家医疗设备技术规范及妇幼保健院建设标准制定，技术参数均为保障新生儿急救、护理、治疗安全有效的必需条件，与项目特点和实际需要完全适配。招标文件中“◆”为评分参考指标，并非实质性条款，评分规则统一、公平、公开，适用于所有投标人，不存在指向特定供应商、特定产品，也不存在以不合理条件限制或排斥潜在投标人的情形。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十五条规定，质疑不成立。

感谢贵公司对本项目采购活动的监督与支持！我公司将把有关情况向同级政府采购监督管理部门备案。

特此复函。

广西诚联项目管理有限公司

2026年4月15日

