



## 响 应 文 件

项目编号：LZZC2026-J1-990664-GXDD

项目名称：全自动核酸检测系统和生物安全柜采购项目（重）

分标（如有）：分标 1

供应商名称：广州前师科技有限公司

2026 年 09 月 27 日



## 资 格 证 明 文 件

项目名称：全自动核酸检测系统和生物安全柜采购项目（重）

项目编号：LZZC2026-J1-990664-GXDD

分标（如有）：分标 1

供应商名称：广州前师科技有限公司

2026 年 09 月 27 日

## 资格证明文件目录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 一、 供应商合法的主体资格证明 .....        | 3  |
| 二、 法定代表人身份证明 .....           | 4  |
| 三、 法定代表人授权委托书 .....          | 5  |
| 四、 供应商有效的医疗器械生产或经营相关证明 ..... | 6  |
| 五、 政府采购供应商资格信用承诺函 .....      | 8  |
| 六、 供应商直接控股股东信息表 .....        | 9  |
| 七、 供应商直接管理关系信息表 .....        | 10 |
| 八、 竞标声明 .....                | 11 |
| 九、 信用证明截图 .....              | 12 |
| 十、 厂家证件 .....                | 13 |
| 十一、 产品授权书 .....              | 24 |
| 十二、 产品备案凭证或注册证 .....         | 26 |



一、 供应商合法的主体资格证明

|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                          |  |   |  |
| 编号: S2512025018703G(1-1)                                                                                                                                                                                   |  | 扫描二维码登录<br>“国家企业信用<br>信息公示系统”<br>了解更多登记、<br>备案、许可、监<br>管信息。                          |  |
| 统一社会信用代码<br>91440118MAEGN3U28E                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| 营 业 执 照<br>(副 本)                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                      |  |
| 称 广 州 前 师 科 技 有 限 公 司                                                                                                                                                                                      |  | 注 册 资 本 贰 佰 万 元 (人 民 币)                                                              |  |
| 类 型 有 限 责 任 公 司 (自 然 人 独 资 )                                                                                                                                                                               |  | 成 立 日 期 2025年04月03日                                                                  |  |
| 法 定 代 表 人 计 玉 花                                                                                                                                                                                            |  | 住 所 广 州 市 增 城 区 永 宁 街 凤 凰 北 横 路 206 号 1315 房                                         |  |
| 经 营 范 围 科 技 推 广 和 应 用 服 务 业 (具 体 经 营 项 目 请 登 录 国 家 企 业 信 用 信 息 公 示 系 统 查 询 , 网 址 : <a href="http://www.gsxt.gov.cn/">http://www.gsxt.gov.cn/</a> 。 依 法 须 经 批 准 的 项 目 , 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 。 ) |  | 登 记 机 关                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | 2025 年 04 月 03 日                                                                     |  |

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制



## 二、法定代表人身份证明

### 法定代表人身份证明书



供 应 商：广州前师科技有限公司

地 址：广州市增城区永宁街凤凰北横路 206 号 1315 房

姓 名：计玉花 性 别：女

年 龄：65 岁 职 务：董事长

系广州前师科技有限公司（供应商单位名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效正反面身份证



供应商名称（电子公章）：广州前师科技有限公司

2026 年 09 月 27 日

### 三、法定代表人授权委托书

#### 法定代表人授权委托书

致：柳州市疾病预防控制中心、广西大德项目管理有限公司（招标采购单位、代理机构名称）：

我 计玉花（姓名）系广州前师科技有限公司（供应商名称）的法定代表人，现授权委托刘真君（姓名）以我方的名义参加全自动核酸检测系统和生物安全柜采购项目（重）项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字或者电子签名或者加盖电子印章事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附件：委托代理人有效正反面身份证



法定代表人（签字或者电子签名或者加盖电子印章）：计玉花

委托代理人（签字或者电子签名或者加盖电子印章）：刘真君

委托代理人身份证号码：45250219841002944X

供应商名称（电子公章）：广州前师科技有限公司

2026 年 09 月 27 日



#### 四、供应商有效的医疗器械生产或经营相关证明



## 第二类医疗器械经营备案凭证

备案编号： 粤穗药监械经营备20252874号

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 企业名称     | 广州前师科技有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 统一社会信用代码 | 91440118MAEGN3U28E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 法定代表人    | 计玉花                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 企业负责人    | 计玉花                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 住 所      | 广州市增城区永宁街凤凰北横路206号1315房                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 经营方式     | 批发                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 经营场所     | 广州市增城区永宁街凤凰北横路206号1315房                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 库房地址     | 委托广东通昶医药物流有限公司储运                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 经营范围     | 2002年分类目录：<br>6801, 6802, 6803, 6804, 6805, 6806, 6807, 6808, 6809<br>, 6810, 6812, 6813, 6815, 6816, 6820, 6821, 6822, 68<br>23, 6824, 6825, 6826, 6827, 6828, 6830, 6831, 6832,<br>6833, 6834, 6840（体外诊断试剂除外），6840（诊断试剂<br>需低温冷藏运输贮存），<br>6841, 6845, 6846, 6854, 6855, 6856, 6857, 6858, 6863<br>, 6864, 6865, 6866, 6870, 6877**<br>2017年分类目录：<br>01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14,<br>15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6840体外诊断试剂** |

备案部门（公章）：

备案日期： 2025年06月11日







# 医疗器械经营许可证



许可证编号：粤穗药监械经营许20250735号

统一社会信用代码：91440118MAE6GN3U28E

企业名称：广州前师科技有限公司

法定代表人：计玉花

住所：广州市增城区永宁街凤凰北横路206号1315房

企业负责人：计玉花

经营场所：广州市增城区永宁街凤凰北横路206号1315房

经营方式：批发

库房地址：委托广东通和医药物流有限公司储运

经营范围：

2002年分类目录：6801, 6802, 6803, 6804, 6805, 6806, 6807, 6808, 6809, 6810, 6812, 6813, 6815, 6816, 6820, 6821, 6822 (角膜接触镜及其护理用液除外), 6823, 6824, 6825, 6826, 6827, 6828, 6830, 6831, 6832, 6833, 6834, 6840 (体外诊断试剂需低温冷藏运输贮存), 6841, 6845, 6846, 6854, 6855, 6856, 6857, 6858, 6863, 6864, 6865, 6866, 6870, 6877\*\*  
2017年分类目录：01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 16 (角膜接触镜及其护理用液除外), 17, 18, 20, 21, 22, 6840  
体外诊断试剂\*\*

许可期限：自 2025 年 06 月 05 日  
至 2030 年 06 月 04 日

发证部门：广州市市场监督管理局  
发证日期：2025 年 06 月 05 日





## 五、政府采购供应商资格信用承诺函

### 政府采购供应商资格信用承诺函



致：柳州市疾病预防控制中心、广西大德项目管理有限公司（采购人名称）、（代理机构名称）：

我方自愿参加全自动核酸检测系统和生物安全柜采购项目（重）项目（项目编号：LZZC2026-J1-990664-GXDD）的政府采购活动，并郑重承诺我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

我方保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

**特此声明！**

供应商名称（电子公章）：广州前师科技有限公司  
法定代表人或委托代理人（签字或者电子签名或者加盖电子印章）：刘复君

2026年09月27日

六、供应商直接控股股东信息表

供应商直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码    | 备注 |
|----|----------|------|--------------------|----|
| 1  | 计玉花      | 100% | 452502196102120541 |    |

注：

- 1. 直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
- 2. 本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
- 3. 供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

供应商名称（电子公章）：广州前师科技有限公司  
法定代表人或委托代理人（签字或者电子签名或者加盖电子印章）：刘真君

2026 年 09 月 27 日

七、供应商直接管理关系信息表

供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
|----|------------|----------|----|
| 1  | 无          | 无        |    |

注：

- 1. 管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
- 2. 本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
- 3. 供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

供应商名称（电子公章）：广州前师科技有限公司  
法定代表人或委托代理人（签字或者电子签名或者加盖电子印章）：刘真君

2026 年 09 月 27 日



## 八、竞标声明

### 竞标声明

致：柳州市疾病预防控制中心（采购人名称）：

我方广州前师科技有限公司（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址广州市增城区永宁街凤凰北横路 206 号 1315 房。

我方愿意参加贵方组织的全自动核酸检测系统和生物安全柜采购项目（重）（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。  
2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 在此，我方宣布同意如下：

- (1) 将按谈判文件的约定履行合同责任和义务；
- (2) 已详细审查全部谈判文件，包括补遗文件（如有）；
- (3) 同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；
- (4) 响应谈判文件规定的竞标有效期。

4. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- (1) 具有独立承担民事责任的能力；
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (6) 法律、行政法规规定的其他条件。

5. 我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

☒ 我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

☐ 我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：\_\_\_\_\_；

7. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：广州市增城区永宁街凤凰北横路 206 号 1315 房 邮政编号：511340

电话/传真：13481079867 电子函件：gzqskj2025@163.com

开户银行：中信银行股份有限公司广州凤凰城支行 帐号/行号：8110901012301878089/302581044568

8. 以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

供应商名称（电子公章）：广州前师科技有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或者电子签名或者加盖电子印章）：\_\_\_\_\_

2026 年 09 月 27 日

九、信用证明截图

欢迎来到信用中国

通知公告 | 网站声明



信用中国WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息

广州前师科技有限公司

搜索

信息公示

信用动态

信用立法

政策法规

信用承诺

城市信用

走进信用

广州前师科技有限公司

统一社会信用代码: 91440118MAEGN3U28E

重要提示:

1.如认为所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的,可按照信用信息异议申诉指南提出异议申诉。

2.本查询结果仅依现有数据展示相关信息,供社会参考使用。使用相关信息的单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。

3.“信用中国”网站公示信息与认定单位公示信息不一致的,以认定单位相关系统公示信息为准。

4.因篇幅有限,单类数据仅按更新程度展示前10000条信息。

异议申诉

下载信用信息报告

基础信息

|                   |            |      |                         |
|-------------------|------------|------|-------------------------|
| 法定代表人/负责人/执行事务合伙人 | 计玉花        | 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资)           |
| 成立日期              | 2025-04-03 | 住所   | 广州市增城区永宁街凤凰北横路206号1315房 |

行政管理2

诚实守信0

严重失信0

经营异常0

信用承诺0

信用评价0

司法判决0

其他0

财政部唯一指定政府采购信息网络发布媒体 国家级政府采购专业网站

网站服务热线: 400-810-1996 | 网站服务投诉: 010-63819289



中国政府采购网  
中国政府购买服务信息平台  
www.ccgp.gov.cn

首页

政采法规

购买服务

监督检查

信息公告

国际专栏

当前位置: 首页 » 政府采购严重违法失信行为记录名单 »

政府

政府采购严重违法失信行为信息记录

HTTP://WWW.CCGP.GOV.CN/

企业名称: 广州前师科技有限公司

统一社会信用代码 (或组织机构代码): 请输入统一社会信用代码 (或组织机构代码)

执法单位: 请输入执法单位

重置

查找

查询前, 请至少输入一个查询条件

| 序号                                                                                                              | 企业名称 | 统一社会信用代码 (或组织机构代码) | 企业地址 | 严重违法失信行为的具体情形 | 处罚结果 | 处罚依据 | 处罚日期 | 公布日期 | 执法单位 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|------|---------------|------|------|------|------|------|
| <div>查询结果: 政府采购严重违法失信行为记录名单中没有该企业的相关记录</div> <div>查询内容:<br/>企业名称: 广州前师科技有限公司<br/>查询时间: 2026年09月27日 22时36分</div> |      |                    |      |               |      |      |      |      |      |

提示: 本平台信息依据《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》(财办库[2014]526号)发布。如有疑问请联系具体执法单位。

版权所有 © 2026 中华人民共和国财政部

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制





# 第一类医疗器械生产备案凭证

备案编号： 粤珠食药监械生产备20180003号

|          |                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------|
| 企业名称     | 珠海丽珠试剂股份有限公司                                          |
| 统一社会信用代码 | 91440400617488114A                                    |
| 法定代表人    | 林艳                                                    |
| 企业负责人    | 林艳                                                    |
| 住 所      | 珠海市香洲区同昌路266号1栋                                       |
| 生产地址     | 珠海市香洲区同昌路266号                                         |
| 生产范围     | 2002年分类目录：6840体外诊断试剂<br>2017年分类目录：22-11, 22-13, 22-14 |

备案部门（公章）：

备案日期： 2022年8月19日



# 医疗器械生产许可证

许可证编号：粤食药监械生产许20020579号

统一社会信用代码：91440400617488114A

企业名称：珠海丽珠试剂股份有限公司

法定代表人：林艳

住所：珠海市香洲区同昌路266号1栋

企业负责人：林艳

生产地址：珠海市香洲区同昌路266号

生产范围：

旧版：II类、III类6840体外诊断试剂  
新版：III类10输血、透析和体外循环器械，II类22临床检验器械。

许可期限：自 2024年06月17日

发证部门：

至 2029年06月16日

发证日期：2024年04月02日



## 第二类医疗器械经营备案凭证

备案编号：粤珠食药监械经营备20150083号

|          |                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 企业名称     | 珠海丽珠试剂股份有限公司                                                                                                                                                                                                      |
| 统一社会信用代码 | 91440400617488114A                                                                                                                                                                                                |
| 法定代表人    | 林艳                                                                                                                                                                                                                |
| 企业负责人    | 林艳                                                                                                                                                                                                                |
| 住 所      | 珠海市香洲区同昌路266号1栋                                                                                                                                                                                                   |
| 经营方式     | 批零兼营                                                                                                                                                                                                              |
| 经营场所     | 珠海市香洲区同昌路266号1栋3层A区                                                                                                                                                                                               |
| 库房地址     | 珠海市香洲区同昌路266号2栋1层2101、2102、2103、2110；<br>珠海市香洲区同昌路266号3栋1层3104、3105、3106                                                                                                                                          |
| 经营范围     | 2002年分类目录：6821, 6822, 6824, 6833, 6840（诊断试剂不需低温冷藏运输贮存），6840（诊断试剂需低温冷藏运输贮存），<br>6841, 6845, 6854, 6857, 6858, 6864, 6866, 6870<br>2017年分类目录：<br>01, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 6840体外诊断试剂 |

备案部门（公章）：

备案日期：2023年 12月 01日





# 医疗器械经营许可证

许可证编号：

粤珠药监械经营许20250108号

企业名称：

珠海丽珠试剂股份有限公司

住所：

珠海市香洲区同昌路266号1栋

经营场所：

珠海市香洲区同昌路266号1栋3层A区

库房地址：

珠海市香洲区同昌路266号2栋1层3104、2102、2103、2110、  
珠海市香洲区同昌路266号3栋1层3105、3106

经营范围：

2002年分类目录：Ⅲ类6815注射穿刺器械、Ⅲ类6821医用激光仪器设备、Ⅲ类6823医用核素设备、Ⅲ类6840临床检验分析仪器及诊断试剂（诊断试剂不含低温冷藏运输贮存）、Ⅲ类6841体外循环及血液处理设备、Ⅲ类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、Ⅲ类6857消毒和灭菌设备及器具、Ⅲ类6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具、Ⅲ类6870软件、  
2017年分类目录：01有源手术器械、05放射治疗器械、06医用成像器械、07医用诊断和监护器械、08呼吸、麻醉和急救器械、09物理治疗器械、10输血、透析和体外循环器械、14注射输、步理和急救器械、15眼科器械、18妇产科、辅助生殖和避孕器械、21医用软件、22临床检验器械、6840体外诊断试剂

统一社会信用代码：

91440400617488114A

法定代表人：

林艳

企业负责人：

林艳

经营方式：

批零兼营

许可期限：

自 2025 年 04 月 07 日  
至 2030 年 04 月 06 日

发证部门：

珠海市市场监督管理局  
2025 年 04 月 07 日





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 9131011474929432XE

证照编号 14000000201810300009

**名称** 上海宏石医疗科技有限公司  
**类型** 有限责任公司(自然人投资或控股)  
**住所** 上海市嘉定区招贤路 1181 号 5 幢 5 层  
**法定代表人** 秦荣  
**注册资本** 人民币 3000.0000 万元整  
**成立日期** 2003 年 4 月 18 日  
**营业期限** 2003 年 4 月 18 日至 2043 年 4 月 17 日  
**经营范围** 从事一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事三类医疗器械的生产，电子产品、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械的销售。  
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】



登记机关




2018 年 10 月 30 日

企业信用信息公示系统网址: <https://www.sgs.gov.cn/notice>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



由 扫描全能王 扫描创建



中华人民共和国



医疗器械生产许可证

(副本)

许可证编号：沪药监械生产许20180972号

统一社会信用代码：9131011474929432XE

发证部门：上海市药品监督管理局

2024 年 03 月 25 日



企业名称：上海宏石医药科技有限公司

法定代表人：秦荣

企业负责人：秦荣

住所：上海市嘉定区招贤路1181号5幢5层

生产地址：上海市嘉定区招贤路1181号5幢5层

生产范围：

【原《分类目录》分类编码区】：无#  
【新《分类目录》分类编码区】：Ⅲ类  
22-05分子生物学分析设备#

许可期限：自 2024 年 06 月 04 日

至 2029 年 06 月 03 日



|                                                                                                                                                           |                         |              |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <p>变更内容:</p> <p>生产范围: 由原《分类目录》分类: Ⅲ类 6840 基因工程<br/>和生命科学仪器#; 新《分类目录》分类: Ⅲ类 6840 基因工程<br/>《分类目录》分类: 无#; 新《分类目录》分类: Ⅲ类 6840 基因工程<br/>2-05 分子生物学分析设备#; 。</p> | <p>2023 年 03 月 27 日</p> | <p>变更内容:</p> | <p>年 月 日</p> | <p>变更内容:</p> | <p>年 月 日</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|



|              |              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <p>变更内容:</p> | <p>年 月 日</p> | <p>变更内容:</p> | <p>年 月 日</p> | <p>变更内容:</p> | <p>年 月 日</p> |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

# 营业执照

统一社会信用代码

913701067059011678



济南鑫贝西生物技术有限公司  
(自然人投资或控股)

法定代表人 刘新成

注册资本 叁仟玖佰贰拾陆万元整  
成立日期 1999年09月23日  
住所 山东省济南市平阴县安城镇欧莱博智能制造产业园

经营范围  
一般项目：第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；光学仪器制造；医学研究和试验发展；专用化学产品制造（不含危险化学品）；软件开发；实验分析仪器制造；仪器仪表制造；新能源汽车整车销售；专用汽车制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备销售；电气设备销售；货物进出口；工程和技术研究和试验发展；租赁服务（不含许可类租赁服务）；仓储设备租赁服务；非居住房地产租赁；住房租赁；制冷、空调设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；畜牧机械销售；畜牧机械制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；医疗器械互联网信息服务；用于传染病防治的预防接种工程服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）



扫描市场主体身份码  
了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

登记机关

2024年12月31日



<https://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制





# 医疗器械生产许可证

许可证编号：鲁药监械生总第20130054号

统一社会信用代码：913701007059011678

企业名称：

济南鑫贝西生物技术有限公司

法定代表人：刘新成

住所：

山东省济南市平阴县安城镇欧莱博智能制造产业园  
济南市章丘明水经济开发区济王路北侧、山东省济南市平阴县安城镇欧莱博智能制造产业园、山东省菏泽市鄄城县医疗器械产业园7号车间

企业负责人：刘新成

生产地址：

2002 年分类目录：

2017 年分类目录：II 类：14 运输、护理和防护器械，15 患者承载器械，22 临床检验器械；III 类：08 呼吸、麻醉和急救器械，22 临床检验器械

许可期限：自 2024 年 10 月 09 日


至 2029 年 10 月 08 日

发证部门：山东省药品监督管理局

发证日期：2024 年 07 月 17 日







# 医疗器械经营许可证

许可证编号：

鲁济药监械经营许

20250000000000000000

企业名称：

济南鑫贝西生物技术有限公司

住所：

山东省济南市平阴县安城镇欧莱博智能制造产业园

经营场所：

山东省济南市平阴县安城镇欧莱博智能制造产业园 1 号车间办公室 101

库房地址：

山东省济南市平阴县安城镇欧莱博智能制造产业园办公楼 708、709

统一社会信用代码：

913701007059011678

法定代表人：

刘新成

企业负责人：

刘新成

经营方式：

批零兼营

经营范围：

2002 年分类目录：III 类：6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备（6822-1 角膜接触镜及护理用液除外）；6821 医用电子仪器设备；6823 医用超声仪器及有关设备；6824 医用激光仪器设备；6825 医用高频仪器设备；6830 医用 X 射线设备；6845 体外循环及血液处理设备；6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具；2017 年分类目录：III 类：01 有源手术器械，02 无源手术器械，03 神经和心血管手术器械，04 骨科手术器械，05 放射治疗器械，06 医用成像器械，07 医用诊察和监护器械，08 呼吸、麻醉和急救器械，09 物理治疗器械，10 输血、透析和体外循环器械，14 运输、护理和防护器械，17 口腔器械，18 妇产科、辅助生殖和避孕器械，21 医用软件，22 临床检验器械

许可期限：自

2025

年

12 月

25

日

发证部门：

济南市行政审批服务局

至

2030

年

12 月

24

日

发证日期：

2025 年

08 月

18 日

仅限于招标、授权或备案使用

十一、产品授权书



授权书编号: LZ20261130344

注册于珠海市香洲区同昌路266号1栋的珠海丽珠试剂股份有限公司为下述授权产品的生产厂家及一级代理商，为更好推广产品，特授权广州前师科技有限公司用我司生产及代理的产品参加全自动核酸检测系统和生物安全柜采购项目（重），采购项目编号：LZZC2026-J1-990664-GXDD的投标，全权处理投标过程中的相关事宜。

授权期限：2026年9月23日至项目结束



授权单位名称(盖章):珠海丽珠试剂股份有限公司

授权日期：2026年9月23日

附：授权投标的货物清单

| 序号 | 货物名称                               | 注册证号                                      | 型号规格                             | 品牌        | 生产企业                      |
|----|------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-----------|---------------------------|
| 1  | 全自动病毒载量检测系统（全自动医用PCR分析系统、全自动核酸提取仪） | 粤珠械备<br>20220116、国<br>械 注准<br>20183221659 | LiSafe<br>NA9600Pro<br>、SLAN-96P | 丽珠、<br>宏石 | 珠海丽珠试剂股份有限公司、上海宏石医疗科技有限公司 |

# 授

# 权

# 书



授 权 人：济南鑫贝西生物技术有限公司

被授权人：广州前师科技有限公司

我公司作为生物安全柜 的生产厂家，兹授权广州前师科技  
有限公司在处理招标单位：柳州市疾病预防控制中心 ，招标项  
目：全自动核酸检测系统和生物安全柜采购项目（重） ，招标  
编号：LZZC2026-J1-990664-GXDD ，采购生物安全柜的有关事宜  
中，使用、销售我公司生产的 生物安全柜。

（授权期限： 2026 年 9 月 17 日—— 2026 年 12 月 17 日）

公司盖章后生效。

济南鑫贝西生物技术有限公司

2026 年 9 月 17 日





## 十二、产品备案凭证或注册证



### 第一类医疗器械备案编号告知书

珠海丽珠试剂股份有限公司：

根据《医疗器械监督管理条例》《医疗器械注册与备案管理办法》《体外诊断试剂注册与备案管理办法》的相关规定，提供备案编号如下：

备案编号：粤珠械备 20220116

产品名称（产品分类名称）：全自动核酸提取仪

备案人住所：珠海市香洲区同昌路 266 号 1 栋

生产地址：珠海市香洲区同昌路 266 号

珠海市市场监督管理局  
(盖章)

日期：2022 年 11 月 04 日

本告知书仅用于备案人获取备案编号。

备案人应当确保备案资料合法、真实、准确、完整和可追溯。

已备案的医疗器械，备案信息表中登载内容及备案的产品技术要求发生变化，备案人应当向原备案部门变更备案。变更备案的，备案编号不变，不再重新发放备案编号告知书。

# 第一类医疗器械备案信息表

备案号：粤珠械备20220116

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| 备案人名称        | 珠海丽珠试剂股份有限公司                        |
| 备案人统一社会信用代码  | 91440400617488114A                  |
| 备案人住所        | 珠海市香洲区同昌路266号1栋                     |
| 生产地址         | 珠海市香洲区同昌路266号                       |
| 代理人          | /                                   |
| 代理人住所        | /                                   |
| 产品名称         | 全自动核酸提取仪                            |
| 型号/规格        | LiSafe NA9600Pro                    |
| 产品描述         | 由机械部分和电气部分组成。                       |
| 预期用途         | 适用于临床样本中核酸的提取和纯化。                   |
| 备注           |                                     |
| 备案部门<br>备案日期 | 珠海市市场监督管理局<br>备案日期：2022 年 11 月 04 日 |
| 变更情况         |                                     |

# 中华人民共和国医疗器械注册证

注册证编号：国械注准20183221659

|       |                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 注册人名称 | 上海宏石医疗科技有限公司                                                                                           |
| 注册人住所 | 上海市嘉定区招贤路1181号5幢5层                                                                                     |
| 生产地址  | 上海市嘉定区招贤路1181号5幢5层                                                                                     |
| 代理人名称 | /                                                                                                      |
| 代理人住所 | /                                                                                                      |
| 产品名称  | 全自动医用PCR分析系统                                                                                           |
| 型号、规格 | SLAN、SLAN-48P、SLAN-96S、SLAN-96P                                                                        |
| 结构及组成 | 主要由控制系统、电源系统、温控系统、检测系统、外壳部件和软件（版本号：8.2）组成。                                                             |
| 适用范围  | 基于聚合酶链式反应原理（PCR）和实时荧光监测技术，与配套的检测试剂共同使用，在临床上用于对来源于人体的核酸样本（DNA/RNA）中的被分析物进行定性、定量检测或熔解曲线检测，包括病原体和人类基因等项目。 |
| 附件    | 产品技术要求                                                                                                 |
| 其他内容  | /                                                                                                      |
| 备注    | 原注册证编号：国械注准20183401659                                                                                 |

审批部门

国家药品监督管理局

医疗器械  
注册专用章

批准日期：二〇二二年七月十四日

生效日期：二〇二三年三月二十七日

有效期至：二〇二八年三月二十六日





# 中华人民共和国医疗器械注册证

注册证编号：国械注准20143222263

|       |                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| 注册人名称 | 济南鑫物通生物技术有限公司                                                      |
| 注册人住所 | 山东省济南市平阴县安城镇欧莱博智能制造产业园                                             |
| 生产地址  | 济南市章丘明水经济开发区济王路北侧、山东省济南市平阴县安城镇欧莱博智能制造产业园                           |
| 代理人名称 | /                                                                  |
| 代理人住所 | /                                                                  |
| 产品名称  | 生物安全柜                                                              |
| 型号、规格 | BSC-1500 II A2-X                                                   |
| 结构及组成 | II级A2型生物安全柜是由柜体、前窗操作口、支撑脚及脚轮、风机、集液槽、过滤器、控制面板及紫外灯和照明光源组成。           |
| 适用范围  | II级A2型生物安全柜是具有前窗操作口的安全柜，操作者可以通过前窗操作口在安全柜内进行操作，对操作过程中的人员、产品及环境进行保护。 |
| 附件    | 产品技术要求                                                             |
| 其他内容  | /                                                                  |
| 备注    | 延续注册产品技术要求未发生变化，沿用原核发的产品技术要求。                                      |

审批部门：国家药品监督管理局

批准日期：二〇二三年六月二日

生效日期：二〇二四年四月二十八日

有效期至：二〇二九年四月二十七日



国家药品监督管理局电子证照 <https://zwfw.nmpa.gov.cn> 2023-06-07 11:53:08:008



## 报 价 商 务 技 术 文 件

项目名称：全自动核酸检测系统和生物安全柜采购项目（重）

项目编号：LZZC2026-J1-990664-GXDD

分标（如有）：分标 1

供应商名称：广州前师科技有限公司

2026 年 09 月 27 日

## 报价商务技术文件目录

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 一、 无串通竞标行为的承诺函 .....    | 32 |
| 二、 报价表 .....            | 33 |
| 三、 中小企业声明函（货物） .....    | 34 |
| 四、 中小企业声明函（供应商） .....   | 35 |
| 五、 关于符合本国产品标准的声明函 ..... | 36 |
| 六、 商务条款偏离表 .....        | 37 |
| 七、 货物配置清单 .....         | 39 |
| 八、 技术需求偏离表 .....        | 42 |
| 九、 项目实施人员一览表 .....      | 45 |
| 十、 服务方案及承诺 .....        | 46 |
| 十一、 产品彩页 .....          | 51 |





## 一、无串通竞标行为的承诺函

### 无串通竞标行为的承诺函

#### 一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1. 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
2. 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
3. 不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
4. 不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；
5. 不同供应商的响应文件相互混装；
6. 不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

#### 二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1. 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
2. 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
3. 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5. 供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；
6. 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
7. 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

三、以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

四、如违反承诺书中应遵守的内容，自愿退出本次采购活动，且3年内不得参加本系统项目采购；

五、如违反承诺书中应遵守的内容，承担终止合同的全部责任，且3年内不得参加本系统项目采购。

供应商名称（电子公章）：广州前师科技有限公司

2026年09月27日

## 二、报价表

报 价 表



单位：元

| 序号                     | 标的名称      | 商标品牌  | 规格型号                     | 生产厂家                      | 数量及单位 | 单价             | 合计        | 备注 |
|------------------------|-----------|-------|--------------------------|---------------------------|-------|----------------|-----------|----|
| 1                      | 全自动核酸检测系统 | 丽珠/宏石 | LiSafeNA9600 Pro/SLAN96P | 珠海丽珠试剂股份有限公司/上海宏石医疗科技有限公司 | 1 台   | 754000.00      | 754000.00 |    |
| 2                      | 生物安全柜     | 鑫贝西   | BSC-1500 II A2-X         | 济南鑫贝西生物技术有限公司             | 3 台   | 30000.00       | 90000.00  |    |
| 报价合计金额（大写）：人民币捌拾肆万肆仟元整 |           |       |                          |                           |       | （小写）：844000.00 |           |    |

注：

1. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章（电子公章）或者由法定代表人或者授权委托人签字（或者电子签名或者加盖电子印章），否则其响应文件作无效处理。

2. 供应商填写生产厂家、品牌、规格型号时必须如实填写，不得填写“国产、/”等模糊表述，否则竞标无效。

供应商名称（电子公章）：广州前师科技有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或者电子签名或者加盖电子印章）：刘复君

2026 年 09 月 27 日

### 三、中小企业声明函（货物）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 柳州市疾病预防控制中心 的 全自动核酸检测系统和生物安全柜采购项目（重） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 全自动核酸检测系统 LisafeNA9600Pro（标的名称），属于工业行业；制造商为珠海丽珠试剂股份有限公司（企业名称），从业人员 527 人，营业收入为 54568.0055 万元，资产总额为 97387.4229 万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 全自动核酸检测系统 SLAN96P（标的名称），属于工业行业；制造商为上海宏石医疗科技有限公司（企业名称），从业人员 58 人，营业收入为 12522 万元，资产总额为 169800 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

3. 生物安全柜（标的名称），属于工业行业；制造商为济南鑫贝西生物技术有限公司（企业名称），从业人员 236 人，营业收入为 19108.3 万元，资产总额为 56494.2 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子公章）：广州前师科技有限公司

日期：2026 年 09 月 27 日

注：

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2. 供应商须按上述格式要求如实填写《中小企业声明函》，并对该声明函的真实性负责，否则不得享受相关中小企业扶持政策；供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
3. 为方便供应商识别企业规模类型，供应商可使用工业和信息化部组织开发的中小企业规模类型自测小程序生成企业规模类型测试结果。自测小程序链接：<https://sme.miit.gov.cn/baosong/appweb/orgScale.html>。
4. 中小企业划型标准详见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。
5. 成交供应商依法享受中小企业扶持政策的，采购代理机构将在成交结果公告中公告其《中小企业声明函》。



#### 四、中小企业声明函（供应商）

##### 中小企业声明函（供应商）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）为微型（请填写：中型/小型/微型）企业。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子公章）：广州前师科技有限公司

日期：2026年09月27日

注：

1. 为方便投标人识别企业规模类型，投标人可使用工业和信息化部组织开发的中小企业规模类型自测小程序生成企业规模类型测试结果。自测小程序链接：<https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest>。

2. 中小企业划型标准详见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

## 五、关于符合本国产品标准的声明函

### 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. 全自动核酸提取仪 LisafeNA9600Pro，生产厂为 珠海丽珠试剂股份有限公司，厂址为 珠海市香洲区同昌路 266 号。全自动核酸提取仪 LisafeNA9600Pro 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 100\%$ 。全自动核酸提取仪 LisafeNA9600Pro 的（关键组件）在中国境内生产。全自动核酸提取仪 LisafeNA9600Pro 的（关键工序）在中国境内完成。

2. 全自动医用 PCR 分析系统 SLAN96P，生产厂为 上海宏石医疗科技有限公司，厂址为 上海市嘉定区招贤路 1181 号 5 幢 5 层。全自动医用 PCR 分析系统 SLAN96P 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 95\%$ 。全自动医用 PCR 分析系统 SLAN96P 的核心主机在中国境内生产。全自动医用 PCR 分析系统 SLAN96P 的应用软件在中国境内完成。

3. 生物安全柜，生产厂为 济南鑫贝西生物技术有限公司，厂址为 济南市章丘明水经济开发区济王路北侧、山东省济南市平阴县安城镇欧莱博智能制造产业园、山东省菏泽市鄄城县医疗器械产业园 7 号车间、山东省菏泽市鄄城县医疗器械产业园 33 号车间。生物安全柜 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ 。生物安全柜 的风机、过滤器在中国境内生产。生物安全柜 的组装在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：广州前师科技有限公司

日期：2026 年 09 月 27 日

注：

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6. 投标人按上述格式要求如实填写《关于符合本国产品标准的声明函》，并对该声明函的真实性负责，否则不得享受本国产品扶持政策；投标人提供的《关于符合本国产品标准的声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

7. 中标供应商依法享受本国产品扶持政策的，采购代理机构将在中标结果公告中公告其《关于符合本国产品标准的声明函》。

## 六、商务条款偏离表

### 商务条款偏离表

| 项目      | 谈判文件商务条款要求                                                                                                                                                                                                                                                      | 供应商的响应                                                                                                                                                                                                                                                                                | 偏离说明 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 质保期     | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，序号1“全自动核酸检测系统”产品质保期不得少于2年（若厂家质保期超过2年的，按厂家规定执行）、序号2“生物安全柜”产品质保期不得少于1年（若厂家质保期超过1年的，按厂家规定执行），质保期内负责上门维修服务，费用包含在报价中；质保期外终身提供优惠维修服务。                                                                                                   | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，序号1“全自动核酸检测系统”产品质保期2年（若厂家质保期超过2年的，按厂家规定执行）、序号2“生物安全柜”产品质保期1年（若厂家质保期超过1年的，按厂家规定执行），质保期内负责上门维修服务，费用包含在报价中；质保期外终身提供优惠维修服务。                                                                                                                                 | 无偏离  |
| 交付时间及地点 | 1. 交付时间：自合同签订生效之日起25日内安装调试完毕，验收合格并交付使用。<br>2. 交付地点：柳州市内采购人指定地点。                                                                                                                                                                                                 | 1. 交付时间：自合同签订生效之日起25日内安装调试完毕，验收合格并交付使用。<br>2. 交付地点：柳州市内采购人指定地点。                                                                                                                                                                                                                       | 无偏离  |
| 签订合同日期  | 自成交通知书发出之日起25日内。                                                                                                                                                                                                                                                | 自成交通知书发出之日起25日内。                                                                                                                                                                                                                                                                      | 无偏离  |
| 付款条件    | 全部货物交货、安装、调试完毕，验收合格交付使用后，采购人在10个工作日内办理财政转账手续。成交供应商在收到货款后10个工作日内开具合法有效同等金额的发票给采购人。<br>注：资金支付等事项按照《保障中小企业款项支付条例》（国务院令 第728号）、《运用政府采购政策支持柳州市中小微企业发展暂行办法》要求执行。                                                                                                      | 全部货物交货、安装、调试完毕，验收合格交付使用后，采购人在10个工作日内办理财政转账手续。成交供应商在收到货款后10个工作日内开具合法有效同等金额的发票给采购人。<br>注：资金支付等事项按照《保障中小企业款项支付条例》（国务院令 第728号）、《运用政府采购政策支持柳州市中小微企业发展暂行办法》要求执行。                                                                                                                            | 无偏离  |
| 售后服务要求  | 1. 成交供应商负责送货上门、安装、调试直至产品验收合格，负责现场培训，质保期过后终身提供优惠维修服务。<br>2. 成交供应商必须根据本项目的采购需求情况进行有针对性的应用和操作培训。所有培训涉及的费用均由成交供应商承担。<br>3. 在使用过程中发生质量问题或故障，接通知后成交供应商在2小时内响应，24小时内到达现场处理，故障处理时限不超过24小时修复。<br>4. 成交供应商提供全部产品必须是具备厂家合法销售渠道的全新合格正品。<br>5. 保修期内非采购人原因引起的质量事故成交供应商应负全部责任。 | 1. 我公司负责送货上门、安装、调试直至产品验收合格，负责现场培训，质保期过后终身提供优惠维修服务。<br>2. 我公司根据本项目的采购需求情况进行有针对性的应用和操作培训。所有培训涉及的费用均由我公司承担。<br>3. 在使用过程中发生质量问题或故障，接通知后我公司在2小时内响应，24小时内到达现场处理，故障处理时限不超过24小时修复。<br>4. 我公司提供全部产品必须是具备厂家合法销售渠道的全新合格正品。<br>5. 保修期内非采购人原因引起的质量事故我公司负全部责任。<br>6. 产品保修期内，属于所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的 | 无偏离  |




|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|          | 6. 产品保修期内,属于所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均由成交供应商负责维修,涉及的费用由成交供应商承担。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 正常使用造成的损坏均由我公司负责维修,涉及的费用由我公司承担。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| 采购标的验收标准 | <p>1. 交付验收标准依次序对照适用标准为:①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准;②符合采购文件和响应文件承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求;③货物符合国家官方合格标准。</p> <p>2. 成交供应商须确保产品为原制造商制造的全新产品,无污染,无侵权行为、无任何缺陷隐患,在中国境内可依常规安全合法使用。</p> <p>3. 采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收,必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时,由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费由成交供应商承担。</p> <p>4. 成交供应商必须依照采购文件的要求和响应文件的承诺,将产品安装并调试至正常运行的最佳状态,并完成采购人的人员培训。</p> <p>5. 采购人有权委托第三方进行履约验收,履约验收费用由成交供应商支付。供应商在竞标报价时自行考虑。</p> | <p>1. 交付验收标准依次序对照适用标准为:①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准;②符合采购文件和响应文件承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求;③货物符合国家官方合格标准。</p> <p>2. 我公司确保产品为原制造商制造的全新产品,无污染,无侵权行为、无任何缺陷隐患,在中国境内可依常规安全合法使用。</p> <p>3. 采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收,必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时,由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费由我公司承担。</p> <p>4. 我公司依照采购文件的要求和响应文件的承诺,将产品安装并调试至正常运行的最佳状态,并完成采购人的人员培训。</p> <p>5. 采购人有权委托第三方进行履约验收,履约验收费用由成交供应商支付。供应商在竞标报价时自行考虑。</p> | 无偏离 |
| 包装方式     | 按产品出厂时的包装。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 按产品出厂时的包装。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 无偏离 |
| 运输方式     | 不限。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 快递运输。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 无偏离 |
| 保险       | 产品运输中的保险由成交供应商负责。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 产品运输中的保险由成交供应商负责。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 无偏离 |
| 合同条款     | 具体内容详见竞争性谈判文件《第六章 合同文本》内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 具体内容详见竞争性谈判文件《第六章 合同文本》内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 无偏离 |

注:

1. 说明:应对照竞争性谈判文件第三章“采购需求”中的商务条款及第六章“合同文本”作明确响应,并作出偏离说明。

2. 供应商应根据自身的承诺,对照竞争性谈判文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

供应商名称(电子公章): 广州前师科技有限公司

法定代表人或委托代理人(签字或者电子签名或者加盖电子印章): 

2026年09月27日

## 七、货物配置清单

### 货物配置清单

| 序号 | 货物名称      | 数量及单位 | 品牌    | 规格型号                    | 制造商                       | 原产地   | 参数性能、指标及配置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-----------|-------|-------|-------------------------|---------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 全自动核酸检测系统 | 1 台   | 丽珠/宏石 | LiSafeNA9600Pro/SLAN96P | 珠海丽珠试剂股份有限公司/上海宏石医疗科技有限公司 | 珠海/上海 | <p>(一) 技术参数</p> <p>▲1. 设备功能: 整套系统由全自动核酸提取模块、PCR 分析仪模块以及控制软件组成, 集原管上样、核酸提取纯化、PCR 反应体系构建、PCR 板转移、板式/八联管封膜、扩增分析于一体, 从样本处理到定量结果输出分析全流程实现闭环检测, 所有实验过程无需人工干预;</p> <p>2. 检测项目: 支持 HIV RNA、HCV RNA、HBV DNA 项目核酸定量检测, 同时可扩展支持其他实验项目;</p> <p>3. 样本类型: 支持多种样本类型 (如全血、血清、血浆、咽拭子、培养液等) 提取, 可实现多种样本的总 DNA/RNA 提取;</p> <p>4. 检测原理及方法: 样本处理采用磁珠法分离核酸, 定量检测采用 PCR-荧光探针法, 支持 2 个不同的检测项目同时进行核酸提取及 PCR 扩增;</p> <p>5. 一次可装载样本量 1~96 个, 支持 5ml 样本管, 原始采血管, 1.5-5ml 离心管、冻存管上机检测;</p> <p>6. 能够在 4 小时内完成 96 个测试, 支持连续上样, 8 小时可处理 288 个测试;</p> <p>▲7. 设备内置有离心机, 可离心 8 连管/96 孔板;</p> <p>8. 8 个可独立移动的加样通道, 同时具有电容感应和压力感应方式, 具备液面探测及凝块检测探测功能;</p> <p>9. 吸头移液范围: 5-1000 <math>\mu</math>l, <math>\leq 10\mu</math>l 时移液精密度 <math>CV \leq 5\%</math>, <math>\leq 50\mu</math>l 时移液精密度 <math>CV \leq 3\%</math>, <math>\geq 50\mu</math>l 时移液精密度 <math>CV \leq 2\%</math>;</p> <p>10. 设备具有多仓物理隔离, 独立的 HEPA 空气过滤及紫外消毒等措施;</p> <p>11. 孵育模块温度范围: <math>\leq 4^{\circ}\text{C}</math> 至 <math>\geq 99^{\circ}\text{C}</math>, 升降温速度 <math>\geq 4.0^{\circ}\text{C}/\text{s}</math>, 温度精度控制 <math>\pm 0.4^{\circ}\text{C}</math>, 温度均匀性控制 <math>\pm 0.4^{\circ}\text{C}</math>, 支持热盖功能;</p> <p>12. 设备采用免维护 LED 激发光源, 配备高灵敏度光电传感器, 检测通道 4 个且波长范围涵盖</p> |

|   |       |     |     |                  |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|-------|-----|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |       |     |     |                  |  | <p>510nm-665nm, 每一反应孔独立的光纤传输;</p> <p>13. PCR 模块开放, 可独立运行各类检测项目, 具有常规变温 PCR 和高分辨溶解曲线检测分析功能, 系统自动分析扩增曲线并完成定量结果计算, 无需人工干预, 报告病毒拷贝数单位及 IU/ml 国际单位两种结果;</p> <p><b>(二) 标准配置</b></p> <p>(1) 主机 (96 通量核酸提取+96 通量 PCR) 1 套;</p> <p>(2) 外置终端工作站、不停电电源装置 (在使用过程中, 遇到断电的情况下, 须能保证设备正常运行至少 3 小时不受影响)、扫码枪、管托、彩色激光输出终端;</p> <p>(3) 至少提供 48 人份 HIV-1RNA 定量检测试剂, 48 人份 HIV-1 DNA 定量检测试剂, 48 人份 HCV RNA 定量检测试剂。成交供应商派遣工程师到现场进行性能验证, 并协助客户进行检测, 通过客户的盲样考核。</p> <p><b>(三) 其他要求</b></p> <p>(1) 能采取内标定量方式进行实验与结果分析。HIV 核酸定量检测时, 最低检测限 30IU/ml (或 20 拷贝/ml), 检测线性范围能覆盖 30IU-10<sup>7</sup> IU/ml, 检测靶标涵盖 HIV-1M 组、N 组、O 组基因型且涵盖 LTR、POL 两个基因保守区。HCV 核酸定量检测时, 最低检测限 25IU/ml (或 15 拷贝/ml), 检测线性范围能覆盖 25IU-10<sup>8</sup> IU/ml。</p> <p>(2) 每季度巡检 1 次;</p> <p>(3) 每年免费培训 ≥ 2 人次 HIV/HCV 病毒载量检测技术。</p> |
| 2 | 生物安全柜 | 3 台 | 鑫贝西 | BSC-1500 II A2-X | 济南鑫贝西生物技术有限公司                                                                      | <p><b>(一) 技术参数</b></p> <p>1. A2 型, 30%外排, 70%循环;</p> <p>2. 内部工作面宽度 1350mm;</p> <p>3. 送风和排风过滤器均采用 ULPA 高效过滤器, 对 0.12 μm 颗粒过滤效率 ≥ 99.9995%;</p> <p>4. 前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃, 即使玻璃破损, 也不会伤人, 并且生物安全柜还能正常工作;</p> <p>5. 脚踏电动、手动按键、遥控电动三种方式控制玻璃门升降, 玻璃门升降到安全操作高度时, 自动停止升降, 玻璃门升降时不直接接触玻璃门;</p> <p>6. 安全柜裸露工作区三侧壁板采用优质 304#不锈钢一体化结构, 内部可清洗部位采用 8mm 大圆角处理, 不留死角, 易于清洁;</p> <p>7. 工作台面材质为优质 304#不锈钢, 采用盆状式设计, 即使实验有</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|  |  |  |  |  |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | <p>废液溢出，也不会流入积液槽中，便于清理；</p> <p>8. 脚轮与支架一体化设计，安全柜即可通过脚轮安全移动，也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平，柜体和支架可分离，支架高度可根据实际情况订制修改；</p> <p>9. 保证柜内气密性，安全柜内加压500Pa，保持10min后气压不低于450Pa；</p> <p>10. 前窗气流隔断有设计，防止气流通过前窗侧壁及上侧进行泄露；</p> <p>11. 风机的电机当安全柜在时运行自动调整电机的速度控制，经过滤器的风压下降50%时，风机的排气量下降不超过10%；</p> <p>12. 有完善的报警系统和安全的连锁保护设计；</p> <p><b>（二）其他要求</b></p> <p>供应商须在安装调试完成后向采购人出具第三方检测机构检测合格报告。</p> |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

备注：

以上货物配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件作无效处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“报价表”一致，否则响应文件作无效处理。

供应商名称（电子公章）：广州前师科技有限公司

法定代表人或委托代理人(签字或者电子签名或者加盖电子印章)：刘复君

2026 年 09 月 27 日



## 八、技术需求偏离表

### 技术需求偏离表

| 序号 | 名称        | 谈判文件要求                                                                                                                                                                                      | 竞标响应                                                                                                                                                                                        | 偏离说明 |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | 全自动核酸检测系统 | <b>（一）技术参数</b><br><b>▲1. 设备功能：</b> 整套系统由全自动核酸提取模块、PCR 分析仪模块以及控制软件组成，集原管上样、核酸提取纯化、PCR 反应体系构建、PCR 板转移、板式/八联管封膜、扩增分析于一体，从样本处理到定量结果输出分析全流程实现闭环检测，所有实验过程无需人工干预；                                  | <b>（一）技术参数</b><br><b>▲1. 设备功能：</b> 整套系统由全自动核酸提取模块、PCR 分析仪模块以及控制软件组成，集原管上样、核酸提取纯化、PCR 反应体系构建、PCR 板转移、板式/八联管封膜、扩增分析于一体，从样本处理到定量结果输出分析全流程实现闭环检测，所有实验过程无需人工干预；                                  | 无偏离  |
|    |           | 2. 检测项目：支持 HIV RNA、HCV RNA、HBV DNA 项目核酸定量检测，同时可扩展支持其他实验项目；                                                                                                                                  | 2. 检测项目：支持 HIV RNA、HCV RNA、HBV DNA 项目核酸定量检测，同时可扩展支持其他实验项目；                                                                                                                                  | 无偏离  |
|    |           | 3. 样本类型：支持多种样本类型(如全血、血清、血浆、咽拭子、培养液等)提取，可实现多种样本的总 DNA/RNA 提取；                                                                                                                                | 3. 样本类型：支持多种样本类型(如全血、血清、血浆、咽拭子、培养液等)提取，可实现多种样本的总 DNA/RNA 提取；                                                                                                                                | 无偏离  |
|    |           | 4. 检测原理及方法：样本处理采用磁珠法分离核酸，定量检测采用 PCR-荧光探针法，支持 2 个以上不同的检测项目同时进行核酸提取及 PCR 扩增；                                                                                                                  | 4. 检测原理及方法：样本处理采用磁珠法分离核酸，定量检测采用 PCR-荧光探针法，支持 2 个不同的检测项目同时进行核酸提取及 PCR 扩增；                                                                                                                    | 无偏离  |
|    |           | 5. 一次可装载样本量 1~96 个，支持 5ml 样本管，原始采血管，1.5-5ml 离心管、冻存管上机检测；                                                                                                                                    | 5. 一次可装载样本量 1~96 个，支持 5ml 样本管，原始采血管，1.5-5ml 离心管、冻存管上机检测；                                                                                                                                    | 无偏离  |
|    |           | 6. 能够在 4 小时内完成 96 个测试，支持连续上样，8 小时处理不少于 200 个测试；                                                                                                                                             | 6. 能够在 4 小时内完成 96 个测试，支持连续上样，8 小时可处理 288 个测试；                                                                                                                                               | 无偏离  |
|    |           | ▲7. 设备内置有离心机，可离心 8 连管/96 孔板；                                                                                                                                                                | ▲7. 设备内置有离心机，可离心 8 连管/96 孔板；                                                                                                                                                                | 无偏离  |
|    |           | 8. 不少于 8 个可独立移动的加样通道，同时具有电容感应和压力感应方式，具备液面探测及凝块检测探测功能；                                                                                                                                       | 8. 8 个可独立移动的加样通道，同时具有电容感应和压力感应方式，具备液面探测及凝块检测探测功能；                                                                                                                                           | 无偏离  |
|    |           | 9. 吸头移液范围：5-1000 $\mu$ l， $\leq 10\mu$ l 时移液精密度 CV $\leq 5\%$ ， $\leq 50\mu$ l 时移液精密度 CV $\leq 3\%$ ， $\geq 50\mu$ l 时移液精密度 CV $\leq 2\%$ ；                                                 | 9. 吸头移液范围：5-1000 $\mu$ l， $\leq 10\mu$ l 时移液精密度 CV $\leq 5\%$ ， $\leq 50\mu$ l 时移液精密度 CV $\leq 3\%$ ， $\geq 50\mu$ l 时移液精密度 CV $\leq 2\%$ ；                                                 | 无偏离  |
|    |           | 10. 设备具有多仓物理隔离，独立的 HEPA 空气过滤及紫外消毒等措施；                                                                                                                                                       | 10. 设备具有多仓物理隔离，独立的 HEPA 空气过滤及紫外消毒等措施；                                                                                                                                                       | 无偏离  |
|    |           | 11. 孵育模块温度范围： $\leq 4^{\circ}\text{C}$ 至 $\geq 99^{\circ}\text{C}$ ，升降温速度 $\geq 4.0^{\circ}\text{C}/\text{s}$ ，温度精度控制 $\pm 0.4^{\circ}\text{C}$ ，温度均匀性控制 $\pm 0.4^{\circ}\text{C}$ ，支持热盖功能； | 11. 孵育模块温度范围： $\leq 4^{\circ}\text{C}$ 至 $\geq 99^{\circ}\text{C}$ ，升降温速度 $\geq 4.0^{\circ}\text{C}/\text{s}$ ，温度精度控制 $\pm 0.4^{\circ}\text{C}$ ，温度均匀性控制 $\pm 0.4^{\circ}\text{C}$ ，支持热盖功能； | 无偏离  |
|    |           | 12. 设备采用免维护 LED 激发光源，配备高灵敏度光电传感器，检测通道不少于 4 个且波长范围涵盖 510nm-665nm，                                                                                                                            | 12. 设备采用免维护 LED 激发光源，配备高灵敏度光电传感器，检测通道 4 个且波长范围涵盖 510nm-665nm，每一反                                                                                                                            | 无偏离  |

|   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|---|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   |       | 每一反应孔独立的光纤传输；                                                                                                                                                                                                                                                    | 应孔独立的光纤传输；                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|   |       | 13. PCR 模块开放，可独立运行各类检测项目，具有常规变温 PCR 和高分辨溶解曲线检测分析功能，系统自动分析扩增曲线并完成定量结果计算，无需人工干预，报告病毒拷贝数单位及 IU/ml 国际单位两种结果；                                                                                                                                                         | 13. PCR 模块开放，可独立运行各类检测项目，具有常规变温 PCR 和高分辨溶解曲线检测分析功能，系统自动分析扩增曲线并完成定量结果计算，无需人工干预，报告病毒拷贝数单位及 IU/ml 国际单位两种结果；                                                                                                                                         | 无偏离 |
|   |       | <b>(二) 标准配置</b><br>(1) 主机（96 通量核酸提取+96 通量 PCR）1 套；                                                                                                                                                                                                               | <b>(二) 标准配置</b><br>(1) 主机（96 通量核酸提取+96 通量 PCR）1 套；                                                                                                                                                                                               | 无偏离 |
|   |       | (2) 外置终端工作站、不停电电源装置（在使用过程中，遇到断电的情况下，须能保证设备正常运行至少 3 小时不受影响）、扫码枪、管托、彩色激光输出终端；                                                                                                                                                                                      | (2) 外置终端工作站、不停电电源装置（在使用过程中，遇到断电的情况下，须能保证设备正常运行至少 3 小时不受影响）、扫码枪、管托、彩色激光输出终端；                                                                                                                                                                      | 无偏离 |
|   |       | (3) 至少提供 48 人份 HIV-1RNA 定量检测试剂，48 人份 HIV-1 DNA 定量检测试剂，48 人份 HCV RNA 定量检测试剂。成交供应商派遣工程师到现场进行性能验证，并协助客户进行检测，通过客户的盲样考核。                                                                                                                                              | (3) 至少提供 48 人份 HIV-1RNA 定量检测试剂，48 人份 HIV-1 DNA 定量检测试剂，48 人份 HCV RNA 定量检测试剂。成交供应商派遣工程师到现场进行性能验证，并协助客户进行检测，通过客户的盲样考核。                                                                                                                              | 无偏离 |
|   |       | <b>(三) 其他要求</b><br>(1) 能采取内标定量方式进行实验与结果分析。HIV 核酸定量检测时，最低检测限不高于 30IU/ml (或 20 拷贝/ml)，检测线性范围能覆盖 30IU-10 <sup>7</sup> IU/ml，检测靶标涵盖 HIV-1M 组、N 组、O 组基因型且至少涵盖 LTR、POL、GAG 三个基因保守区中的两个。HCV 核酸定量检测时，最低检测限不高于 25IU/ml (或 15 拷贝/ml)，检测线性范围能覆盖 25IU-10 <sup>8</sup> IU/ml。 | <b>(三) 其他要求</b><br>(1) 能采取内标定量方式进行实验与结果分析。HIV 核酸定量检测时，最低检测限 30IU/ml (或 20 拷贝/ml)，检测线性范围能覆盖 30IU-10 <sup>7</sup> IU/ml，检测靶标涵盖 HIV-1M 组、N 组、O 组基因型且涵盖 LTR、POL 两个基因保守区。HCV 核酸定量检测时，最低检测限 25IU/ml (或 15 拷贝/ml)，检测线性范围能覆盖 25IU-10 <sup>8</sup> IU/ml。 | 无偏离 |
|   |       | (2) 每季度巡检 1 次；                                                                                                                                                                                                                                                   | (2) 每季度巡检 1 次；                                                                                                                                                                                                                                   | 无偏离 |
|   |       | (3) 每年免费培训 ≥2 人次 HIV/HCV 病毒载量检测技术。                                                                                                                                                                                                                               | (3) 每年免费培训 ≥2 人次 HIV/HCV 病毒载量检测技术。                                                                                                                                                                                                               | 无偏离 |
| 2 | 生物安全柜 | <b>(一) 技术参数</b><br>1. A2 型，30%外排，70%循环；                                                                                                                                                                                                                          | <b>(一) 技术参数</b><br>1. A2 型，30%外排，70%循环；                                                                                                                                                                                                          | 无偏离 |
|   |       | 2. 内部工作面宽度不小于 1350mm；                                                                                                                                                                                                                                            | 2. 内部工作面宽度 1350mm；                                                                                                                                                                                                                               | 无偏离 |
|   |       | 3. 送风和排风过滤器均采用 ULPA 高效过滤器，对 0.12 μm 颗粒过滤效率 ≥ 99.9995%；                                                                                                                                                                                                           | 3. 送风和排风过滤器均采用 ULPA 高效过滤器，对 0.12 μm 颗粒过滤效率 ≥ 99.9995%；                                                                                                                                                                                           | 无偏离 |
|   |       | 4. 前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃，即使玻璃破损，也不会伤人，并且生物安全柜还能正常工作；                                                                                                                                                                                                                  | 4. 前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃，即使玻璃破损，也不会伤人，并且生物安全柜还能正常工作；                                                                                                                                                                                                  | 无偏离 |
|   |       | 5. 脚踏电动、手动按键、遥控电动三种方式控制玻璃门升降，玻璃门升降到安全操作高度时，自动停止升降，玻璃门升降时不直接接触玻璃门；                                                                                                                                                                                                | 5. 脚踏电动、手动按键、遥控电动三种方式控制玻璃门升降，玻璃门升降到安全操作高度时，自动停止升降，玻璃门升降时不直接接触玻璃门；                                                                                                                                                                                | 无偏离 |

|                                                                          |                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| 6. 安全柜裸露工作区三侧壁板采用优质 304#不锈钢一体化结构，内部可清洗部位采用 8mm 大圆角处理，不留死角，易于清洁；          | 6. 安全柜裸露工作区三侧壁板采用优质 304#不锈钢一体化结构，内部可清洗部位采用 8mm 大圆角处理，不留死角，易于清洁；          | 无偏离 |
| 7. 工作台面材质为优质 304#不锈钢，采用盆状式设计，即使实验有废液溢出，也不会流入积液槽中，便于清理；                   | 7. 工作台面材质为优质 304#不锈钢，采用盆状式设计，即使实验有废液溢出，也不会流入积液槽中，便于清理；                   | 无偏离 |
| 8. 脚轮与支架一体化设计，安全柜即可通过脚轮安全移动，也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平，柜体和支架可分离，支架高度可根据实际情况订制修改； | 8. 脚轮与支架一体化设计，安全柜即可通过脚轮安全移动，也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平，柜体和支架可分离，支架高度可根据实际情况订制修改； | 无偏离 |
| 9. 保证柜内气密性，安全柜内加压 500Pa, 保持 10min 后气压不低于 450Pa;                          | 9. 保证柜内气密性，安全柜内加压 500Pa, 保持 10min 后气压不低于 450Pa;                          | 无偏离 |
| 10. 前窗气流隔断有设计，防止气流通过前窗侧壁及上侧进行泄露；                                         | 10. 前窗气流隔断有设计，防止气流通过前窗侧壁及上侧进行泄露；                                         | 无偏离 |
| 11. 风机的电机当安全柜在时运行自动调整电机的速度控制，经过滤器的风压下降 50%时，风机的排气量下降不超过 10%;             | 11. 风机的电机当安全柜在时运行自动调整电机的速度控制，经过滤器的风压下降 50%时，风机的排气量下降不超过 10%;             | 无偏离 |
| 12. 有完善的报警系统和安全的连锁保护设计；                                                  | 12. 有完善的报警系统和安全的连锁保护设计；                                                  | 无偏离 |
| <b>(二) 其他要求</b><br>供应商须在安装调试完成后向采购人出具第三方检测机构检测合格报告。                      | <b>(二) 其他要求</b><br>供应商须在安装调试完成后向采购人出具第三方检测机构检测合格报告。                      | 无偏离 |

注：

1. 说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的技术需求逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2. 供应商应根据竞标设备的性能指标，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3. 供应商认为其竞标响应有正偏离的，请在技术偏离表中列明，且在响应文件中提供竞标产品的彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。

4. 如技术偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

供应商名称（电子公章）：广州前师科技有限公司

法定代表人或委托代理人(签字或者电子签名或者加盖电子印章)：\_\_\_\_\_

2026 年 09 月 27 日

## 九、项目实施人员一览表

### 项目实施人员一览表



| 姓名  | 职务   | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号           | 参加本单位工作时间   | 劳动合同编号       |
|-----|------|-------------------------------|----------------|-------------|--------------|
| 韦文波 | 技术支持 | 技能证书                          | ZS-20180502003 | 2018 年 05 月 | JSC-201805C2 |
| 郭亦轩 | 技术支持 | 技能证书                          | JSB-2021032920 | 2021 年 03 月 | JSC-202103K6 |
| 张亮亮 | 技术支持 | 临床基因扩增实验室技术人员上岗证              | 2019120914175  | 2019 年 12 月 | JSC-201912A1 |
| 杨洁  | 技术支持 | 湖南省基因扩增实验室技术人员上岗证             | 2014061419056  | 2020 年 06 月 | JSC-202006C8 |

注：在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

供应商名称（电子公章）：广州前师科技有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或者电子签名或者加盖电子印章）：刘真君

2026 年 09 月 27 日



## 十、服务方案及承诺

### 售后服务承诺书

#### 一、质保期内：

- 1、质量保证期：自设备在客户处安装之日起的二十四个月内，因仪器制造工艺、原料等缺陷造成的故障提供免费维修。
- 2、保修范围：仪器制造工艺、原料等缺陷造成的故障提供免费维修。
- 3、质保期内，下列情况不属于免费维修范围：
  - 3.1 未按使用操作说明书使用造成的任何损坏；
  - 3.2 产品经过非我公司官方授权人员拆装或维修；
  - 3.3 产品序列号被删除或更改；
  - 3.4 产品保修卡上的产品序列号与本产品本身不符；
  - 3.5 火灾、地震等非正常储存条件或不可抗力导致的任何损坏；
  - 3.6 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

#### 二、保修期外：我根据故障类型收取相对应的维修费，包括：更换的配件成本费、维修工程师差旅费、工时费等。详细费用以报修时提供的《维修报价单》为准。

#### 三、服务响应时间：质量保证期内外发生故障保修，接到报修通知后，我方工程师4小时内响应，通过电话提供免费技术咨询服务；通过电话无法解决则派出专业维修人员在72小时内上门提供维修服务，若设备零部件损坏需更换，我方保证及时将所需更换零部件送往现场并进行更换。

#### 四、售后服务机构：全国服务热线：4008304880，总部：珠海市香洲区同昌路266号1栋

| 区域    | 办公电话             | 地址                                       |
|-------|------------------|------------------------------------------|
| 上海办事处 | 021-62818719     | 上海市漕河泾开发区新骏环路138号2幢401室                  |
| 南京办事处 | 025-86616032     | 南京市雨花台区南京南站西片区绿地之窗商务广场D-2-1幢1027、1028室   |
| 北京办事处 | 010-67083915     | 北京市崇文门外大街3B号北京新世界中心办公楼北座8层801、802、818号单元 |
| 山东办事处 | 0531-86551781    | 山东省潍坊市奎文区东风东街7870号1号楼潍坊新基立商务大厦1911房      |
| 湖南办事处 | 0731-82236320    | 湖南省长沙市雨花区劳动东路222号第C2栋716-717房            |
| 重庆办事处 | 023-68962451     | 重庆市大渡口区春晖路街道翠柏路101号5幢4楼401C              |
| 成都办事处 | 028-86289226     | 成都市人民中路二段29号泰丰国际广场9楼1号                   |
| 河北办事处 | /                | 石家庄市裕华西路15号万象国际公寓1903室                   |
| 福州办事处 | 0591-83323356    | 福州市东二环泰禾商住楼3栋425、426室                    |
| 广州办事处 | 020-38888372/373 | 广州市天河区天河路490号壬丰大厦2906室                   |
| 西安办事处 | 029-85564430     | 西安市长安北路1号陕西会展国际大厦1228室                   |
| 武汉办事处 | 027-85717673     | 湖北省武汉市塔子湖东路8栋814、817                     |
| 广西办事处 | 0771-2506880     | 南宁市江南区附1号华荣商务大厦5层519室                    |
| 杭州办事处 | 0571-85236186    | 浙江省杭州市江干火车东站东广场环站东路与和兴路交叉口东站西子国际B座3层311室 |

## 五、安装调试及培训计划

|       |   |                                                            |
|-------|---|------------------------------------------------------------|
| 设备发货前 | 1 | 和销售人员确认是否落实相关事宜，流程是否完成                                     |
|       | 2 | 确认收货地址、联系人等信息                                              |
|       | 3 | 通知物流，预计到货时间                                                |
|       | 4 | 设备出仓前核实是否完整齐全                                              |
|       | 5 | 确认安装地点及条件                                                  |
| 设备到货后 | 1 | 检查设备外箱是否完好                                                 |
|       | 2 | 通知用户，确认共同拆箱时间                                              |
|       | 3 | 确认安装时间，通知工程师                                               |
| 培训计划  | 1 | 我方在设备最终验收前为买方相关人员进行专项技术培训                                  |
|       | 2 | 我方所提供的培训计划，由买方设备工程师认可，培训内容包括但不限于：a. 理论培训；b. 操作培训；c. 产品问题解答 |
|       | 3 | 我方的临床应用专家前往买方单位进行操作使用培训，保证买方工作人员正确、熟练地操作设备的各种功能            |
|       | 4 | 培训人员是具有实际工作和相关经验的相应专业人员，培训所使用的语言和教材是中文                     |
| 设备安装后 | 1 | 填写《客户服务报告》                                                 |
|       | 2 | 售后服务人员电话回访及满意度调查                                           |

## 六、技术服务计划

### 1、技术人员一览表

| 序号 | 姓名  | 职位     | 联系方式        |
|----|-----|--------|-------------|
| 1  | 李旭光 | 设备售后总监 | 13911659540 |
| 2  | 朱庆亚 | 总监助理   | 18963650122 |
| 3  | 潘传爱 | 工程师    | 13107723271 |
| 4  | 王盼盼 | 应用工程师  | 18169958697 |
| 5  | 陈朔  | 维修工程师  | 15002467710 |

### 2、提供保养服务：保养时间由我司统一安排，并在保养前一周与客户确定保养时间。

◆ 每季度制订一次维护计划

◆ 根据客户使用及设备性能要求，制订《保养项目表》

### 3、工程师将在完成保养后将保养的结果和建议更换的配件、耗材通知客户和销售负责人、由销售负责人督促经销商/客户向我司采购新配件和耗材，为下一次保养做准备。

## 七、叫修方式

1、客户可拨打全国服务热线 4008304880 叫修；

2、客户可登陆 APP 叫修。

单位名称：珠海丽珠试剂股份有限公司

日期：2026年1月1日

## 项目实施方案

我司通过 ISO13485 质量管理体系考核，取得 GMP、GSP 认证证书，保证货物是全新、未曾使用过的，作为设备的专业生产企业及总代理商，货源充足，能及时供应。

### 一、验收及验收标准

- 1、设备验收：设备到达用户指定地点后用户统一初验是否符合合同要求
- 2、项目验收：我方负责设备安装和调试，完工后，用户测试是否合格并满足技术要求

### 二、交货计划：根据用户需求，在用户指定时间内送到指定地点，

### 三、服务响应：质量保证期内外发生故障保修，接到医院报修通知后，我方工程师 4 小时响应，通过电话提供免费技术咨询服务；通过电话无法解决则派出专业维修人员在 72 小时内上门提供维修服务。若设备零部件损坏需更换，我方保证及时将所需更换零部件送往现场并进行更换。

单位名称：珠海丽珠试剂股份有限公司

日期：2026年1月1日

## 售后服务承诺及培训计划



### 一、售后服务计划

1. 质保期：安全柜质保期 12 个月（易损件除外）。质保期内，若配件因质量出现问题，给予免费更换，人为原因造成的配件损坏，配件按照出厂价格收费。质保期外，如出现故障，仅收取配件成本费，不收取人工费。

2. 保修期内定期维护一年一次。

3. 维修响应时间：

提供产品终身技术服务。生物安全柜出现故障，公司在接到报修通知后 2 小时内电话作出响应，电话不能解决的，本地用户在 24 小时内到现场维修，外地用户在 48 小时内到现场维修，直到产品正常工作。

4. 出现以下情况，需要到现场检测：

- 1) II 级生物安全柜放到指定位置后；
- 2) II 级生物安全柜被移动位置后；
- 3) II 级生物安全柜进行检修后；
- 4) II 级生物安全柜更换高效过滤器后；
- 5) II 级生物安全柜定期常规现场检查维修；

5. 维修中心名单详见附表

| 联系人 | 联系电话        |
|-----|-------------|
| 邢帮杰 | 15265310735 |
| 韦相龙 | 18766165083 |







## 二、培训计划

- 一) 培训内容包括：产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等。
- 二) 培训时间：在收到采购人安装通知后，安装完毕后，5天内培训完毕。
- 三) 培训地点：用户所在地培训。

### 1、用户所在地培训：

- 1) 费用承担：给用户安装产品后，在产品所在地进行培训，资料和师资等费用由我方承担。

- 2) 培训方式：实物培训和电脑 PPT 培训。

实物培训：产品全部安装调试完毕后，公司专业工程师在用户所在地对设备接收单位的操作人员进行现场免费培训，使其能够熟练掌握设备的各项功能和操作。

PPT 培训：(1) 培训生物安全柜的基本原理。

(2) 生物安全柜的操作程序及使用注意事项。

(3) 生物安全柜的维修服务的联系方式等。

### 注意事项：

- (1) 生物安全柜在安装搬运过程中，竖直搬运，到搬入安装现场后拆开包装。
- (2) 生物安全柜安装位置避开人流频繁处，并避免房间气流对操作口空气幕的干扰。
- (3) 安全柜不安装在房间通风系统的进口，以免气流直接吹到安全柜。
- (4) 正面的操作口和排风过滤器上。安全柜的周围留出 30cm 的空间，以便于清除脏物。如果由于空间限制，至少在两边留出 25cm，背面留出 30cm。
- (5) 在安全柜的电源处留出足够的空间（注意漏电保护措施），以便于在不移动安全柜的情况下，就可以进行维修。
- (6) 安装的生物安全柜底面和底边紧贴地面的安全柜，所有沿地边的缝隙加以密封。
- (7) 生物安全柜的排风管道的连接方式，以更换排风过滤器方便来确定。
- (8) 如果需要在安全柜内使用其他气体时，同时安装气源气路，安装压力表和阀门并且注意选择适用不同气体的管道材料。
- (9) 验收标准：按照产品原始样本技术数据及技术标书响应数据进行验收。



供应商名称（电子公章）：广州前师科技有限公司

法定代表人或委托代理人(签字或者电子签名或者加盖电子印章)：刘复君

2026 年 09 月 27 日

## 十一、产品彩页

丽珠试剂  
LIVZON

创新科技·呵护生命

Innovation for life

1~96T/批次  
384T/8小时

## LISafe高精度分子诊断平台

- 一体化
- 多功能
- 高精度

www.livzondiagnostics.com


# LiSafe分子诊断平台

LiSafe是珠海丽珠试剂公司(LIUNZON)研发的分子检测平台,包含全自动核酸提取仪、全自动核酸一体机、分子POCT等系列产品。全自动核酸一体机由全自动核酸提取仪及扩增集成,采用批发的8通道加样机代替手工预加试剂而成本原始采样繁琐、样本分样、核酸纯化、PCR扩增覆盖到检测流程分析的完整过程,中间无需人工干预,配备智能创新的全组分冻干工艺和-2~8℃稳定的即用型试剂,检测到支持单人份上机,耗试剂最小化,可用于HIV、HCV、HIV等传染病病原体核酸的定性和定量高精度检测,支持2种不同项目同时上机。



## 产品特点

- 自动** 支持一键启动，样本进、结果出
- 高效** 每批1~96测试，首批结果3~4h，之后每批约1.5~2h
- 灵活** 支持连续进样，扩展区支持灵活功能配置
- 安全** HEPA过滤和紫外消毒双防污染系统，指示灯和蜂鸣双重提醒功能

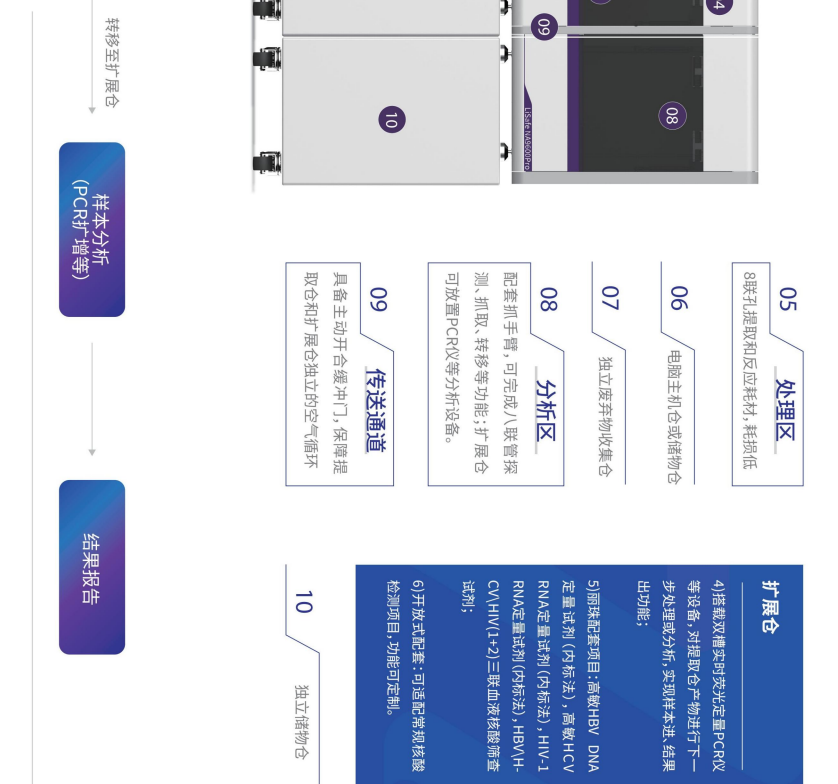

国标生物安全柜系列

产品细节 Product Details



工作区  
工作区由304不锈钢制成，负压包裹。



柜体块  
便于装卸，防止压手。



负压过滤网结构  
防病原物进入设备内部



遥控器  
所有功能遥控操作，预约定时。



福马脚轮  
方向移动，可调水平。



紫外灯  
产生254nm的紫外线有效杀菌。



易清洁防爆玻璃  
前窗玻璃可滑到操作区以下，  
清洁更方便。  
双层夹胶钢化玻璃>6mm，防紫外透。



铁制支撑杆  
用于面板支撑。



脚踏开关  
利用脚踏调节前面高度，解放双手，方  
便快速操作，且能随时调直垂直度。

产品参数 Product Parameters

| 分类           | A2型，30%外排，70%内循环                                                     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| 外形尺寸 (L×D×H) | 1500×755×2200mm                                                      |
| 内部尺寸 (L×D×H) | 1350×600×660mm                                                       |
| 台面距离地面高度     | 770mm                                                                |
| 风速           | 平均下降风速0.33±0.025m/s；平均吸入口风速0.53±0.025m/s                             |
| 系统排风总量       | 520m³/h                                                              |
| 额定功率         | 1600VA (含负载)                                                         |
| 噪音等级         | ≤65dB (A)                                                            |
| 照明           | ≥1000lx                                                              |
| 注册证号         | 国械注准2014322263                                                       |
| 过滤效率         | 送风和排风过滤器均采用知名品牌的硼硅玻璃纤维材质的ULPA高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995%，洁净度 ISO 4级 |

