

采 购 合 同

项目名称: 中医特色重点医院桂林市中医医院设备更新项目第一批次
设备采购项目-中央监护系统（一拖 30）1 套，多功能监护仪（一拖
12）1 套

项目编号: GLZC2026-G1-990086-GXRZ

甲方: 桂林市中医医院（采购人）

乙方: 九州通（桂林）供应链管理有限公司（中标供应商）

采购合同

项目名称：中医特色重点医院桂林市中医医院设备更新项目第一批次设备采购项目-中央监护系统（一拖30）1套，多功能监护仪（一拖12）1套

项目编号：GLZC2026-G1-990086-GXRZ

甲方：桂林市中医医院（采购人）

乙方：九州通（桂林）供应链管理有限公司（中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和乙方承诺、甲乙双方签订本采购合同。

第一条、合同标的及合同金额

项号	货物名称	生产厂家、品牌、规格型号	技术参数	数量 ①	单位	单价（元） ②	单项合计金额 （元） ③=①×②
1	中央监护系统（一拖30）	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司、迈瑞、BeneVision、ePM12M	具体参数后附	1	套	1193000.00	1193000.00
2	多功能监护仪（一拖12）	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司、迈瑞、BeneVision、BeneVision N12	具体参数后附	1	套	1094000.00	1094000.00
合 计							2287000.00

根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）贰佰贰拾捌万柒仟元人民币（¥2287000.00元）

合同总价包括全部产品价格【含与本院相关信息系统（HIS，lis等）对接费用，及设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、因安装新设备所需对原有场地、设施进行的必要改造、修复及完善、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。

第二条 质量保证

1. 乙方应按响应文件承诺的货物型号、技术规格、技术参数、性能、配置、质量标准向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装、使用 and 保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。

2. 乙方提供货物的质量保证期为主机质保期三年，配件质保期一年，自货物全部安装验收合格之日起计。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更

换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，甲方可单方选择按以下办法处理：

(1) 更换：由乙方承担所有发生的全部费用，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。

(2) 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等），并按该退货货物总金额的 10%向甲方支付违约金。

3. 新设备的安装必须保证与甲方的原有设备无缝对接和正常使用。

4. 乙方提供本次采购的材料为未经使用的原厂全新产品。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 货物包装、运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 投标产品须是按厂家出厂标准配置提供的整套全新，具备正规合法经销渠道，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务须满足本表中各项要求。所有设备除满足上表要求的技术参数和配置外，其余均按国家标准及生产厂家出厂标准配置，若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品。

第五条 交付

1. 交付时间：自签订合同之日起 22 个工作日内到货并全部安装调试合格完毕；交付地点：桂林市内甲方指定地点。

2. 乙方提供不符合招标文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条 调试和验收

1. 乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2. 货物安装调试完成后，甲方应在七个工作日内依据招标文件、响应文件的技术规格

要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场验收,验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章,甲乙双方各执一份。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时,乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员,并协助甲方一起调试,直到符合技术要求,甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物,甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收,并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须到现场,验收完毕后作出验收结果报告,验收费用由乙方负责。

6. 乙方在设备验收时须提供生产厂家或总代理商出具的针对所竞产品的售后服务承诺书原件,并携带由行政主管部门核准的资格文件、注册产品标准、产品白皮书等资料材料,以便核实相关资质和技术参数,如无以上材料不予验收。

7. 设备验收时,乙方必须提供设备注册时的检测检验报告书;如中标产品为进口产品时,还须提供海关进口货物报关单及入境货物检验检疫证明。

8. 设备到货安装前须向甲方提供中标产品生产家或国内总代理对外公开发布的产品彩页或说明书(其中应包含有详细的技术参数)原件,甲方依此标准对中标产品按采购需求逐条核验,如参数或尺寸有不符的甲方有权不予验收,由此造成的损失由乙方负责;

9. 乙方所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品;设备到货安装前,乙方需提供技术白皮书、操作手册、产品彩页及检测报告等技术支持证明文件以验证投标参数的真实性,甲方现场根据招标文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验,核验不合格的,甲方有权终止合同执行并全部退货,同时报相关监督管理部门处理,由此造成甲方经济损失的由乙方负责承担全部赔偿责任。

第七条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件(如场地、电源、水源等)。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点: 桂林市中医医院。

第八条 售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及响应文件和本合同所附的《服务承诺》,为甲方提供售后服务。

2. 如在使用过程中发生质量问题,乙方在接到甲方通知后在响应文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内,乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 保修期为:按国家有关产品三包规定执行“三包”,质保期: 主机质保期三年,配件质保期一年,质保期内故障时间顺延质保期。

5. 免费保修范围内。超过保修期的货物,终身维修,维修时只收部件成本费。

6. 在使用过程中若产品发生质量问题或故障,在接到采购人通知后1个小时内响应,8小时内到达故障现场处理,一般故障处理时限不超过24小时修复,同时必须提供同档次的

备用机给采购人使用。

7. 售后服务服务过程中如有违反约定的情况，甲方有权扣除质保金。

第九条 税费

1. 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条 付款方式

1. 预付款：签订本合同且乙方开具正规合法发票后 22 个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的 30% 作为预付款。

2. 验收款：设备验收合格，且乙方开具剩余款项（合同总金额的 65%）的正规合法发票后 22 个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的 65%（累计支付至合同总金额的 95%）。

3. 质量保证金：剩余合同总金额的 5% 作为质量保证金，待质保期届满，且乙方已完全履行本合同项下全部质量保证及售后服务义务后，乙方凭合同和《政府采购项目验收单》向甲方申请办理支付手续。经甲方书面确认无任何未决争议且收到乙方提供的正规合法发票后 22 个工作日内，由甲方向乙方一次性无息支付。

第十一条 履约保证金

履约保证金金额：按中标金额的 0%（注：履约保证金不超过政府采购合同金额的 5%）。

履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式。

履约保证金退付方式、时间及条件：由中标人向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22 号），保证金收取单位在收到合格材料后 5 个工作日内办理退还手续（不计利息）。

履约保证金指定账户：

户名：/

开户银行：/

账号：/

第十二条 违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，甲方有权拒收，乙方必须在合同约定的供货时间内更换为合格产品。若因此导致交货延迟，或更换后仍不合格的，应按本条第 4 款关于逾期交货的规定承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的全部经济损失。

2、乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。若甲方因此遭受损失，乙方还需全额赔偿甲方损失，包括但不限于直接、间接损失、甲方为应诉、起诉支出的律师费、案件受理费、保全费、保全保险费、鉴定费、调查取证费等。同时，甲方有权单方解除本合同。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4、乙方逾期交货的，每逾期一日，应向甲方支付合同总金额 1%（千分之一）的违约

金, 但该项违约金总额不得超过合同总金额的 10%。逾期超过 15 日的, 甲方有权单方解除本合同。合同解除后, 乙方除应向甲方支付截至解除之日累计的逾期交货违约金外, 还应向甲方支付合同总金额 5% 的违约金作为对甲方损失的赔偿。

5、乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的, 乙方每次应按本合同合计金额 2% 向甲方支付违约金, 并赔偿由此带给甲方的经济损失。同时, 甲方有权自行或另行委托第三方提供售后服务, 由此产生的费用及造成的损失, 均由乙方承担。

6、乙方提供的货物在质保期内, 因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题, 由乙方负责, 费用从质量保证金中扣除, 不足另补。

7、其他违约行为按违约货款额 5 % 收取违约金并赔偿经济损失。

8、甲方因乙方违约而单方解除合同的, 乙方除应全额退还甲方已付款外, 还应向甲方支付合同总金额 15% 的违约金, 并承担甲方为主张权利支出的律师费、鉴定费、保全保险费、调查取证费等费用。

第十三条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内, 乙方因不可抗力事件导致不能履行合同, 则合同履行期可延长, 其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后, 应立即通知对方, 并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上, 双方应通过友好协商, 确定是否继续履行合同。

第十四条 合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的, 应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的, 鉴定费由甲方承担; 货物不符合标准的, 鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的任何争议, 甲乙双方应首先通过友好协商解决。如果协商不能解决, 任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间, 本合同继续履行。

第十五条 合同生效及其它

1、合同经甲乙双方法定代表人(负责人)或授权代表签字并加盖双方公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的, 需经甲方审批。

3、本合同未尽事宜, 遵照《民法典》有关条文执行。

第十六条 合同的变更、终止与转让

1、本合同一经签订, 甲乙双方不得擅自变更, 中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十七条 本合同附件:

1. 乙方提供的投标(或应答)文件;

2. 售后服务承诺书;

3. 中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式陆份，具有同等法律效力，甲方肆份、乙方壹份。
采购合同双方自签订之日起二个工作日内将合同原件壹份交采购代理机构存档。

甲方（公章）： 桂林市中医医院

法定代表人签字：

委托代理人：

电 话： 0773-2813444

开户名称： 桂林市中医医院

开户银行： 中行桂林分行营业部

银行账号： 6236 5750 0820

日 期： 2026.4.21

乙方（公章）：九州通（桂林）供应链管理

有限公司
法定代表人签字：

委托代理人：

电 话： 15977097983

开户名称：九州通（桂林）供应链管理有限公司

开户银行：中国银行股份有限公司桂林分行营

业部

银行账号： 624990676691

日 期： 2026.4.21



二、商务、技术性响应及其他证明材料

1、投标报价表

致：(桂林市中医医院)

根据贵方 中医特色重点医院桂林市中医医院设备更新项目第一批设备采购项目-中央监护系统（一拖30）1套，多功能监护仪（一拖12）1套 项目采购文件，项目编号 GLZC2026-G1-990086-GXRZ，签字代表 何炎华（姓名）经正式授权并代表供应商 九州通（桂林）供应链管理有限公司（供应商名称），提交上传投标文件，并做出如下报价：

项号	货物名称	生产厂家	品牌、规格型号	单位	数量①	单价②	单项合计=采购量×单价③=①×②	备注
1	中央监护系统（一拖30）	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	迈瑞、BeneVision、ePM12M	套	1	1193000.00	1193000.00	节能产品 规格型号：HP P24v G5
2	多功能监护仪（一拖12）	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	迈瑞、BeneVision、BeneVision N12	套	1	1094000.00	1094000.00	节能产品 规格型号：HP P24v G5
投标报价（大写）：贰佰贰拾捌万柒仟元 人民币（¥：2287000.00）								
本项目投标有效期为投标截止时间之日起 90 天。								
合同履行期限：自签订合同之日起 60 个日历日内全部安装调试合格完毕并验收合格交付使用，超期未安装调试完毕并验收合格则视为违约。								
其中：属于《节能产品政府采购清单》目录内产品的总金额为人民币（大写）：柒仟元（¥：7000）； 属于《环境标志产品政府采购清单》目录内产品的总金额为人民币（大写）：（桂林）元（¥/）。								
备注：若不属于《节能产品政府采购清单》及《环境标志产品政府采购清单》目录内产品的，则该处填写“无”字样。								
说明：投标报价应包括全部产品价格【含与本院相关信息系统（HIS，lis等）对接费用，及设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、医院装修未尽事项、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用；供应商综合考虑在报价中，采购人不再另行支付投标报价之外的任何费用。								

供应商[公章(CA签章)]: 九州通（桂林）供应链管理有限公司

法定代表人、负责人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA签章)]: 李娟

日期: 2026年2月10日

注：1. 供应商必须按《采购需求书》中的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。

2. 供应商应根据采购需求如实填写投标报价表的内容。

3. 投标报价表须由法定代表人、负责人或相应的委托代理人签字或个人 CA 签章并加盖供应商 CA 签章。
当本表由多页构成时，需逐页加盖供应商公章。

4. 如投标的全部或部分产品属于《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》目录范围的，供应商应在本表备注栏内写明各分项货物属于节能（或环境标志）产品政府采购清单第几类第几项序号的产品，以便评标委员会作为优先采购或评分的依据。

2. 技术规格偏离表

附件：

技术规格偏离表

项 号	货物名称	技术参数要求	投标文件的响应情况（是否响应 采购需求）及偏离情况 （无偏离、正偏离、负偏离）	偏离情况说明
1	中央监护系统 （一拖 30）	一、中央监护系统（5 套）	完全响应采购需求, 无偏离, 一、中央监护系统（5 套）	无偏离
1	中央监护系统 （一拖 30）	1. 支持与监护仪连接组成监护仪网 络系统。	完全响应采购需求, 无偏离, 1. 支持与监护仪连接组成监护仪网 络系统。	无偏离
1	中央监护系统 （一拖 30）	2. 中心监护系统支持 Windows 中文 操作系统。	完全响应采购需求, 无偏离, 2. 中心监护系统支持 Windows 中文 操作系统。	无偏离
1	中央监护系统 （一拖 30）	3. 中心监护系统显示器≥24 英寸液 晶屏幕, 分辨率≥1920×1080 彩色 液晶显示。	完全响应采购需求, 无偏离, 3. 中心监护系统显示器 24 英寸液晶 屏幕, 分辨率 1920×1080 彩色液晶 显示。	无偏离
1	中央监护系统 （一拖 30）	4. 打印内容: 支持报警报告、波形 报告、趋势报告、心律失常统计报 告、呼吸氧合图报告等。	完全响应采购需求, 无偏离, 打印内容: 支持报警报告、波形 报告、趋势报告、心律失常统计报 告、呼吸氧合图报告等。	无偏离
1	中央监护系统 （一拖 30）	5. 界面: 支持重点观察床; 支持动 态趋势窗口、呼吸氧合窗口、设备 集成窗口、ECG 全屏界面等多种视图	完全响应采购需求, 无偏离, 5. 界面: 支持重点观察床; 支持动 态趋势窗口、呼吸氧合窗口、设备	无偏离

项 号	货物名称	技术参数要求	投标文件的响应情况（是否响应 采购需求）及偏离情况 （无偏离、正偏离、负偏离）	偏离情况说明
		显示。	集成窗口、ECG 全屏界面等多种视图显示。	
1	中央监护系统 （一拖 30）	★6. 支持显示参数数据包括但不限于：心电（ECG）、血氧（SpO2）、血压（NIBP/IBP）、呼吸（Resp）、体温（Temp）、脉率（PR）、二氧化碳（CO2）、麻醉气体（AG）。	完全响应采购需求, 正偏离, ★6. 支持显示参数数据包括：心电（ECG）、血氧（SpO2）、血压（NIBP/IBP）、呼吸（Resp）、体温（Temp）、脉率（PR）、心排量（C.O.）、二氧化碳（CO2）、氧气（O2）、麻醉气体（AG）、电阻抗心动描记（ICG）、双频指数（BIS）、呼吸力学（RM）、连续心排量（CCO）、中心静脉氧饱和度（ScvO2）、脑血氧（rSO2）、肌松（NMT）	正偏离,, 显示更多参数 内容
1	中央监护系统 （一拖 30）	7. 支持显示输注泵上的数据包括但不限于：药物名称、药物颜色、输液速度、剩余时间、呼吸机上的压力、流速、容量、时间、氧气、二氧化碳、血氧、计算参数、设置参数。	完全响应采购需求, 正偏离, 7. 支持显示输注泵上的数据包括但不限于：药物名称、药物颜色、输液速度、剩余时间、呼吸机上的压力、流速、容量、时间、氧气、二氧化碳、血氧、计算参数、设置参数, 支持显示麻醉机的麻醉信息。	正偏离,, 支持显示麻醉机的麻醉信息。
1	中央监护系统 （一拖 30）	8. 多床位显示：单屏同时显示≥30 张床位信息，可外接四个显示器，联网床边机数量：≥60 张。	完全响应采购需求, 正偏离, 8. 多床位显示：单屏同时显示 32 张床位信息，可外接四个显示器，联	正偏离,, 单屏同时显示 32 张床位信息，联

项 号	货物名称	技术参数要求	投标文件的响应情况（是否响应 采购需求）及偏离情况 （无偏离、正偏离、负偏离）	偏离情况说明
			网床边机数量：64 张。	网床边机数量： 64 张。
1	中央监护系统 （一拖 30）	9. 报警功能：提供声、光、文字多重报警提醒功能，提供高、中、低三级报警。具有报警自动记录或打印功能，保存报警时刻前后 16 秒的波形，支持系统报警声音关闭功能。	完全响应采购需求，无偏离， 9. 报警功能：提供声、光、文字多重报警提醒功能，提供高、中、低三级报警。具有报警自动记录或打印功能，保存报警时刻前后 16 秒的波形，支持系统报警声音关闭功能。	无偏离，
1	中央监护系统 （一拖 30）	10. 支持查看在线病人的概览数据包括但不限于：生命体征概览报告、氧合概览报告、心电概览报告、室性心律失常概览报告、房颤概览报告、心率变异性概览报告。	完全响应采购需求，无偏离， 10. 支持查看在线病人的概览数据包括但不限于：生命体征概览报告、氧合概览报告、心电概览报告、室性心律失常概览报告、房颤概览报告、心率变异性概览报告。	无偏离，
1	中央监护系统 （一拖 30）	11. 传输速度：≥100 兆/s。	完全响应采购需求，无偏离， 11. 传输速度：≥100 兆/s。	无偏离，
1	中央监护系统 （一拖 30）	12. 传输内容：所有联网床边机的波形、参数、报警。	完全响应采购需求，无偏离， 12. 传输内容：所有联网床边机的波形、参数、报警。	无偏离，
1	中央监护系统 （一拖 30）	13. 支持同时连接输注泵、呼吸机、监护仪、除颤仪等设备。	完全响应采购需求，无偏离， 13. 支持同时连接输注泵、呼吸机、监护仪、除颤仪等设备。	无偏离，
1	中央监护系统	14. 组网方式：中心监护系统支持有	完全响应采购需求，无偏离，	无偏离，

项 号	货物名称	技术参数要求	投标文件的响应情况（是否响应 采购需求）及偏离情况 （无偏离、正偏离、负偏离）	偏离情况说明
	（一拖 30）	线组网。	14. 组网方式：中心监护系统支持有线组网。	
1	中央监护系统 （一拖 30）	15. 趋势数据存储及回顾≥240 小时；动态血压分析及回顾≥24 小时。	完全响应采购需求，无偏离， 15. 趋势数据存储及回顾 240 小时； 动态血压分析及回顾 24 小时。	无偏离，
1	中央监护系统 （一拖 30）	16. 报警事件存储及回顾≥720 条； 支持≥200 个历史病人数据存储与 回顾。	完全响应采购需求，无偏离， 16. 报警事件存储及回顾 720 条；支 持 200 个历史病人数据存储与回顾。	无偏离，
1	中央监护系统 （一拖 30）	17. 具备实时观察界面：支持监护 仪、输注泵、呼吸机等多设备在同 一界面实时观察，查看床旁设备传 送过来实时的详细病人信息、波形 和参数数据。支持通过应用查看、 删除或导出超声检查结果。	完全响应采购需求，无偏离， 17. 具备实时观察界面：支持监护 仪、输注泵、呼吸机等多设备在同 一界面实时观察，查看床旁设备传 送过来实时的详细病人信息、波形 和参数数据。支持通过应用查看、 删除或导出超声检查结果。	无偏离，
1	中央监护系统 （一拖 30）	18. 数据管理功能：支持≥240 小时 长趋势回顾和 8 小时短趋势回顾， ≥720 条报警事件回顾，≥720 条 12 导分析报告回顾，≥240 小时的 ST 片段回顾，≥720 条 C.O. 测量结果 回顾，≥240 小时的全息波形存储及 回顾。	完全响应采购需求，正偏离， 18. 数据管理功能：支持 240 小时长 趋势回顾和 8 小时短趋势回顾，3000 条报警事件回顾，720 条 12 导分析 报告回顾，240 小时的 ST 片段回顾， 720 条 C.O. 测量结果回顾，240 小时 的全息波形存储及回顾。	正偏离， 3000 条报警事件 回顾
1	中央监护系统 （一拖 30）	19. 监护信息导出、导入功能：病人 监护信息由移动介质导出导入。	完全响应采购需求，无偏离， 19. 监护信息导出、导入功能：病人	无偏离，

项 号	货物名称	技术参数要求	投标文件的响应情况（是否响应 采购需求）及偏离情况 （无偏离、正偏离、负偏离）	偏离情况说明
			监护信息由移动介质导出导入。	
1	中央监护系统 （一拖 30）	20. 具备远程控制功能：支持远程控制对床旁监护仪包括但不限于进行病人信息管理，报警设置，NIBP 测量，工作模式。支持远程控制输注泵功能，包括更改输液模式、更改输注参数、主副药、启动输液、暂停输液、快推、待机、报警复位报、警声音暂停。	完全响应采购需求，无偏离， 20. 具备远程控制功能：支持远程控制对床旁监护仪包括但不限于进行病人信息管理，报警设置，NIBP 测量，工作模式。支持远程控制输注泵功能，包括更改输液模式、更改输注参数、主副药、启动输液、暂停输液、快推、待机、报警复位报、警声音暂停。	无偏离，
1	中央监护系统 （一拖 30）	21. 具备记录仪功能：实时片段波形记录、实时连续波形记录、实时自动波形记录、全息波形记录、事件记录、实时报警记录。	完全响应采购需求，无偏离， 21. 具备记录仪功能：实时片段波形记录、实时连续波形记录、实时自动波形记录、全息波形记录、事件记录、实时报警记录。	无偏离，
1	中央监护系统 （完全响应采购需求，无偏离，一拖 30）	22. 具备药物浓度计算：支持药物计算，≥100 条血液动力学计算结果回顾，≥100 条氧合计算结果回顾，100 条通气计算结果回顾，100 条肾功能计算结果回顾。	完全响应采购需求，无偏离， 22. 具备药物浓度计算：支持药物计算，100 条血液动力学计算结果回顾，100 条氧合计算结果回顾，100 条通气计算结果回顾，100 条肾功能计算结果回顾。	无偏离，
1	中央监护系统 （一拖 30）	二、病人监护入（30 台）	完全响应采购需求，无偏离， 二、病人监护入（30 台）	无偏离，
1	中央监护系统	★1.1、彩色液晶触摸屏≥12.1	完全响应采购需求，正偏离，	正偏离，

项 号	货物名称	技术参数要求	投标文件的响应情况（是否响应 采购需求）及偏离情况 （无偏离、正偏离、负偏离）	偏离情况说明
	（一拖 30）	英寸，屏幕采用最新电容屏非电阻屏，分辨率 $\geq 1280 \times 800$ 像素或更高， ≥ 6 通道波形显示，主机集成内置 ≥ 2 槽位插件槽，可支持 IBP，CO2，AG 任意参数模块的即插即用快速扩展临床应用，整机无风扇设计，配置提手，方便移动，有创压监测，动脉压监测时支持同步监测 PPV，适用于成人，小儿和新生儿。	★1.1、彩色液晶触摸屏 12.1 英寸，屏幕采用最新电容屏非电阻屏，多点触控，支持手势操作，分辨率 1280 $\times$ 800 像素，170° 宽视角可视范围大，自动亮度调节，减少夜间光干扰，支持 10 通道波形显示，主机集成内置 2 槽位插件槽，支持 IBP，CO2，AG 任意参数模块的即插即用快速扩展临床应用，整机无风扇设计，配置提手，方便移动，有创压监测，动脉压监测时支持同步监测 PPV，适用于成人，小儿和新生儿。	多点触控，支持手势操作，170° 宽视角可视范围大，自动亮度调节，减少夜间光干扰，支持 10 通道波形显示
1	中央监护系统 （一拖 30）	1.2、显示屏可支持亮度自动调节功能，屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。	完全响应采购需求，无偏离， 1.2、显示屏可支持亮度自动调节功能，屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。	无偏离
1	中央监护系统 （一拖 30）	1.3、可支持遥控器或其他方式无线远程操作监护仪。	完全响应采购需求，无偏离， 1.3、可支持遥控器或其他方式无线远程操作监护仪。	无偏离
1	中央监护系统 （一拖 30）	1.4、内置高性能锂电池，工作时间 ≥ 6 小时，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。	完全响应采购需求，无偏离， 1.4、内置高性能锂电池，工作时间 ≥ 6 小时，插槽式设计，无需螺	无偏离

项 号	货物名称	技术参数要求	投标文件的响应情况（是否响应 采购需求）及偏离情况 （无偏离、正偏离、负偏离）	偏离情况说明
			丝刀工具支持快速拆卸和安装。	
1	中央监护系统 （一拖30）	1.5、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2, NIBP监测参数抗电击程度 为防除颤CF型。	完全响应采购需求, 无偏离, 1.5、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2, NIBP监测参数抗电击程度 为防除颤CF型。	无偏离
1	中央监护系统 （一拖30）	1.6、监护仪设计使用年限≥10 年。	完全响应采购需求, 无偏离, 1.6、监护仪设计使用年限10年。	无偏离
1	中央监护系统 （一拖30）	1.7、监护仪主机工作大气压环境 范围：57.0~107.4kPa, 监护仪主 机工作温度环境范围：0~40℃, 监护仪主机工作湿度环境范围： 15~95%。	完全响应采购需求, 无偏离, 1.7、监护仪主机工作大气压环境 范围：57.0~107.4kPa, 监护仪主 机工作温度环境范围：0~40℃, 监护仪主机工作湿度环境范围： 15~95%。	无偏离
1	中央监护系统 （一拖30）	1.8、防水等级≥IPX2	完全响应采购需求, 无偏离, 1.8、防水等级IPX2	无偏离
1	中央监护系统 （一拖30）	2：监测参数：	完全响应采购需求, 无偏离, 2：监测参数：	无偏离
1	中央监护系统 （一拖30）	2.1、配置3/5导心电，呼吸，无 创血压，血氧饱和度，脉搏和双 通道体温参数监测	完全响应采购需求, 无偏离, 2.1、配置3/5导心电，呼吸，无 创血压，血氧饱和度，脉搏和双 通道体温参数监测	无偏离
1	中央监护系统 （一拖30）	2.2、心电监护支持心率，ST段测 量，心律失常分析，QT/QTc连续	完全响应采购需求, 无偏离, 2.2、心电监护支持心率，ST段测	无偏离

项 号	货物名称	技术参数要求	投标文件的响应情况（是否响应 采购需求）及偏离情况 （无偏离、正偏离、负偏离）	偏离情况说明
		实时测量和对应报警功能，心电图算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证，心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s，提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。	量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，心电图算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证，心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s，提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。	
1	中央监护系统 （一拖 30）	2.3、支持≥27种心律失常分析，包括房颤分析。	完全响应采购需求，正偏离， 2.3、支持29种心律失常分析，包括房颤分析。	正偏离 支持 29 种心律失常分析
1	中央监护系统 （一拖 30）	2.4、QT和QTc实时监测参数测量范围：200~800 ms。	完全响应采购需求，无偏离， 2.4、QT和QTc实时监测参数测量范围：200~800 ms。	无偏离
1	中央监护系统 （一拖 30）	2.5、支持升级提供过去24小时心电图概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。	完全响应采购需求，无偏离， 2.5、支持升级提供过去24小时心电图概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。	无偏离
1	中央监护系统 （一拖 30）	2.6、提供SpO2, PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。	完全响应采购需求，无偏离， 2.6、提供SpO2, PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。	无偏离

项 号	货物名称	技术参数要求	投标文件的响应情况（是否响应 采购需求）及偏离情况 （无偏离、正偏离、负偏离）	偏离情况说明
1	中央监护系统 （一拖 30）	★2.7、支持指套式血氧探头≥ IPX7防水等级。	完全响应采购需求, 无偏离, ★2.7、支持指套式血氧探头IPX7 防水等级。	无偏离
1	中央监护系统 （一拖 30）	2.8、配置无创血压测量, 适用于 成人, 小儿和新生儿, 提供手动, 自动, 连续和序列、整点5种测量 模式, 并提供动态血压分析, 可 以直观地了解病人在24小时内的 血压变化和分布情况, 满足临床 应用, 无创血压成人测量范围: 收缩压25~290mmHg, 舒张压 10~250mmHg, 平均压15~260mmHg。	完全响应采购需求, 无偏离, 2.8、配置无创血压测量, 适用于 成人, 小儿和新生儿, 提供手动, 自动, 连续和序列、整点5种测量 模式, 并提供动态血压分析, 可 以直观地了解病人在24小时内的 血压变化和分布情况, 满足临床 应用, 无创血压成人测量范围: 收缩压25~290mmHg, 舒张压 10~250mmHg, 平均压15~260mmHg。	无偏离
1	中央监护系统 （一拖 30）	2.9、提供辅助静脉穿刺功能。	完全响应采购需求, 无偏离, 2.9、提供辅助静脉穿刺功能。	无偏离
1	中央监护系统 （一拖 30）	2.10、提供双通道体温和温差参 数的监测, 并可根据需要更改体 温通道标名。	完全响应采购需求, 无偏离, 2.10、提供双通道体温和温差参 数的监测, 并可根据需要更改体 温通道标名。	无偏离
1	中央监护系统 （一拖 30）	2.11、心电波形基线恢复时间<5 秒, 呼吸波形、无创血压波形、 血氧饱和度波形除颤恢复时间≤ 15秒	完全响应采购需求, 无偏离, 2.11、心电波形基线恢复时间<5 秒, 呼吸波形、无创血压波形、 血氧饱和度波形除颤恢复时间≤ 15秒	无偏离

项 号	货物名称	技术参数要求	投标文件的响应情况（是否响应 采购需求）及偏离情况 （无偏离、正偏离、负偏离）	偏离情况说明
1	中央监护系统 （一拖 30）	3：系统功能：	完全响应采购需求，无偏离， 3：系统功能：	无偏离
1	中央监护系统 （一拖 30）	3.1、支持所有监测参数报警限一 键自动设置功能，满足医护团队 快速管理患者报警需求，产品用 户手册提供报警限自动设置规 则。	完全响应采购需求，无偏离， 3.1、支持所有监测参数报警限一 键自动设置功能，满足医护团队 快速管理患者报警需求，产品用 户手册提供报警限自动设置规 则。	无偏离
1	中央监护系统 （一拖 30）	3.2、支持肾功能计算功能。	完全响应采购需求，无偏离， 3.2、支持肾功能计算功能。	无偏离
1	中央监护系统 （一拖 30）	3.3、具有图形化技术报警指示功 能，帮助医护团队快速识别报警 来源。	3.3、具有图形化技术报警指示功 能，帮助医护团队快速识别报警 来源。	无偏离
1	中央监护系统 （一拖 30）	3.4、支持 ≥ 120 小时趋势图和趋 势表回顾，支持选择不同趋势组 回顾	完全响应采购需求，无偏离， 3.4、支持 120 小时趋势图和趋势 表回顾，支持选择不同趋势组回 顾	无偏离
1	中央监护系统 （一拖 30）	3.5、 ≥ 1000 条事件回顾，每条报 警事件至少能够存储 32 秒三道相 关波形，以及报警触发时所有测 量参数值	完全响应采购需求，无偏离， 3.5、 ≥ 1000 条事件回顾。每条报 警事件至少能够存储 32 秒三道相 关波形，以及报警触发时所有测 量参数值	无偏离
1	中央监护系统	3.6、 ≥ 1000 组 NIBP 测量结果	完全响应采购需求，无偏离，	无偏离

项 号	货物名称	技术参数要求	投标文件的响应情况（是否响应 采购需求）及偏离情况 （无偏离、正偏离、负偏离）	偏离情况说明
	（一拖 30）		3.6、1000 组 NIBP 测量结果	
1	中央监护系统 （一拖 30）	3.7、≥120 小时（分辨率 1 分钟） ST 模板存储与回顾	完全响应采购需求, 无偏离, 3.7、120 小时（分辨率 1 分钟） ST 模板存储与回顾	无偏离
1	中央监护系统 （一拖 30）	3.8、支持 48 小时全息波形的存 储与回顾功能	完全响应采购需求, 无偏离, 3.8、支持 48 小时全息波形的存 储与回顾功能	无偏离
1	中央监护系统 （一拖 30）	3.9、支持监护仪历史病人数据的 存储和回顾, 并支持通过 USB 接 口将历史病人数据导出到 U 盘。	完全响应采购需求, 无偏离, 3.9、支持监护仪历史病人数据的 存储和回顾, 并支持通过 USB 接 口将历史病人数据导出到 U 盘。	无偏离
1	中央监护系统 （一拖 30）	3.10、支持 RJ45 接口进行有线网 络通信, 和除颤监护仪一起联网 通信到中心监护系统。	完全响应采购需求, 无偏离, 3.10、支持 RJ45 接口进行有线网 络通信, 和除颤监护仪一起联网 通信到中心监护系统。	无偏离
1	中央监护系统 （一拖 30）	3.11、支持监护仪进入夜间模式、 隐私模式, 演示模式和待机模式。	完全响应采购需求, 无偏离, 3.11、支持监护仪进入夜间模式、 隐私模式、演示模式和待机模式。	无偏离
1	中央监护系统 （一拖 30）	★3.12、呼吸氧合界面可显示呼 吸暂停、心动过缓、低血氧饱和 度事件提示, 支持房颤概览显示 内容包括但不限于: 房颤心率分 布、每小时的房颤负荷、生命体	完全响应采购需求, 无偏离, ★3.12、呼吸氧合界面可显示呼 吸暂停、心动过缓、低血氧饱和 度事件提示, 支持房颤概览显示 内容包括但不限于: 房颤心率分	无偏离

项 号	货物名称	技术参数要求	投标文件的响应情况（是否响应 采购需求）及偏离情况 （无偏离、正偏离、负偏离）	偏离情况说明
		征参数趋势图、心搏标志开关。	布、每小时的房颤负荷、生命体征参数趋势图、心搏标志开关。	
1	中央监护系统 （一拖 30）	3.13、提供心肌缺血评估工具，可以快速查看 ST 值的变化。	完全响应采购需求, 无偏离, 3.13、提供心肌缺血评估工具，可以快速查看 ST 值的变化。	无偏离
1	中央监护系统 （一拖 30）	3.14、提供计时器功能，界面区提供设置 ≥ 4 个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。	完全响应采购需求, 无偏离, 3.14、提供计时器功能，界面区提供设置4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。	无偏离
1	中央监护系统 （一拖 30）	★3.15、心电支持 ≥ 3 个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析。	完全响应采购需求, 无偏离, ★3.15、心电支持3个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析。	无偏离
1	中央监护系统 （一拖 30）	3.16、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。	完全响应采购需求, 无偏离, 3.16、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。	无偏离
1	中央监护系统 （一拖 30）	3.17、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。	完全响应采购需求, 无偏离, 3.17、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。	无偏离

项 号	货物名称	技术参数要求	投标文件的响应情况（是否响应 采购需求）及偏离情况 （无偏离、正偏离、负偏离）	偏离情况说明
			人员快速识别异常趋势信息。	
1	中央监护系统 （一拖 30）	3.18、信息互连：支持有线和无 线（内置 WiFi 模块）方式直接与 同品牌中央监护系统互联，把监 测信息参数和波形实时显示到中 央监护系统上，满足科室信息化 的需求。	完全响应采购需求, 无偏离, 3.18、信息互连：支持有线和无 线（内置 WiFi 模块）方式直接与 同品牌中央监护系统互联，把监 测信息参数和波形实时显示到中 央监护系统上，满足科室信息化 的需求。	无偏离
1	中央监护系统 （一拖 30）	3.19、配置要求：	完全响应采购需求, 无偏离, 3.19、配置要求：	无偏离
1	中央监护系统 （一拖 30）	中央监护系统 5 套。	完全响应采购需求, 无偏离, 中央监护系统 5 套。	无偏离
1	中央监护系统 （一拖 30）	主机 30 台。	完全响应采购需求, 无偏离, 主机 30 台。	无偏离
1	中央监护系统 （一拖 30）	三芯电源线 30 根。	完全响应采购需求, 无偏离, 三芯电源线 30 根。	无偏离
1	中央监护系统 （一拖 30）	配备 3 / 5 导除颤型分体式主电缆 组件 30 根。	完全响应采购需求, 无偏离, 配备 3 / 5 导除颤型分体式主电缆 组件 30 根。	无偏离
1	中央监护系统 （一拖 30）	配备 5 导分体式导联线组件 AHA 按扣式 30 根。	完全响应采购需求, 无偏离, 配备 5 导分体式导联线组件 AHA 按扣式 30 根。	无偏离
1	中央监护系统	配备 7 针血氧主电缆 30 根。	完全响应采购需求, 无偏离,	无偏离

项 号	货物名称	技术参数要求	投标文件的响应情况（是否响应 采购需求）及偏离情况 （无偏离、正偏离、负偏离）	偏离情况说明
	（一拖 30）		配备 7 针血氧主电缆 30 根。	
1	中央监护系统 （一拖 30）	成人指套式血氧探头 30 根。	完全响应采购需求, 无偏离, 成人指套式血氧探头 30 根。	无偏离
1	中央监护系统 （一拖 30）	无创血压导气管 30 根。	完全响应采购需求, 无偏离, 无创血压导气管 30 根。	无偏离
1	中央监护系统 （一拖 30）	成人血压袖套 60 个。	完全响应采购需求, 无偏离, 成人血压袖套 60 个。	无偏离
1	中央监护系统 （一拖 30）	儿童血压袖套 10 个。	完全响应采购需求, 正偏离, 儿童血压袖套 20 个。	正偏离 儿童血压袖套 20 个
1	中央监护系统 （一拖 30）	双通道注射泵 10 台。	完全响应采购需求, 无偏离, 双通道注射泵 10 台。	无偏离
1	中央监护系统 （一拖 30）	输液泵 10 台。	完全响应采购需求, 无偏离, 输液泵 10 台。	无偏离
1	中央监护系统 （一拖 30）	有创模块 4 个。	完全响应采购需求, 无偏离, 有创模块 4 个。	无偏离
2	多功能监护仪 （一拖 12）	一、中央监护系统（2套）	完全响应采购需求, 无偏离, 中央监护系统（2套）	无偏离
2	多功能监护仪 （一拖 12）	1. 支持与监护仪连接组成监护仪网 络系统。	完全响应采购需求, 无偏离, 1. 支持与监护仪连接组成监护仪网 络系统。	无偏离
2	多功能监护仪 （一拖 12）	2. 中心监护系统支持 Windows 中文 操作系统。	完全响应采购需求, 无偏离, 2. 中心监护系统支持 Windows 中文	无偏离

项号	货物名称	技术参数要求	投标文件的响应情况（是否响应采购需求）及偏离情况（无偏离、正偏离、负偏离）	偏离情况说明
			操作系统。	
2	多功能监护仪 (一拖 12)	3. 中心监护系统显示器≥24 英寸液晶屏幕，分辨率≥1920×1080 彩色液晶显示。	完全响应采购需求，无偏离， 3. 中心监护系统显示器 24 英寸液晶屏幕，分辨率 1920×1080 彩色液晶显示。	无偏离
2	多功能监护仪 (一拖 12)	4. 打印内容：支持报警报告、波形报告、趋势报告、心律失常统计报告、呼吸氧合图报告等。	完全响应采购需求，无偏离， 4. 打印内容：支持报警报告、波形报告、趋势报告、心律失常统计报告、呼吸氧合图报告等。	无偏离
2	多功能监护仪 (一拖 12)	5. 界面：支持重点观察床；支持动态趋势窗口、呼吸氧合窗口、设备集成窗口、ECG 全屏界面等多种视图显示。	完全响应采购需求，无偏离， 5. 界面：支持重点观察床；支持动态趋势窗口、呼吸氧合窗口、设备集成窗口、ECG 全屏界面等多种视图显示。	无偏离
2	多功能监护仪 (一拖 12)	★6. 支持显示参数数据包括但不限于：心电（ECG）、血氧（SpO2）、血压（NIBP/IBP）、呼吸（Resp）、体温（Temp）、脉率（PR）、二氧化碳（CO2）、麻醉气体（AG）。	完全响应采购需求，正偏离， ★6. 支持显示参数数据包括：心电（ECG）、血氧（SpO2）、血压（NIBP/IBP）、呼吸（Resp）、体温（Temp）、脉率（PR）、心电（ECG）、血氧（SpO2）、二氧化碳（CO2）、麻醉气体（AG）、电阻抗心动描记（ICG）、双频指数（BIS）、呼吸力学（RM）、连续心排量（CCO）、中心静脉氧	正偏离 显示更多参数内容

项 号	货物名称	技术参数要求	投标文件的响应情况（是否响应 采购需求）及偏离情况 （无偏离、正偏离、负偏离）	偏离情况说明
			饱和度(ScvO2)、脑血氧 (rSO2)、 肌松 (NMT)	
2	多功能监护仪 (一拖 12)	7. 支持显示输注泵上的数据包括但不限于：药物名称、药物颜色、输液速度、剩余时间，呼吸机上的压力、流速、容量、时间、氧气、二氧化碳、血氧、计算参数、设置参数。	完全响应采购需求, 正偏离, 7. 支持显示输注泵上的数据包括但不限于：药物名称、药物颜色、输液速度、剩余时间，呼吸机上的压力、流速、容量、时间、氧气、二氧化碳、血氧、计算参数、设置参数, 支持显示麻醉机的麻醉信息。	正偏离 支持显示麻醉机的麻醉信息。
2	多功能监护仪 (一拖 12)	8. 多床位显示：单屏同时显示≥30张床位信息，可外接四个显示器， 联网床边机数量：≥60 张。	完全响应采购需求, 正偏离, 8. 多床位显示：单屏同时显示32张床位信息，可外接四个显示器，联网床边机数量：64张。	正偏离 单屏同时显示 32 张床位信息，联 网床边机数量： 64 张。
2	多功能监护仪 (一拖 12)	9. 报警功能：提供声、光、文字多重报警提醒功能，提供高、中、低三级报警。具有报警自动记录或打印功能，保存报警时刻前后 16 秒的波形，支持系统报警声音关闭功能。	完全响应采购需求, 无偏离, 9. 报警功能：提供声、光、文字多重报警提醒功能，提供高、中、低三级报警。具有报警自动记录或打印功能，保存报警时刻前后 16 秒的波形，支持系统报警声音关闭功能。	无偏离
2	多功能监护仪 (一拖 12)	10. 支持查看在线病人的概览数据包括但不限于：生命体征概览报告、氧合概览报告、心电概览报告、室性心律失常概览报告、房颤概览报	完全响应采购需求, 无偏离, 10. 支持查看在线病人的概览数据包括但不限于：生命体征概览报告、氧合概览报告、心电概览报告、室	无偏离

项 号	货物名称	技术参数要求	投标文件的响应情况（是否响应 采购需求）及偏离情况 （无偏离、正偏离、负偏离）	偏离情况说明
		告、心率变异性概览报告。	性心律失常概览报告、房颤概览报告、心率变异性概览报告。	
2	多功能监护仪 (一拖 12)	11. 传输速度: ≥ 100 兆/s。	完全响应采购需求, 无偏离, 11. 传输速度: ≥ 100 兆/s。	无偏离
2	多功能监护仪 (一拖 12)	12. 传输内容: 所有联网床边机的波形、参数、报警。	完全响应采购需求, 无偏离, 12. 传输内容: 所有联网床边机的波形、参数、报警。	无偏离
2	多功能监护仪 (一拖 12)	13. 组网方式: 中心监护系统支持有线组网。	完全响应采购需求, 无偏离, 13. 组网方式: 中心监护系统支持有线组网。	无偏离
2	多功能监护仪 (一拖 12)	14. 趋势数据存储及回顾 ≥ 240 小时; 动态血压分析及回顾 ≥ 24 小时。	完全响应采购需求, 无偏离, 14. 趋势数据存储及回顾 240 小时; 动态血压分析及回顾 24 小时。	无偏离
2	多功能监护仪 (一拖 12)	15. 报警事件存储及回顾 ≥ 720 条; 支持 ≥ 200 个历史病人数据存储与回顾。	完全响应采购需求, 无偏离, 15. 报警事件存储及回顾 720 条; 支持 200 个历史病人数据存储与回顾。	无偏离
2	多功能监护仪 (一拖 12)	16. 具备实时观察界面: 支持监护仪、输注泵、呼吸机等设备在同一界面实时观察, 查看床旁设备传过来实时的详细病人信息、波形和参数数据。支持通过应用查看、删除或导出超声检查结果。	完全响应采购需求, 无偏离, 16. 具备实时观察界面: 支持监护仪、输注泵、呼吸机等设备在同一界面实时观察, 查看床旁设备传过来实时的详细病人信息、波形和参数数据。支持通过应用查看、删除或导出超声检查结果。	无偏离

项 号	货物名称	技术参数要求	投标文件的响应情况（是否响应 采购需求）及偏离情况 （无偏离、正偏离、负偏离）	偏离情况说明
2	多功能监护仪 (一拖 12)	17. 数据管理功能: 支持≥240 小时 长趋势回顾和 8 小时短趋势回顾, ≥720 条报警事件回顾, ≥720 条 12 导分析报告回顾, ≥240 小时的 ST 片段回顾, ≥720 条 C.O. 测量结果 回顾, ≥240 小时的全息波形存储及 回顾。	完全响应采购需求, 正偏离, 17. 数据管理功能: 支持 240 小时长 趋势回顾和 8 小时短趋势回顾, 3000 条报警事件回顾, 720 条 12 导分析 报告回顾, 240 小时的 ST 片段回顾, 720 条 C.O. 测量结果回顾, 240 小时 的全息波形存储及回顾。	正偏离 3000 条报警事件 回顾,
2	多功能监护仪 (一拖 12)	18. 监护信息导出、导入功能: 病人 监护信息由移动介质导出导入。	完全响应采购需求, 无偏离, 18. 监护信息导出、导入功能: 病人 监护信息由移动介质导出导入。	无偏离
2	多功能监护仪 (一拖 12)	19. 具备远程控制功能: 支持远程控 制对床旁监护仪包括但不限于进行 病人信息管理, 报警设置, NIBP 测 量, 工作模式。支持远程控制输注 泵功能, 包括更改输液模式、更改 输注参数、主副药、启动输液、暂 停输液、快推、待机、报警复位报、 警声音暂停。	完全响应采购需求, 无偏离, 19. 具备远程控制功能: 支持远程控 制对床旁监护仪包括但不限于进行 病人信息管理, 报警设置, NIBP 测 量, 工作模式。支持远程控制输注 泵功能, 包括更改输液模式、更改 输注参数、主副药、启动输液、暂 停输液、快推、待机、报警复位报、 警声音暂停。	无偏离
2	多功能监护仪 (一拖 12)	20. 具备记录仪功能: 实时片段波形 记录、实时连续波形记录、实时自 动波形记录、全息波形记录、事件 记录、实时报警记录。	完全响应采购需求, 无偏离, 20. 具备记录仪功能: 实时片段波形 记录、实时连续波形记录、实时自 动波形记录、全息波形记录、事件 记录、实时报警记录。	无偏离

项 号	货物名称	技术参数要求	投标文件的响应情况（是否响应 采购需求）及偏离情况 （无偏离、正偏离、负偏离）	偏离情况说明
2	多功能监护仪 （一拖 12）	21. 具备药物浓度计算：支持药物计算， ≥ 100 条血液动力学计算结果回顾， ≥ 100 条氧合计算结果回顾， ≥ 100 条通气计算结果回顾， ≥ 100 条肾功能计算结果回顾。	完全响应采购需求，无偏离， 21. 具备药物浓度计算：支持药物计算，100 条血液动力学计算结果回顾，100 条氧合计算结果回顾，100 条通气计算结果回顾，100 条肾功能计算结果回顾。	无偏离
2	多功能监护仪 （一拖 12）	二、监护仪（12 台）	完全响应采购需求，无偏离， 二、监护仪（12 台）	无偏离
2	多功能监护仪 （一拖 12）	1. 主机显示屏 ≥ 12 英寸彩色电容触摸屏、多点触摸操作，分辨率达 $\geq 1280 \times 800$ 像素， ≥ 8 通道显示，根据环境光自动调节屏幕亮度。要求整机无风扇设计，内置锂离子电池，供电时间 ≥ 4 小时。	完全响应采购需求，无偏离， 1. 主机显示屏 12.1 英寸彩色电容触摸屏、多点触摸操作，分辨率达 $\geq 1280 \times 800$ 像素，8 通道显示，根据环境光自动调节屏幕亮度。要求整机无风扇设计，内置锂离子电池，供电时间 4 小时。	无偏离
2	多功能监护仪 （一拖 12）	★2. 模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽位数 ≥ 4 个（非电池插槽），监护仪所有模块（包括基础模块）可插入监护仪主机插槽中的任意插槽，方便临床使用及模块监测组合使用。	完全响应采购需求，无偏离， ★2. 模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽位数 4 个（非电池插槽），监护仪所有模块（包括基础模块）可插入监护仪主机插槽中的任意插槽，方便临床使用及模块监测组合使用。	无偏离
2	多功能监护仪	3. 配置 ≥ 4 个 USB 接口，支持连接	完全响应采购需求，无偏离，	无偏离

项 号	货物名称	技术参数要求	投标文件的响应情况（是否响应 采购需求）及偏离情况 （无偏离、正偏离、负偏离）	偏离情况说明
	（一拖 12）	存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等 USB 设备。	3. 配置≥4 个 USB 接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等 USB 设备。	
2	多功能监护仪 （一拖 12）	4. 配多功能模块，支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测。模块支持从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的转移，具有显示屏，屏幕尺寸≥5.5 英寸触摸屏，内置锂电池供电不小于 7 小时，无风扇设计，功能模块可以实现插入监护仪主机的任意插槽。	完全响应采购需求，无偏离， 4. 配多功能模块，支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测。模块支持从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的转移，具有显示屏，屏幕尺寸 5.5 英寸触摸屏，内置锂电池供电不小于 7 小时，无风扇设计，功能模块可以实现插入监护仪主机的任意插槽。	无偏离
2	多功能监护仪 （一拖 12）	5. 支持 3/5 导心电监测，支持升级 12 导心电测量，并在监护仪上完成 12 导静息分析。	完全响应采购需求，无偏离， 5. 支持 3/5 导心电监测，支持升级 12 导心电测量，并在监护仪上完成 12 导静息分析。	无偏离
2	多功能监护仪 （一拖 12）	★6. 支持≥3 通道心电波形同步分析算法，心电支持≥3 个实时动态同步分析（非多个导联波形同屏显示），支持双通道有创压 IBP 监测，适用于成人、小儿和新生儿，支持升级 8 通道有创压监测。	完全响应采购需求，无偏离， ★6. 支持 3 通道心电波形同步分析算法，心电支持 3 个实时动态同步分析（非多个导联波形同屏显示），支持双通道有创压 IBP 监测，适用于成人、小儿和新生儿。	无偏离

项 号	货物名称	技术参数要求	投标文件的响应情况（是否响应 采购需求）及偏离情况 （无偏离、正偏离、负偏离）	偏离情况说明
			儿，支持升级 8 通道有创压监测。	
2	多功能监护仪 （一拖 12）	7. 支持房颤心律失常分析功能， 支持 ≥ 27 种实时心律失常分析。	完全响应采购需求，正偏离， 7. 支持房颤心律失常分析功能， 支持 29 种实时心律失常分析。	，正偏离 支持 29 种实时 心律失常分析。
2	多功能监护仪 （一拖 12）	8. 提供 ST 段分析功能，支持在专 门的窗口中分组显示心脏前壁， 下壁和侧壁的 ST 实时片段和参考 片段。	完全响应采购需求，无偏离， 8. 提供 ST 段分析功能，支持在专 门的窗口中分组显示心脏前壁， 下壁和侧壁的 ST 实时片段和参考 片段。	无偏离
2	多功能监护仪 （一拖 12）	9. 具有 QT/QTc 测量功能，提供 QT、QTc 和 Δ QTc 参数值，并提供 QTc 和 Δ QTc 报警。	完全响应采购需求，无偏离， 9. 具有 QT/QTc 测量功能，提供 QT、QTc 和 Δ QTc 参数值，并提供 QTc 和 Δ QTc 报警。	无偏离
2	多功能监护仪 （一拖 12）	10. 支持 RR 呼吸率测量，测量范 围：1~200rpm。	完全响应采购需求，无偏离， 10. 支持 RR 呼吸率测量，测量范 围：1~200rpm。	无偏离
2	多功能监护仪 （一拖 12）	11. 无创血压，适用于成人、小儿 和新生儿，提供手动、间隔、 连续、序列和整点 ≥ 5 种测量模 式。无创血压成人测量范围： 25-290mmHg（收缩压）， 10-250mmHg（舒张压）， 15-260mmHg（平均压）。	完全响应采购需求，无偏离， 11. 无创血压，适用于成人、小儿 和新生儿，提供手动、自动间隔、 连续、序列和整点 ≥ 5 种测量模 式。无创血压成人测量范围： 25-290mmHg（收缩压）， 10-250mmHg（舒张压）， 15-260mmHg（平均压）。	无偏离

项 号	货物名称	技术参数要求	投标文件的响应情况（是否响应 采购需求）及偏离情况 （无偏离、正偏离、负偏离）	偏离情况说明
2	多功能监护仪 （一拖 12）	12. 血氧监测提供灌注指数（PI） 的监测。	完全响应采购需求, 无偏离, 12. 血氧监测提供灌注指数（PI） 的监测。	无偏离
2	多功能监护仪 （一拖 12）	13. 配置指套式血氧探头, 防水等 级 $\geq$ IPx7。	完全响应采购需求, 无偏离, 13. 配置指套式血氧探头, 防水等 级IPx7。	无偏离
2	多功能监护仪 （一拖 12）	14. 提供肺动脉楔压（PAWP）的监 测和 PPV 参数监测。	完全响应采购需求, 无偏离, 14. 提供肺动脉楔压（PAWP）的监 测和 PPV 参数监测。	无偏离
2	多功能监护仪 （一拖 12）	15. 支持 4 道 IBP 波形叠加显示, 满足临床对比查看和节约显示空 间的需求。	完全响应采购需求, 无偏离, 15. 支持 4 道 IBP 波形叠加显示, 满足临床对比查看和节约显示空 间的需求。	无偏离
2	多功能监护仪 （一拖 12）	16. 支持旁流 EtCO ₂ 监测模块, 支持升级主流、微流 EtCO ₂ 监测 模块, 旁流 EtCO ₂ 监测模块支持 升级顺磁氧监测技术进行氧气监 测, 水槽要求易用快速更换。	完全响应采购需求, 无偏离, 16. 支持旁流 EtCO ₂ 监测模块, 支 持升级主流、微流 EtCO ₂ 监测模 块, 旁流 EtCO ₂ 监测模块支持升 级顺磁氧监测技术进行氧气监 测, 水槽要求易用快速更换。	无偏离
2	多功能监护仪 （一拖 12）	★17. 支持 BISx4 监测模块或者单 机, 提供不少于 4 通道 EEG, 双频 指数（BIS）, 肌电活动（EMG）, 抑制比（SR）, 频谱边缘频率（SEF） 等参数的监测。	完全响应采购需求, 无偏离, ★17. 支持 BISx4 监测模块或者单 机, 提供不少于 4 通道 EEG, 双频 指数（BIS）, 肌电活动（EMG）, 抑制比（SR）, 频谱边缘频率（SEF）	无偏离

项 号	货物名称	技术参数要求	投标文件的响应情况（是否响应 采购需求）及偏离情况 （无偏离、正偏离、负偏离）	偏离情况说明
			等参数的监测。	
2	多功能监护仪 （一拖 12）	18. 支持升级提供功率谱密度 （DSA）显示界面，可以直观地显 示一段时间内的双侧功率谱分布 变化的情况。	完全响应采购需求，无偏离， 18. 支持升级提供功率谱密度 （DSA）显示界面，可以直观地显 示一段时间内的双侧功率谱分布 变化的情况。	无偏离
2	多功能监护仪 （一拖 12）	19. 支持 PiCCO 监测模块，采用 PiCCO 技术股动脉和中心静脉常 规穿刺实现微创 CCO 等血液动力 学监测参数，并提供蛛网图，直 观观察病人的变化情况。	完全响应采购需求，无偏离， 19. 支持 PiCCO 监测模块，采用 PiCCO 技术股动脉和中心静脉常 规穿刺实现微创 CCO 等血液动力 学监测参数，并提供蛛网图，直 观观察病人的变化情况。	无偏离
2	多功能监护仪 （一拖 12）	20. 支持升级 RM 呼吸力学监测， 监测参数包括 FEV1.0, RSBI, WOB 等 17 种参数。	完全响应采购需求，无偏离， 20. 支持升级 RM 呼吸力学监测， 监测参数包括 FEV1.0, RSBI, WOB 等 17 种参数。	无偏离
2	多功能监护仪 （一拖 12）	21. 支持升级 NMT 监测参数，采用 三轴加速度方向识别技术，支持 TOF, ST0.1, ST1.0, DBS3.2, DBS3.3, PTC 测量模式。	完全响应采购需求，无偏离， 21. 支持升级 NMT 监测参数，采用 三轴加速度方向识别技术，支持 TOF, ST0.1, ST1.0, DBS3.2, DBS3.3, PTC 测量模式。	无偏离
2	多功能监护仪 （一拖 12）	22. 支持升级 EEG 监测参数，支持 进行 4 通道脑电的监测。	完全响应采购需求，无偏离， 22. 支持升级 EEG 监测参数，支持 进行 4 通道脑电的监测。	无偏离

项 号	货物名称	技术参数要求	投标文件的响应情况（是否响应 采购需求）及偏离情况 （无偏离、正偏离、负偏离）	偏离情况说明
2	多功能监护仪 (一拖12)	23. 支持升级 rSO2 组织氧饱和度的监测, 无创, 连续, 适用于成人、小儿和新生儿。	完全响应采购需求, 无偏离, 23. 支持升级 rSO2 组织氧饱和度的监测, 无创, 连续, 适用于成人、小儿和新生儿。	无偏离
2	多功能监护仪 (一拖12)	24. 支持升级FloTrac监测功能模块, 非漂浮导管热稀释法或无创阻抗法, 可通过监测挠动脉压力提供连续心排量(CCO), 每搏量变异(SVV), 实时外周血管阻力(SVR)等监测参数, 满足连续血流动力学监测需求。	完全响应采购需求, 无偏离, 24. 支持升级FloTrac监测功能模块, 非漂浮导管热稀释法或无创阻抗法, 可通过监测挠动脉压力提供连续心排量(CCO), 每搏量变异(SVV), 实时外周血管阻力(SVR)等监测参数, 满足连续血流动力学监测需求。	无偏离
2	多功能监护仪 (一拖12)	25. 支持升级与呼吸机、输注泵, CRRT设备相连, 实现床旁设备设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。	完全响应采购需求, 无偏离, 25. 支持升级与呼吸机、输注泵, CRRT设备相连, 实现床旁设备设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。	无偏离
2	多功能监护仪 (一拖12)	★26. 具备病人状态报警图形化显示窗口, 显示病人当前发生的生理报警、发生报警的器官以及监护参数最近一小时的趋势数据, 具备多参融合分析与显示功能, 通过心电与有创压脉搏波和血氧脉搏波的融合分析, 对心律	完全响应采购需求, 无偏离, ★26. 具备病人状态报警图形化显示窗口, 显示病人当前发生的生理报警、发生报警的器官, 以及监护参数最近一小时的趋势数据, 具备多参融合分析与显示功能, 通过心电与有创压脉搏波和	无偏离

项 号	货物名称	技术参数要求	投标文件的响应情况（是否响应 采购需求）及偏离情况 （无偏离、正偏离、负偏离）	偏离情况说明
		失常的假性报警进行抑制，并在 参数区显示 ECG、Pleth 和 IBP 波形信号质量状态指示。	血氧脉搏波的融合分析，对心律 失常的假性报警进行抑制，并在 参数区显示 ECG、Pleth 和 IBP 波形信号质量状态指示。	
2	多功能监护仪 （一拖 12）	27. 具有图形化报警指示功能，看 报警信息更容易。	完全响应采购需求，无偏离， 27. 具有图形化报警指示功能，看 报警信息更容易。	无偏离
2	多功能监护仪 （一拖 12）	28. 所有参数报警限提供一键自 动设置。	完全响应采购需求，无偏离， 28. 所有参数报警限提供一键自 动设置。	无偏离
2	多功能监护仪 （一拖 12）	29. 能够设置护理组，一个护理组 能够设置 6~12 个病人，这些病 人之间能够互相进行它床观察。	完全响应采购需求，无偏离， 29. 能够设置护理组，一个护理组 能够设置 6~12 个病人，这些病 人之间能够互相进行它床观察。	无偏离
2	多功能监护仪 （一拖 12）	30. 具备血液动力学，药物计算， 氧合计算，通气计算和肾功能计 算功能。	完全响应采购需求，无偏离， 30. 具备血液动力学，药物计算， 氧合计算，通气计算和肾功能计 算功能。	无偏离
2	多功能监护仪 （一拖 12）	31. ≥120 小时趋势表和趋势图回 顾，≥1000 条事件回顾，事件回 顾时能够提供报警事件列表。能 够根据时间、报警优先级、报警 类型和参数组对事件进行筛选。 具备≥48 小时全息波形的存储与	完全响应采购需求，无偏离， 31. ≥120 小时趋势表和趋势图回 顾，1000 条事件回顾，事件回顾 时能够提供报警事件列表。能够 根据时间、报警优先级、报警类 型和参数组对事件进行筛选。具	无偏离

项 号	货物名称	技术参数要求	投标文件的响应情况（是否响应 采购需求）及偏离情况 （无偏离、正偏离、负偏离）	偏离情况说明
		回顾功能。≥120 小时 ST 片段回 顾。	备 48 小时全息波形的存储与回顾 功能。120 小时 ST 片段回顾。	
2	多功能监护仪 （一拖 12）	32. 具有在线帮助功能，能够指导 使用者掌握如何设置参数。	完全响应采购需求，无偏离， 32. 具有在线帮助功能，能够指导 使用者掌握如何设置参数。	无偏离
2	多功能监护仪 （一拖 12）	33. 具有高级参数指导功能，能够 指导使用者掌握高级参数的使用 方法。	完全响应采购需求，无偏离， 33. 具有高级参数指导功能，能够 指导使用者掌握高级参数的使用 方法。	无偏离
2	多功能监护仪 （一拖 12）	34. 提供监护模式、待机模式、体 外循环模式、插管模式，夜间模 式、隐私模式、演示模式等工作 模式。	完全响应采购需求，无偏离， 34. 提供监护模式、待机模式、体 外循环模式、插管模式，夜间模 式、隐私模式、演示模式等工作 模式。	无偏离
2	多功能监护仪 （一拖 12）	35. 支持具有专业的血流动力学 辅助应用，能够图形化显示监测 参数，体现参数之间的关系，提 供目标治疗决策建议，提供抬腿 试验辅助工具，提供心功能图指 示，提供蛛网图参数跟踪。	完全响应采购需求，无偏离， 35. 支持具有专业的血流动力学 辅助应用，能够图形化显示监测 参数，体现参数之间的关系，提 供目标治疗决策建议，提供抬腿 试验辅助工具，提供心功能图指 示，提供蛛网图参数跟踪。	无偏离
2	多功能监护仪 （一拖 12）	36. 提供心肌缺血评估工具，可以 快速查看 ST 值的变化。	完全响应采购需求，无偏离， 36. 提供心肌缺血评估工具，可以 快速查看 ST 值的变化。	无偏离

项 号	货物名称	技术参数要求	投标文件的响应情况（是否响应 采购需求）及偏离情况 （无偏离、正偏离、负偏离）	偏离情况说明
2	多功能监护仪 （一拖 12）	37. 支持脓毒症筛查工具，以及满足 2012 SSC 指南和 Sepsis3.0 的治疗建议检查清单，并提供治疗建议。	完全响应采购需求, 无偏离, 37. 支持脓毒症筛查工具，以及满足 2012 SSC 指南和 Sepsis3.0 的治疗建议检查清单，并提供治疗建议。	无偏离
2	多功能监护仪 （一拖 12）	38. 支持升级输注泵用药信息回顾工具，可同时时间轴显示病人生命体征参数及用药信息回顾，呈现病人生命体征变化趋势与药物输注流速变化之间的关系。	完全响应采购需求, 无偏离, 38. 支持升级输注泵用药信息回顾工具，可同时时间轴显示病人生命体征参数及用药信息回顾，呈现病人生命体征变化趋势与药物输注流速变化之间的关系。	无偏离
2	多功能监护仪 （一拖 12）	39. 具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面。	完全响应采购需求, 无偏离, 39. 具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面。	无偏离
2	多功能监护仪 （一拖 12）	40. 支持与除颤监护仪，遥测生命体征监测仪、呼吸机、输注泵、超声混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理。	完全响应采购需求, 无偏离, 支持与除颤监护仪，遥测生命体征监测仪、呼吸机、输注泵、超声混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理。	无偏离
2	多功能监护仪 （一拖 12）	41. 支持升级与红外耳温计的配对使用。	完全响应采购需求, 无偏离, 41. 支持升级与红外耳温计的配对使用。	无偏离
2	多功能监护仪	42. 配置要求：	完全响应采购需求, 无偏离，	无偏离

项 号	货物名称	技术参数要求	投标文件的响应情况（是否响应 采购需求）及偏离情况 （无偏离、正偏离、负偏离）	偏离情况说明
	（一拖 12）		42. 配置要求：	
2	多功能监护仪 （一拖 12）	中央监护系统 2 套。	完全响应采购需求, 无偏离, 中央监护系统 2 套。	无偏离
2	多功能监护仪 （一拖 12）	主机12台。	完全响应采购需求, 无偏离, 主机12台。	无偏离
2	多功能监护仪 （一拖 12）	PiCCO 监测模块 2 个。	完全响应采购需求, 无偏离, PiCCO 监测模块 2 个。	无偏离
2	多功能监护仪 （一拖 12）	BIS 监测模块 3 个。	完全响应采购需求, 无偏离, BIS 监测模块 3 个。	无偏离
2	多功能监护仪 （一拖 12）	旁流 EtCO2 监测模块 2 个。	完全响应采购需求, 无偏离, 旁流 EtCO2 监测模块 2 个。	无偏离
2	多功能监护仪 （一拖 12）	三芯电源线 12 根。	完全响应采购需求, 无偏离, 三芯电源线 12 根。	无偏离
2	多功能监护仪 （一拖 12）	配备 3 / 5 导除颤型分体式主电缆 组件 12 根。	完全响应采购需求, 无偏离, 配备 3 / 5 导除颤型分体式主电缆 组件 12 根。	无偏离
2	多功能监护仪 （一拖 12）	配备 5 导分体式导联线组件 AHA 按扣式 12 根。	完全响应采购需求, 无偏离, 配备 5 导分体式导联线组件 AHA 按扣式 12 根。	无偏离
2	多功能监护仪 （一拖 12）	配备 7 针血氧主电缆 12 根。	完全响应采购需求, 无偏离, 配备 7 针血氧主电缆 12 根。	无偏离
2	多功能监护仪 （一拖 12）	成人指套式血氧探头 12 根。	完全响应采购需求, 无偏离, 成人指套式血氧探头 12 根。	无偏离

项 号	货物名称	技术参数要求	投标文件的响应情况（是否响应 采购需求）及偏离情况 （无偏离、正偏离、负偏离）	偏离情况说明
2	多功能监护仪 （一拖 12）	无创血压导气管 12 根。	完全响应采购需求, 无偏离, 无创血压导气管 12 根。	无偏离
2	多功能监护仪 （一拖 12）	成人血压袖套 20 个。	完全响应采购需求, 正偏离, 成人血压袖套 24 个。	正偏离 成人血压袖套 24 个。
2	多功能监护仪 （一拖 12）	儿童血压袖套 5 个。	完全响应采购需求, 正偏离, 儿童血压袖套 12 个。	正偏离 儿童血压袖套 12 个。

供应商[公章(CA 签章)]: 九州通(桂林)供应链管理有限公司

法定代表人、负责人或相应委托代理人签字[或盖章(CA 签章)]:

日

期

2026 年 4 月 10 日

注: 1. 供应商应对照“采购需求”注明所投产品技术参数的响应情况及偏离情况(无偏离、正偏离、负偏离), 当出现“正偏离”或“负偏离”情况时应对应填写偏离情况说明及提供相应有效的证明材料。

2. 技术规格偏离表须由法定代表人、负责人或相应的委托代理人签字(或盖章), 并加盖供应商(公章)。

当本表由多页构成时, 需逐页加盖供应商(公章)。

3. 采购需求表中标注“★”项的内容均为实质性要求, 必须满足, 否则投标无效。

中标通知书

项目编号: GLZC2026-G1-990086-GXRZ

九州通（桂林）供应链管理有限公司:

广西瑞真工程造价咨询有限责任公司受桂林市中医医院的委托,就中医特色重点医院桂林市中医医院设备更新项目第一批设备采购项目-中央监护系统(一拖30)1套,多功能监护仪(一拖12)1套进行采购,按规定程序进行了公开招标采购,经评标委员会评审,采购人确认,确定贵公司为本项目的中标供应商,其中标内容为中央监护系统(一拖30)1套、多功能监护仪(一拖12)1套,具体内容详见采购文件及附件。

中标金额:人民币贰佰贰拾捌万柒仟元整(¥2287000.00元)。

合同履行期限:自签订合同之日起60个日历日内全部安装调试合格完毕并验收合格交付使用,超期未安装调试完毕并验收合格则视为违约。

请贵公司接此通知书后在八个工作日内与采购人签订合同,并按采购文件要求和投标文件的承诺履行完合同。

附件:投标报价表

采购人联系人:谢非

联系电话:0773-2813444


采购代理机构联系人:蒋福军、李秋凤、张燕香、陈雪姣

联系电话:0773-5841116

采购人:桂林市中医医院

采购代理机构:广西瑞真工程造价咨询有限责任公司


日期:2026年04月10日



营业执照


统一社会信用代码

91450300MAK2XDJDB8 (1-1)

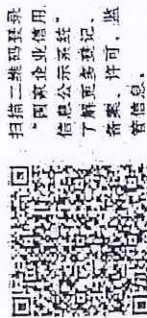

扫描二维码
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多信息
备案、许可、监
管信息。

(副本)

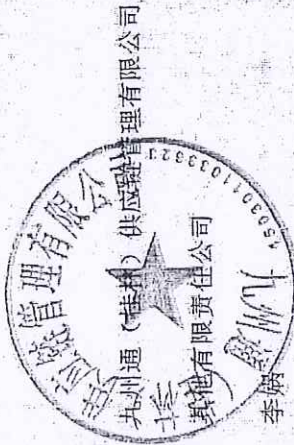

名称 九州通(桂林)供应链管理有限公司

类型 其他有限责任公司

法定代表人 李婧

注册资本 壹仟万圆整

成立日期 2025年12月22日

住所 桂林市秀峰区红岭路1号桂林华润中心1栋
B座5-10号、5-11号、5-12号办公

经营范围

一般项目：供应链管理服务；以自有资金从事投资活动；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备批发；医护人员防护用品批发；办公用品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；家用电器销售；软件销售；医用口罩批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可经营项目：第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）



登记机关

2025年12月22日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

第二类医疗器械经营备案凭证

备案编号: 桂桂药监械经营备20260061号


企业名称	九州通(桂林)供应链管理有限公司
统一社会信用代码	91450300MAK2XDJD8R
法定代表人	李娟
企业负责人	羊志权
住 所	桂林市秀峰区红岭路1号桂林华润中心1栋B座5-10号、5-11号、5-12号办公
经营方式	批发
经营场所	桂林市秀峰区红岭路1号桂林华润中心1栋B座5-10号、5-11号、5-12号办公
库房地址	广西壮族自治区桂林市灵川县定江镇八里四路37号 (委托广西大仓通供应链管理有限公司仓储、配送)
经营范围	6801, 6802, 6803, 6804, 6805, 6806, 6807, 6808, 6809, 6810, 6812, 6813, 6815, 6816, 6820, 6821, 6822, 6823, 6824, 6825, 6826, 6827, 6830, 6831, 6833, 6834, 6840 (诊断试剂需低温冷藏运输贮存), 6841, 6845, 6846, 6854, 6855, 6856, 6857, 6858, 6863, 6864, 6865, 6866, 6870, 6877, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22



备案部门(盖章): 桂林市市场监督管理局

备案日期: 2026年1月8日

行政审批专用章



医疗器械经营许可证

许可证编号：桂桂药监械经营许20260005号

统一社会信用代码：91450300MAK2XDJD8B

企业名称：九州通（桂林）供应链管理有限公司

法定代表人：李娟

住所：桂林市秀峰区红岭路1号桂林华润中心1栋B座5-10号、5-11号、5-12号办公

企业负责人：羊志权

经营场所：桂林市秀峰区红岭路1号桂林华润中心1栋B座5-10号、5-11号、5-12号办公

经营方式：批发

库房地址：广西灵川县定江镇八里四路37号（委托广西大仓通供应链管理有限公司仓储、配送）

经营范围：

6801, 6802, 6803, 6804, 6805, 6806, 6807, 6808, 6809, 6810, 6812, 6813, 6815, 6816, 6820, 6821, 6822, 6823, 6824, 6825, 6826, 6827, 6828, 6830, 6831, 6832, 6833, 6834, 6841, 6845, 6846, 6854, 6855, 6856, 6857, 6858, 6863, 6864, 6865, 6866, 6870, 6877, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 6840（诊断试剂需低温冷藏运输贮存）

许可期限：自 2026 年 1 月 20 日

发证部门：桂林市市场监督管理局

至 2031 年 1 月 19 日

发证日期：2026 年 1 月 19 日

